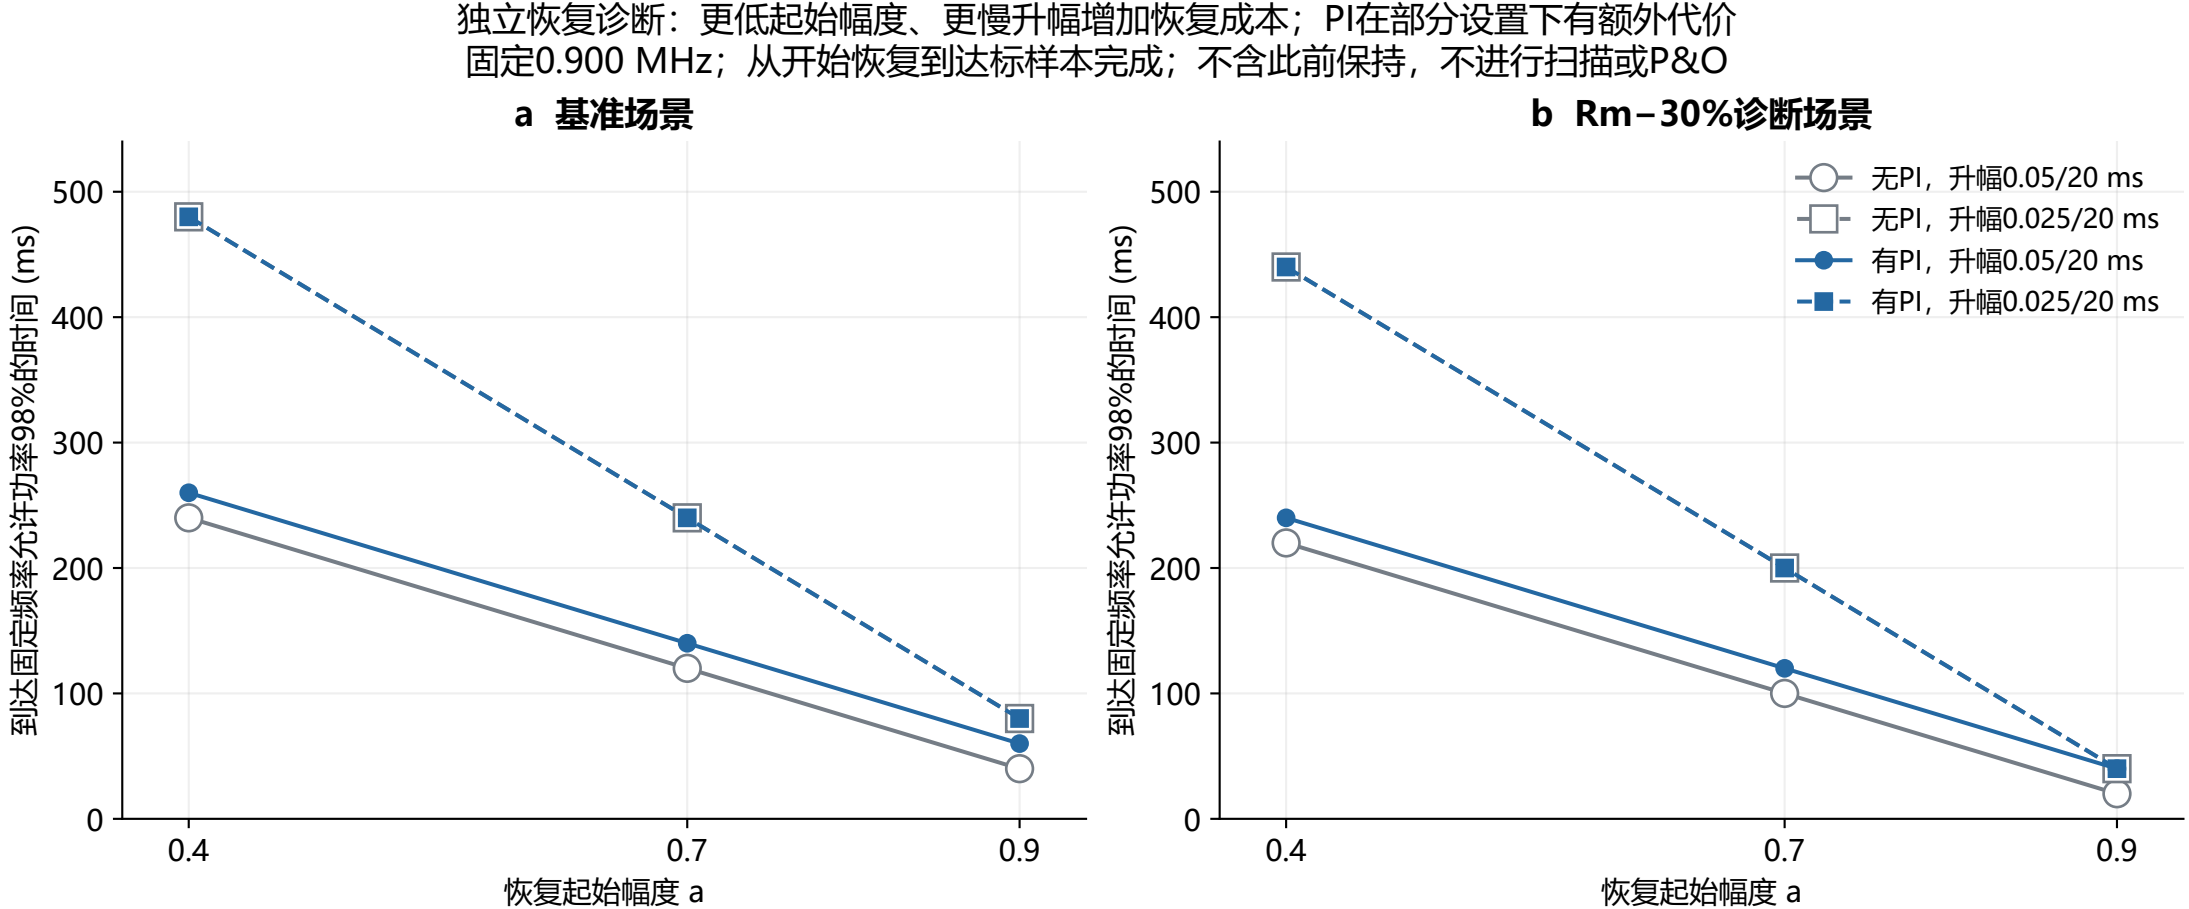

独立恢复诊断：更低起始幅度、更慢升幅增加恢复成本；PI在部分设置下有额外代价
固定0.900 MHz；从开始恢复到达标样本完成；不含此前保持，不进行扫描或P&O
a 基准场景
b Rm−30%诊断场景
到达固定频率允许功率98%的时间 (ms)
恢复起始幅度 a
0
100
200
300
400
500
0.4
0.7
0.9
无PI，升幅0.05/20 ms
无PI，升幅0.025/20 ms
有PI，升幅0.05/20 ms
有PI，升幅0.025/20 ms
假设线性BVD电学模型 · Python离散准稳态仿真 · 非实测、非硬件安全证明
空心大符号与实心小符号重合表示恢复时间相同；未平移数据