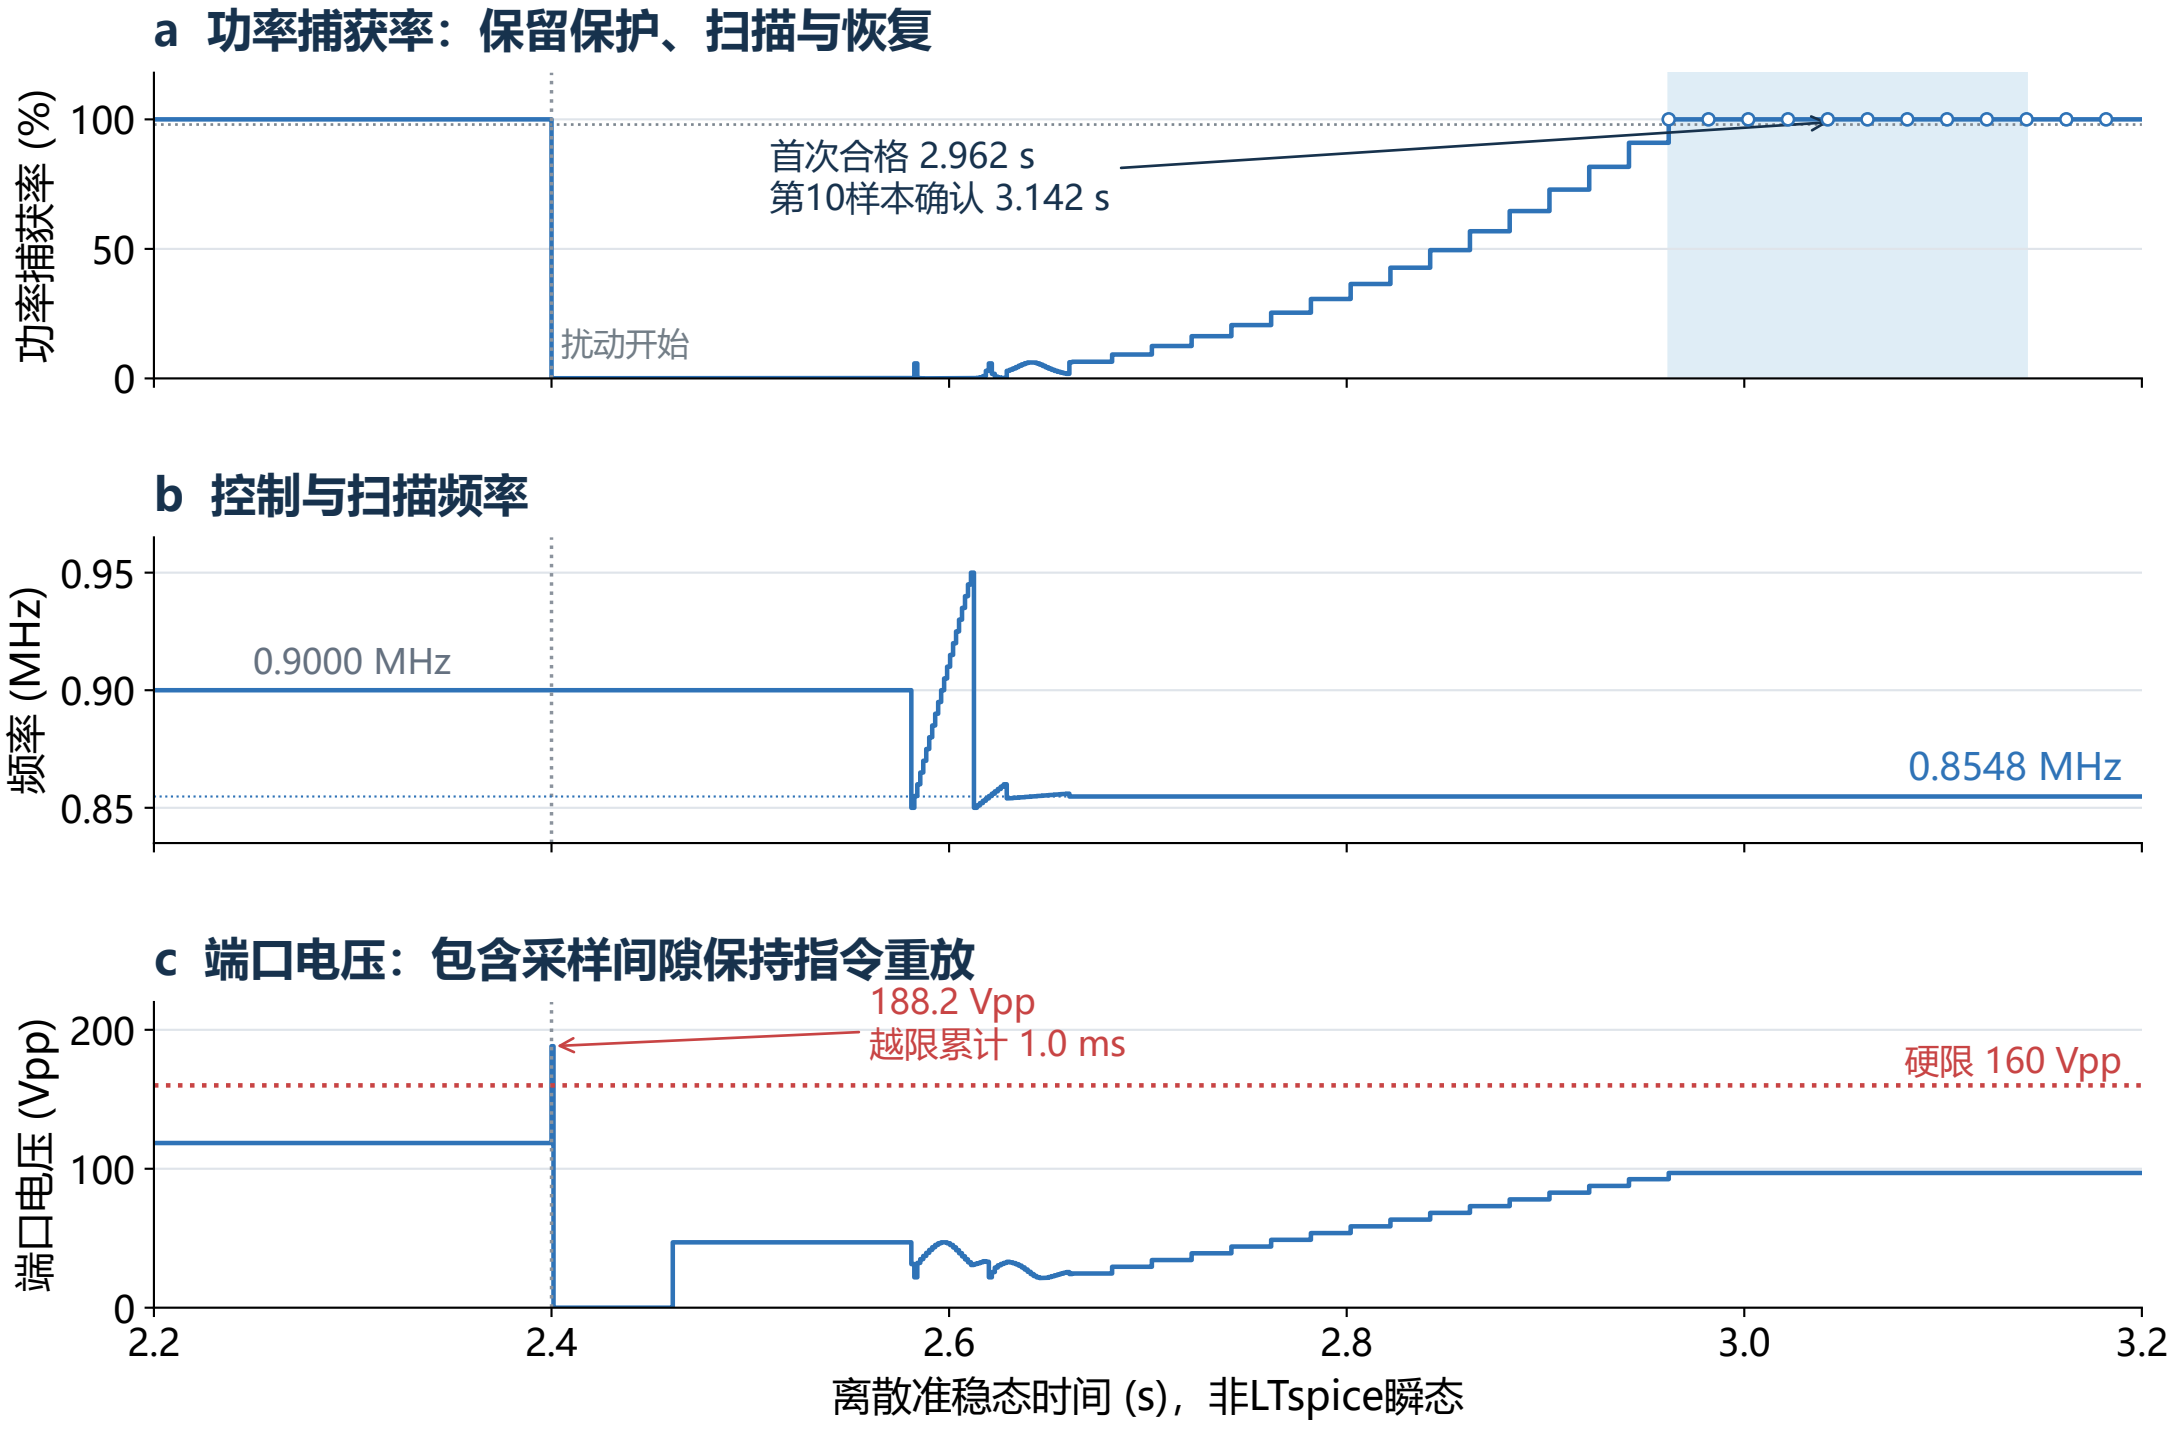
a 功率捕获率：保留保护、扫描与恢复
功率捕获率 (%)
100
50
0
首次合格 2.962 s
第10样本确认 3.142 s
扰动开始
b 控制与扫描频率
频率 (MHz)
0.95
0.90
0.85
0.9000 MHz
0.8548 MHz
c 端口电压：包含采样间隙保持指令重放
端口电压 (Vpp)
200
100
0
188.2 Vpp
越限累计 1.0 ms
硬限 160 Vpp
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
离散准稳态时间 (s)，非LTspice瞬态