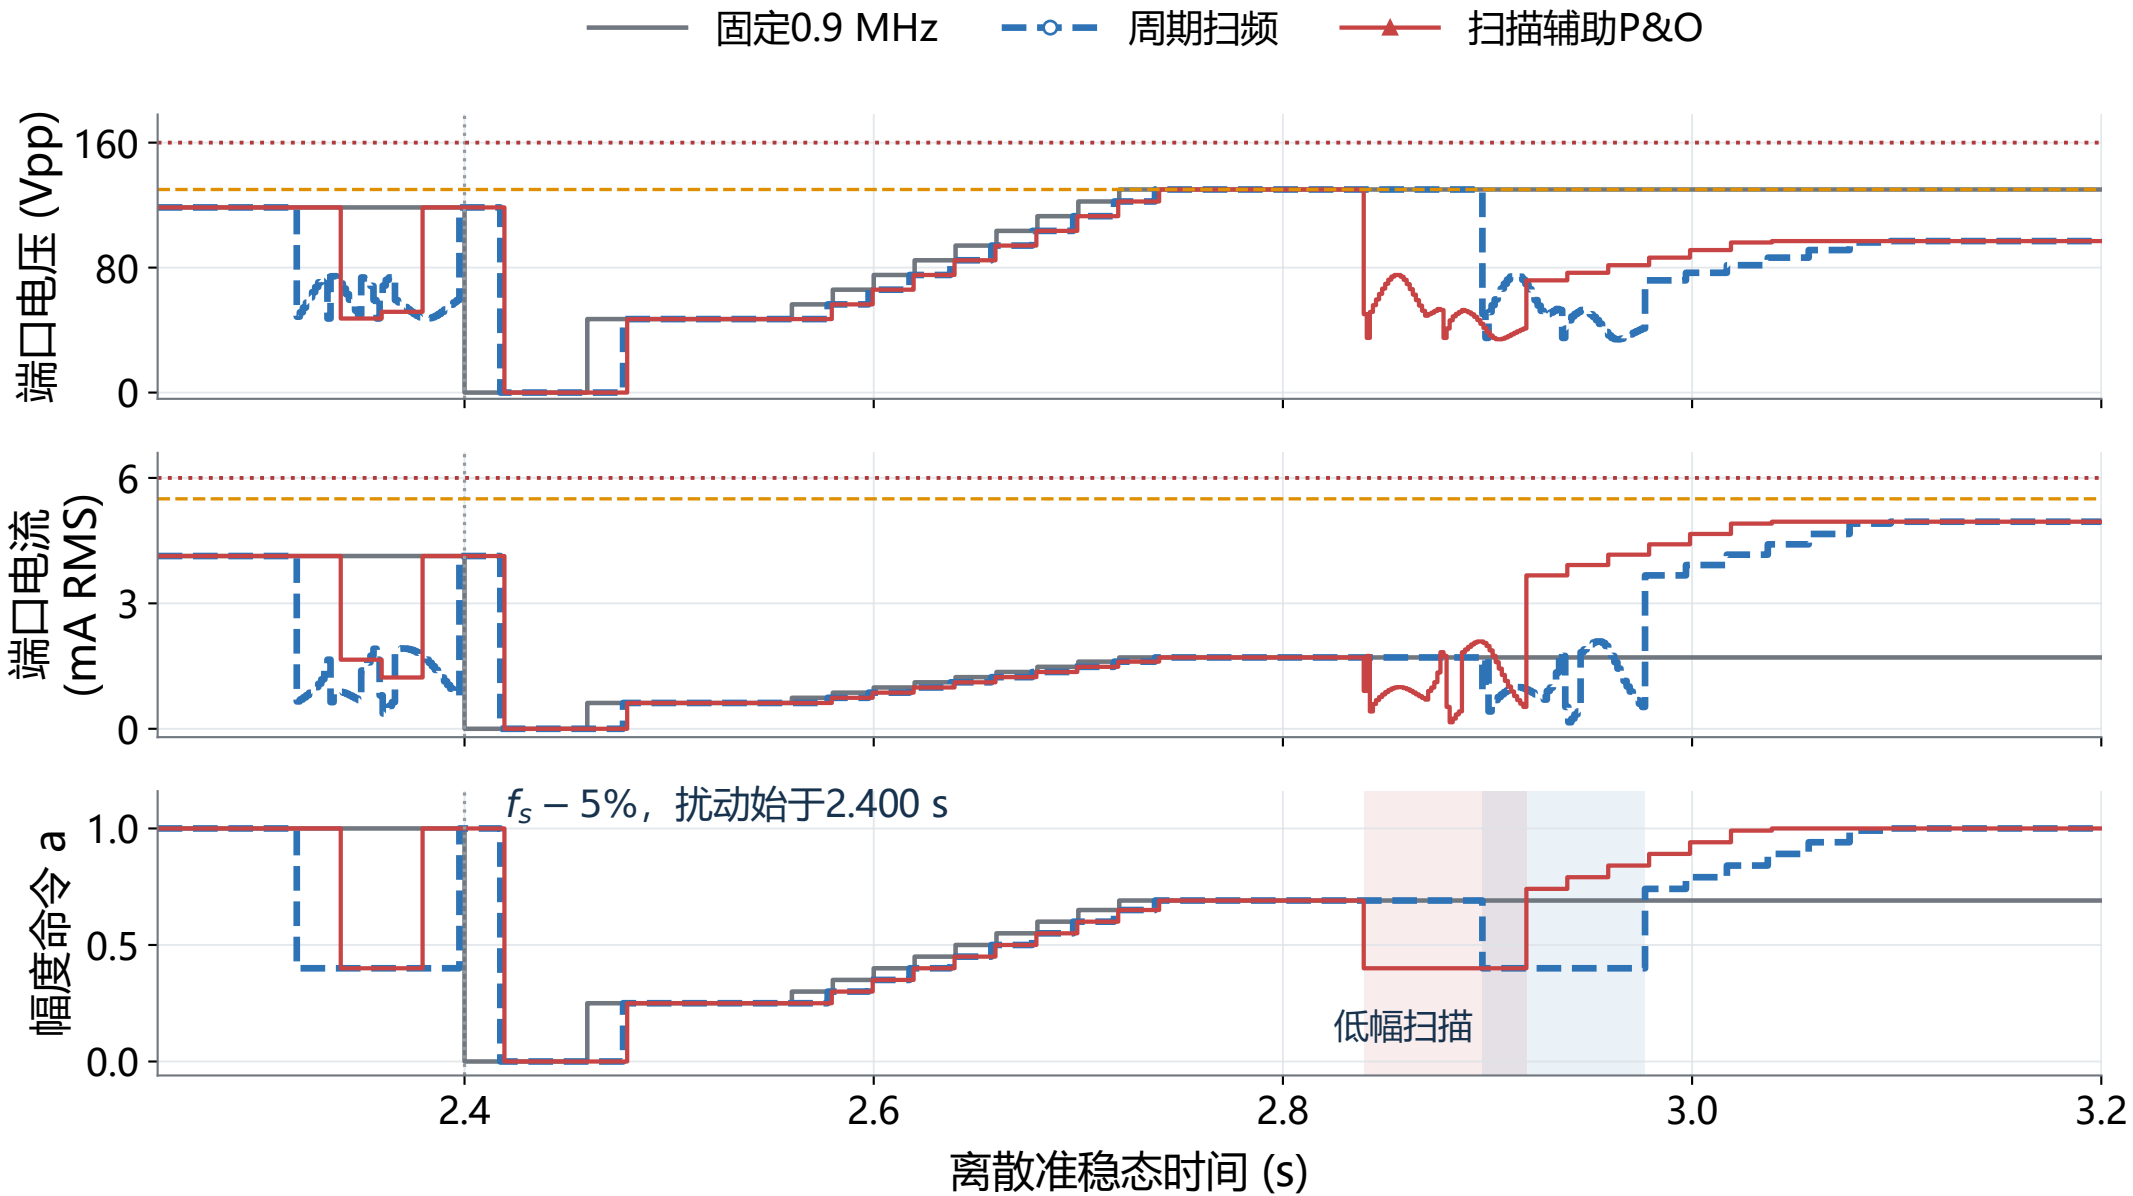
固定0.9 MHz
周期扫频
扫描辅助P&O
端口电压 (Vpp)
160
80
0
端口电流 (mA RMS)
6
3
0
幅度命令 a
1.0
0.5
0.0
f_s − 5%，扰动始于2.400 s
低幅扫描
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
离散准稳态时间 (s)