pH метр



Прибор предназначен для измерения pH.

Комплектация

- Измеритель pH
- pH электрод
- Инструкция

Назначение


- Измерения pH

Характеристики

- Габаритные размеры: 105x60x26.5 мм
- Степень защиты –IP51
- Язык меню: Русский, Английский
- Масса – 0.5 кг
- Питание: аккумулятор
- Уровень pH от 2.0 до 12.0

Начало работы

Для начала работы подключите электрод к прибору и включите прибор нажатием кнопки , опустите электрод в раствор где требуется измерить pH. Проведите измерение, выключите прибор этой же кнопкой с небольшим удерживанием, ополосните электрод и поместите в защитный стаканчик с раствором KCL.
Не опускайте электрод вместе с проводом в раствор.

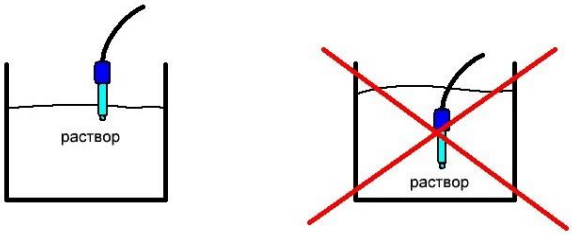


Меню настроек прибора

При включении прибора, на экране отображается основное окно текущего pH раствора.



Нажав кнопку «ОК», переходим в верхний уровень меню прибора.

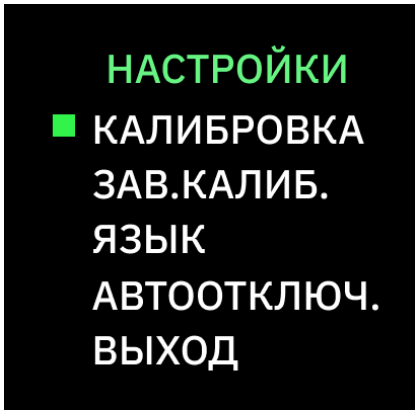

Калибровка прибора

Выбираем пункт «Калибровка» и нажимаем копку «ОК», попадаем в меню калибровки.
Прибор калибруется по двум растворам с разным pH



В пункте «НИЖНЯЯ» устанавливаем электрод в раствор с меньшим pH. Если у вас калибровочный раствор другого значение, нажимаем кнопку «ОК» и попадаем в меню установки калибровочного раствора.



Указываем кнопками ▲ и ▼ pH калибровочного раствора и нажимаем «ОК». Ждем, когда значение (выделенное желтым квадратом перестанет меняться (допускается незначительные колебания последней цифры).


Нажимаем ▼ и переходим ко второму шагу калибровки вторым раствором с большим значением pH. Также если требуется устанавливаем значение pH калибровочного раствора, ждем когда значение перестанет меняться, и нажимаем кнопку ▼ и переходим к пункту «СОХРАНИТЬ» Нажимаем кнопку «ОК» и нам предложат сохранить или нет значения калибровки.



Выбираем стрелками ▲, ▼ «да» или «нет». Переходим к пункту «ВЫХОД» и нажимаем «ОК»
Калибровка окончена, мы выходим в основное окно.

Заводская калибровка

Следующий пункт основного меню — это заводская калибровка. Она позволяет откатится к первоначальной калибровке.

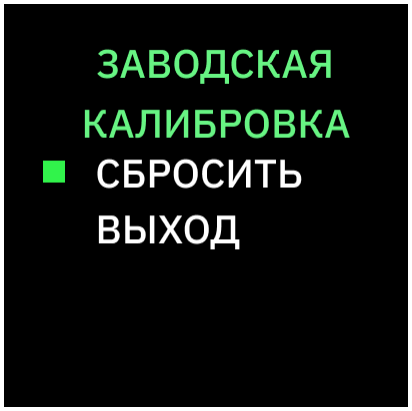

В пункте «СБРОСИТЬ» нажимаем «ОК»
Появится окно выбора,



Выбираем стрелками ▲, ▼ «да» или «нет». И нажимаем «ОК»
Переходим к пункту «ВЫХОД» и нажимаем «ОК», выходим в основное окно.


Выбор языка

Следующий пункт основного меню «ЯЗЫК».



Автоотключение

Далее идет пункт «АВТООТКЛЮЧЕНИЕ»

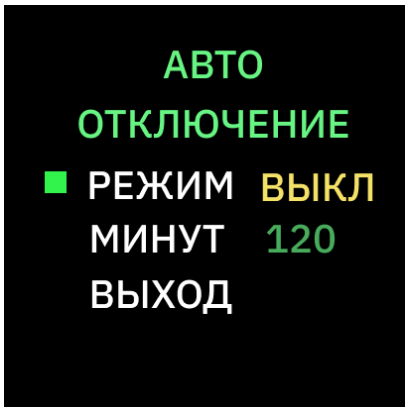

Если его включить.



То через заданное количество минут прибор отключится.



Если он выключен, то прибор будет работать пока не сядут аккумуляторы.

КОНЦЕТРАТЫ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАСТВОРОВ

pH 4.01, pH 6.86 порошок с реагентом - наиболее экономичный вариант получения 250 мл готового буферного калибровочного раствора. Калибровочные буферные растворы предназначены для настройки калибровки и проверки правильности показаний pH метра.

Упаковка представляет собой пакетик для приготовления 250 мл калибровочного раствора, полностью готового к применению.

Способ приготовления калибровочного раствора: растворить в чистой стеклянной емкости пакетик с порошком в 250 мл дистиллированной (деионизированной) воды или в обратном осмосе с температурой 25°C. Для одной калибровки достаточно всего 20 мл раствора. Хранить готовые буферные калибровочные растворы необходимо в темном прохладном месте (не в холодильнике, при температуре не выше 25°C) вдали от прямых солнечных лучей для предотвращения фотохимической деструкции. Кроме того, буферные калибровочные растворы должны быть защищены от попадания углекислого газа из воздуха и храниться в плотно закрытой упаковке.

Вес: 2 грамма (для приготовления 250 мл раствора)

pH электрод

Многоразовый pH электрод с разъемом BNC для подключения pH контроллера / pH метра.

Описание:


Диапазон концентрации обнаружения: pH 0-14
Диапазон обнаружения температуры: 0-80 градусов по Цельсию
Время отклика: ≤ 5S
Время стабильности: ≤ 60 с
Рабочая температура: -10…+50 градусов по Цельсию (номинальная температура 20 градусов по Цельсию)
Рабочая влажность: 95% RH (номинальная влажность 65% RH)
Срок службы: 3 года
Размер: 42 мм x 32 мм x 20 мм
Нулевой потенциал (PH) 7±1
Выход: аналоговый выход сигнала напряжения

Подготовка к использованию
Подготовка перед использованием:
1. Аккуратно снимите защитную бутылку с верхней части электрода предназначенную для хранения электрода.
2. Очистите белую отложившуюся соль на внешней стороне электрода деионизированной водой.

При высыхании измерительной части электрода, её загрязнения или неправильном хранении, электрод может выдавать неправильные значения. Восстановить электрод можно, опустив измерительную часть в воду на 2 часа.




Также нужно периодически проверять и чистить измерительную часть электрода. Чтобы почистить её, можно открутить защитную часть электрода и промыть водой с использованием мягкой кисточки измерительную мембрану (стеклянный шарик на конце электрода).

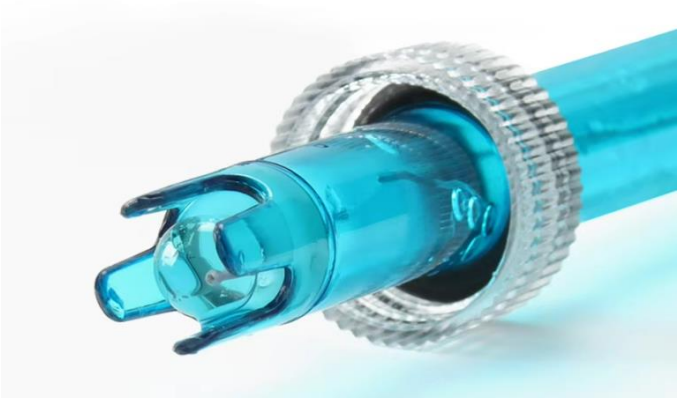

Если прибор не меняет показания в калибровочных приборах, попробуйте сделать «заводскую калибровку», если это не поможет, то скорее всего электрод вышел из строя. Желательно раз в месяц проверять правильность показаний прибора с помощью калибровочных растворов. Если они не соответствуют значениям калибровочных растворам, провести обслуживание электрода и провести калибровку.
Новый электрод и калибровочные растворы можно приобрести на маркетплейсах.
При выборе электрода обращайте внимание чтобы в параметрах было указано
Нулевой потенциал (PH) 7±1

Это параметр означает напряжение на электроде при pH 7 равно 0 мВ, что соответствует нейтральной среде с pH.

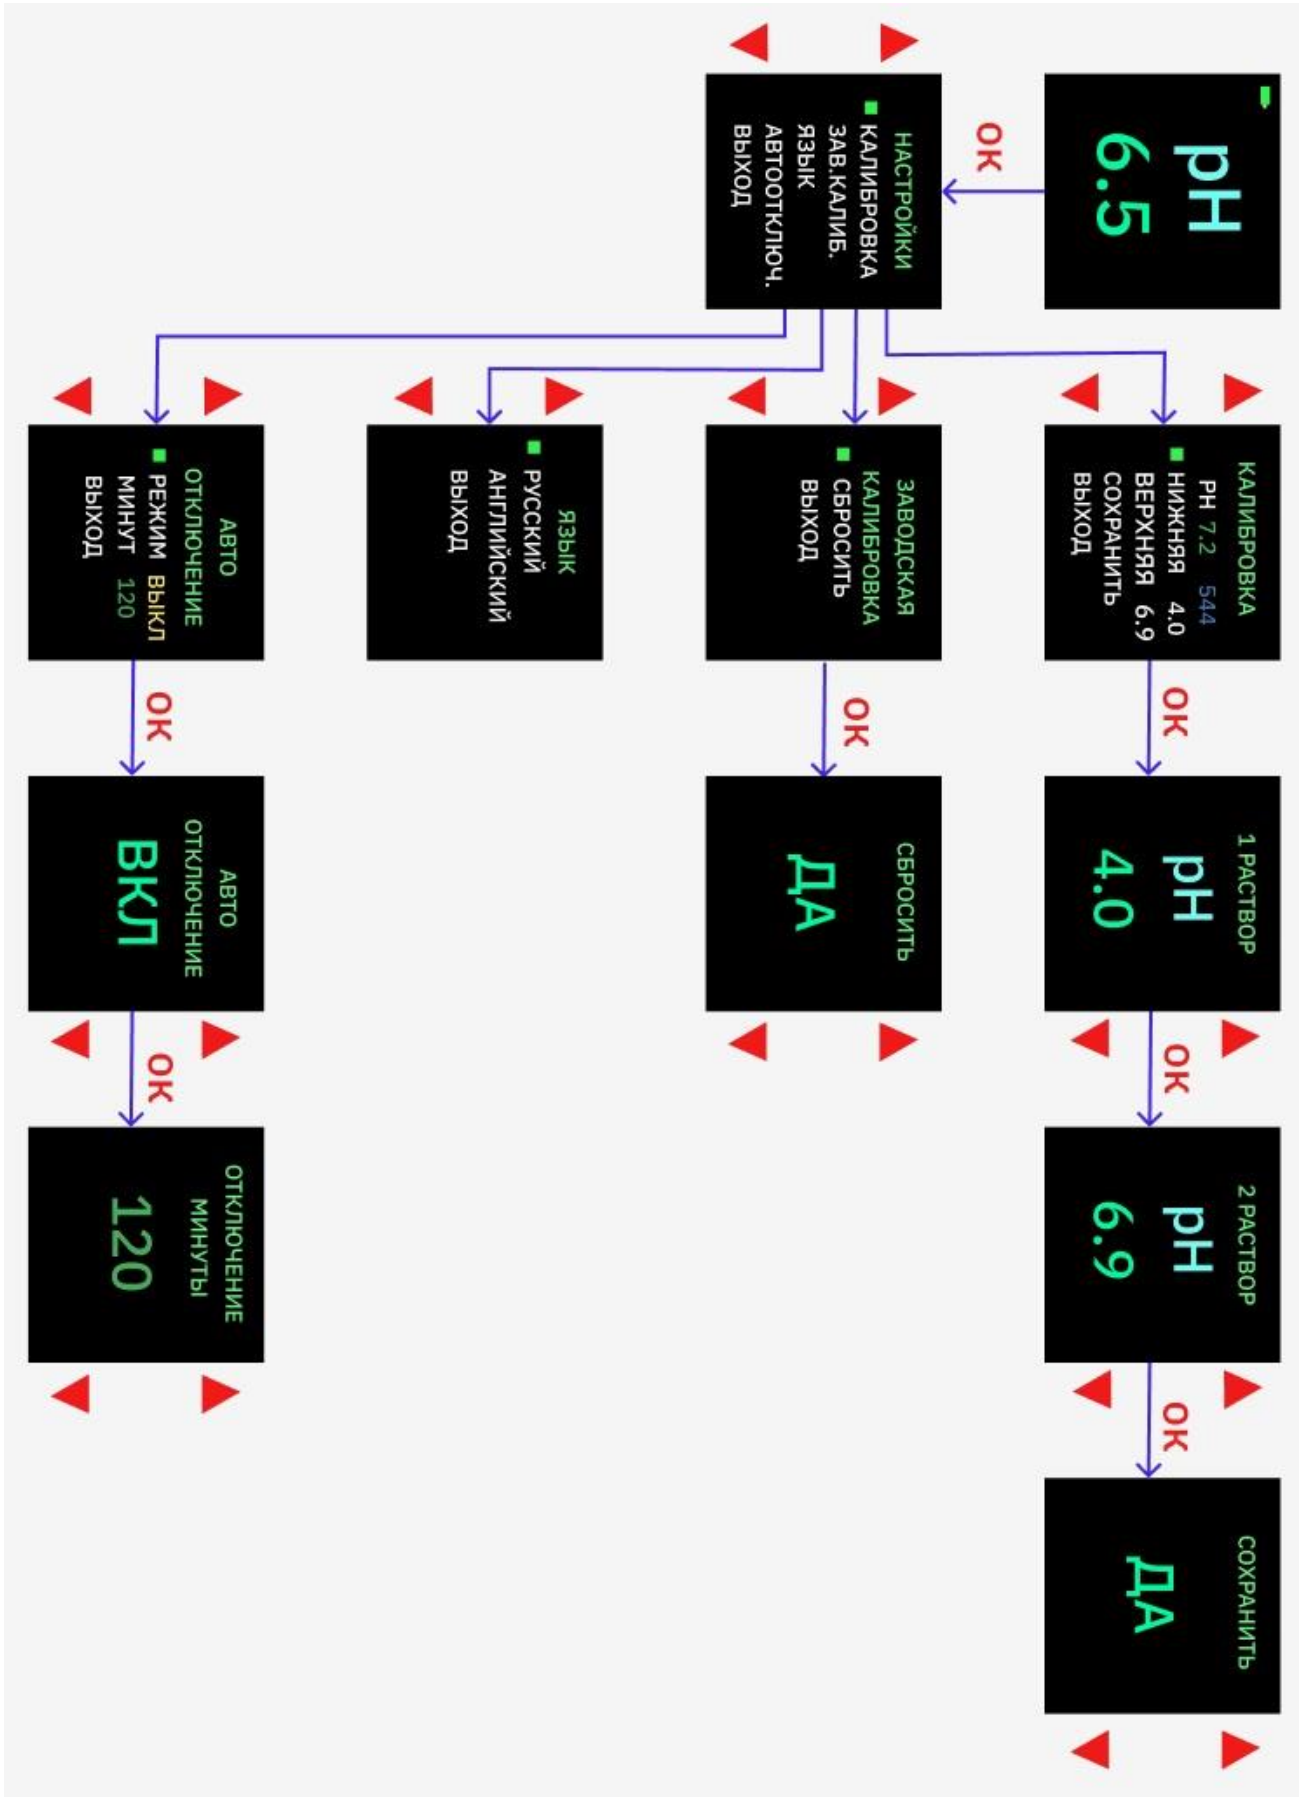
pH
6.5
ОК
НАСТРОЙКИ
КАЛИБРОВКА
ЗАВ.КАЛИБ.
ЯЗЫК
АВТООТКЛЮЧ.
ВЫХОД
КАЛИБРОВКА
РН 7.2 544
НИЖНЯЯ 4.0
ВЕРХНЯЯ 6.9
СОХРАНИТЬ
ВЫХОД
ЗАВОДСКАЯ КАЛИБРОВКА
СБРОСИТЬ
ВЫХОД
ЯЗЫК
РУССКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
ВЫХОД
АВТО ОТКЛЮЧЕНИЕ
РЕЖИМ ВЫКЛ
МИНУТ 120
ВЫХОД
1 РАСТВОР
pH
4.0
2 РАСТВОР
pH
6.9
СОХРАНИТЬ
ДА
СБРОСИТЬ
ДА
АВТО ОТКЛЮЧЕНИЕ
ВКЛ
ОТКЛЮЧЕНИЕ МИНУТЫ
120

Здравствуйте. Спасибо что заинтересовались нашей продукцией. Если появятся какие-нибудь вопросы или проблемы с прибором, обращайтесь, поможем разобраться, отремонтируем, обменяем, или доработаем под ваши нужды.

https://dginni.ru

✆ +7 965 5716155

help@dginni.ru