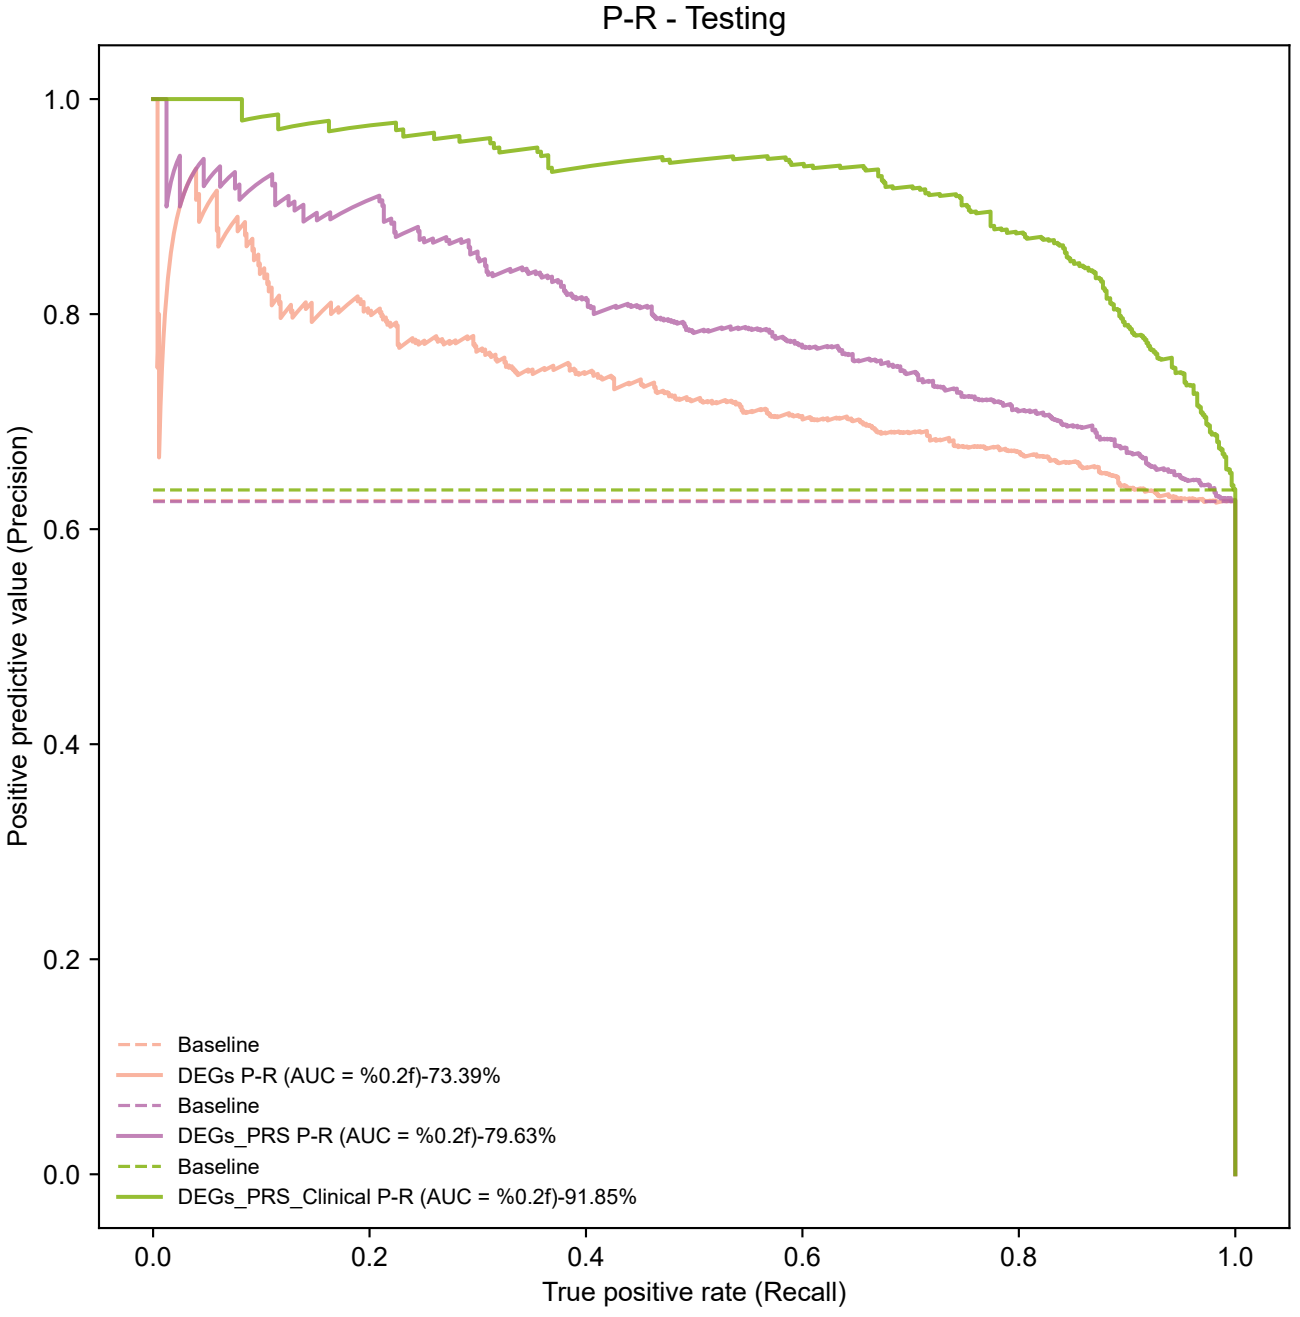
P-R - Testing
Positive predictive value (Precision)
True positive rate (Recall)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Baseline
DEGs P-R (AUC = %0.2f)-73.39%
Baseline
DEGs_PRS P-R (AUC = %0.2f)-79.63%
Baseline
DEGs_PRS_Clinical P-R (AUC = %0.2f)-91.85%

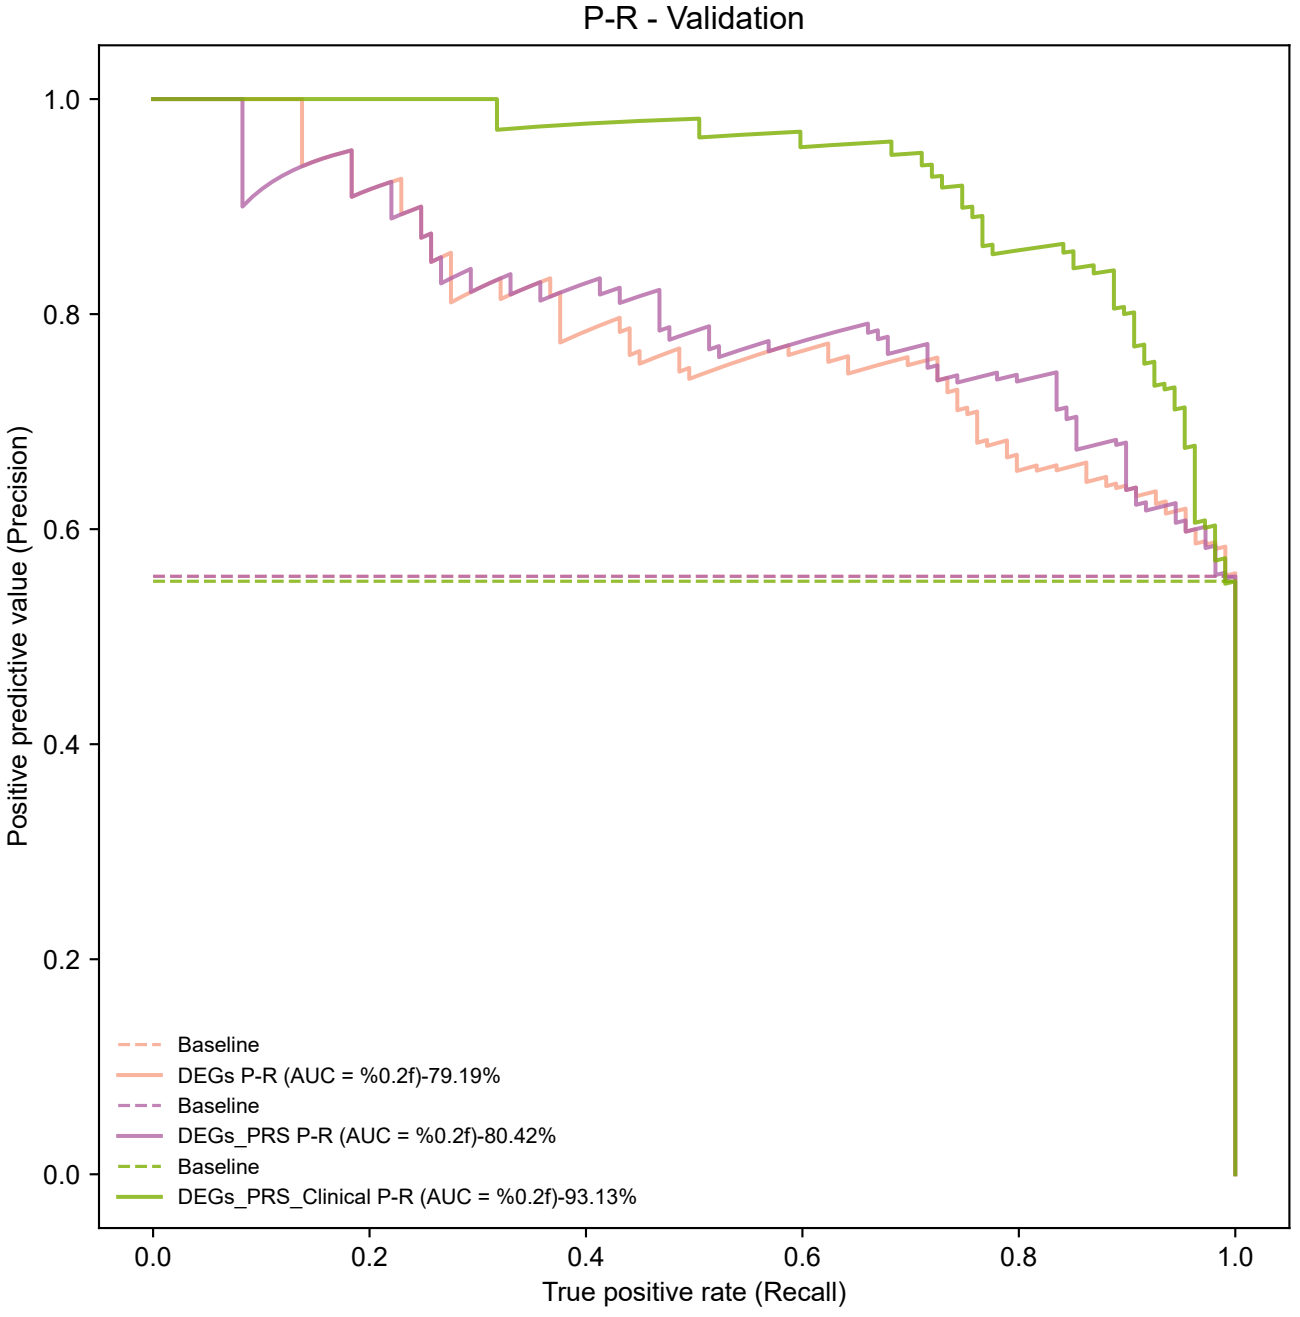
P-R - Validation
Positive predictive value (Precision)
True positive rate (Recall)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Baseline
DEGs P-R (AUC = %0.2f)-79.19%
Baseline
DEGs_PRS P-R (AUC = %0.2f)-80.42%
Baseline
DEGs_PRS_Clinical P-R (AUC = %0.2f)-93.13%

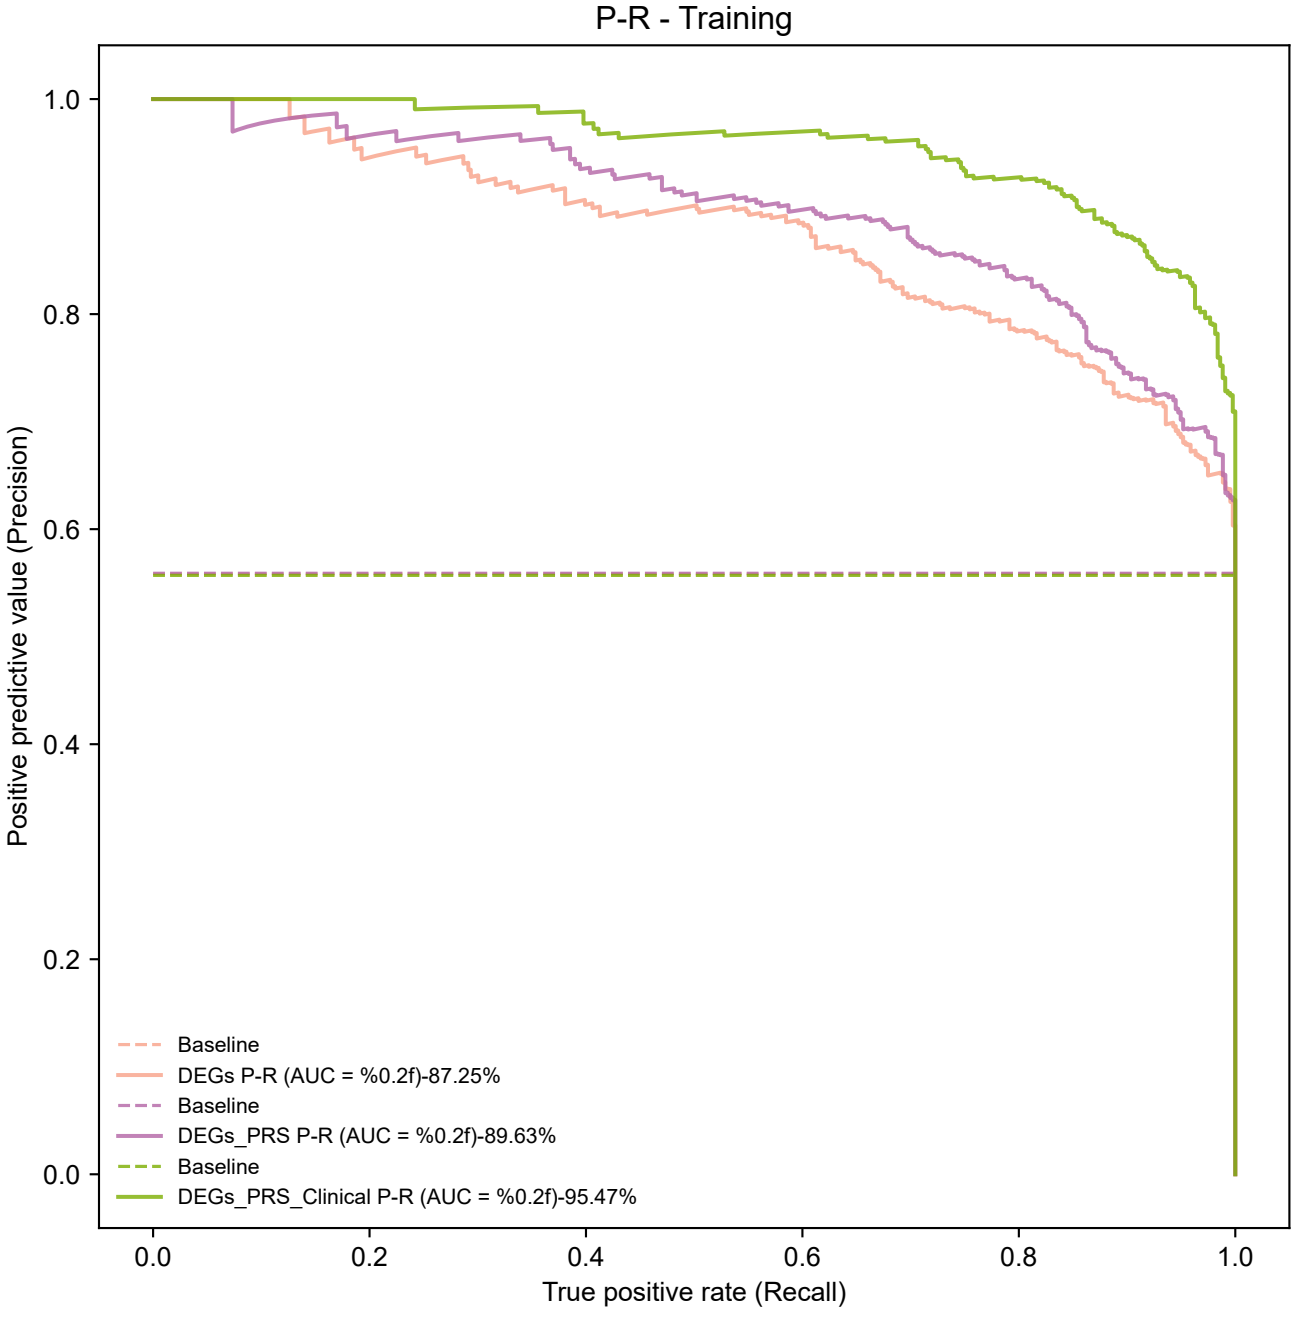
P-R - Training
Positive predictive value (Precision)
True positive rate (Recall)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Baseline
DEGs P-R (AUC = %0.2f)-87.25%
Baseline
DEGs_PRS P-R (AUC = %0.2f)-89.63%
Baseline
DEGs_PRS_Clinical P-R (AUC = %0.2f)-95.47%