


# HV calibration

HV B (positive) HV (kV) reading Coarse Gain  
Amplifier at x33 0.407 13

Time (sec)	Counts	kV	Counts
1	2941	0.45	2941
1	2900	0.43	2900
1	2467	0.409	2467
1	2154	0.389	2154
1	1955	0.371	1955
	1954	0.354	1954
	1960	0.334	1960

kV

plateau 0.44

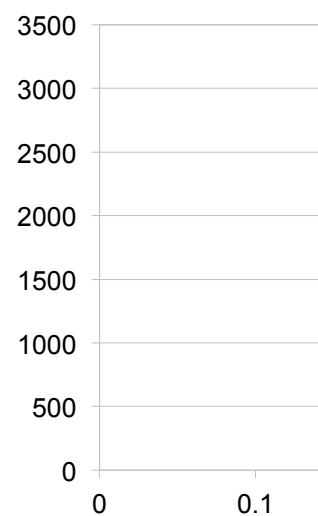

## HV calibration

