


지속기간 5 년
시술일/제거일 200 년 월 일 / 200 년 월 일

시술방법

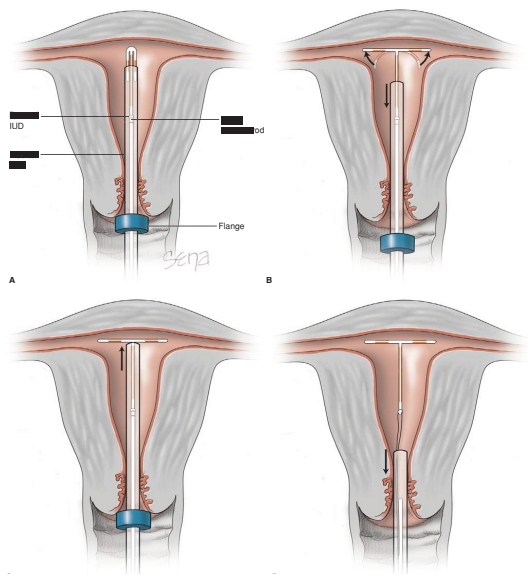

부작용

현재까지 나온 피임방법중에 **100%완벽한 피임방법은 없습니다.** 모든 피임방법에는 부작용과 피임실패의 확률이 있습니다. 특히 부작용이 생겼을때 피임실패 확률이 올라가게 됩니다. 구리 자궁내피임기구의 **피임실패 확률은 0.8입니다.**

1. 구리 자궁내피임기구는 월경 출혈이나 월경 곤란을 증가시킬 수 있습니다. 구리 자궁내피임기구를 사용하는 동안 위의 증상이 나타난 경우 기기를 제거하는 것을 고려
2. 골반염의 가능성이 있습니다. 구리 자궁내피임기구 사용자에서 삽입하고 1달 동안 골반염 비율이 가장 높았으며 이후에는 감소합니다. 골반염은 수정능력을 손상시킬 수 있으며 자궁외 임신의 위험성을 증가시킬 수 있다. 매우 드물지만, 다른 부인과 진찰이나 수술과 마찬가지로 자궁내피임기구 삽입 이후에 중증의 감염이나 폐혈증(연쇄구균 A군에 의한 폐혈증 포함)이 발생할 수 있습니다.
3. 방출 자궁내 피임기구가 부분적이거나 전체적으로 방출될 때는 출혈 또는 통증의 증상이 나타날 수 있습니다. 그러나 인지하지 못한 상태로 기구가 자궁강에서 방출될 수도 있다. 부분적으로 방출되면 구리 자궁내피임기구의 유효성이 감소할 수 있으며 이러한 기구는 제거하고 새 기구를 삽입해야합니다.
4. 천공 자궁내피임기구로 인하여 자궁 또는 자궁경부에 구멍이 나거나 관통할 수 있으며 대부분 삽입시에 발생합니다. 이러한 경우, 자궁내피임기구는 가능한 빨리 제거되어야 합니다. 천공의 위험은 자궁 후굴이 고정된 여성에서 증가할 수 있다.
5. 자궁외임신 자궁내피임기구를 사용하는 동안 자궁외임신이 발생할 수 있으나 구리 자궁내피임기구를 사용하는 여성이 피임을 하지 않는 여성보다 자궁외 임신의 전반적 위험성이 더 높지는 않습니다.

*발생가능한 이상반응은 아래와 같습니다.

- 월경출혈 증가
- 월경곤란증가
- 하복부 또는 등통증
- 빈혈
- 피임에 실패하여 임신할수 있고 특히 자궁외임신일수 있음
- 피부 알레르기
- 자궁내피임기구를 사용하는 동안 골반염이 발생할 수 있습니다.
- 자궁내피임기구 또는 그 일부가 자궁벽의 구멍을 내거나 관통할 수 있다.
- 폐혈증(연쇄구균 A군에 의한 폐혈증 포함)의 사례가 자궁내장치의 삽입 이후에 보고 되었다.

부작용 예방을 위한 환자 수칙

1. 첫 한 달 동안에 부작용의 빈도가 많이 증가하므로(골반염, 방출, 천공등) 꼭 루프한달후에는 외래에 방문하여 루프가 제자리를 잘 잡았는지 골반염이 없는지, 출혈양과 생리통이 심해져 있는지를 확인해 보아야 합니다.
2. 한달안에는 다른 보조적인 피임방법을 사용하여서 부작용과 피임실패확률을 최소화 할 수 있습니다.
3. 자궁내피임기구 시술후 3-4시간후에 거즈를 빼시고, 안정하십시오.
4. 위와 같은 환자수칙을 잘 지키시면 피임실패확률은 0.6입니다.

위의 설명을 잘 듣고 시술에 동의합니다.

본인 또는 보호자 :

[사인]

설 명 자 :

[사인]/날짜: