


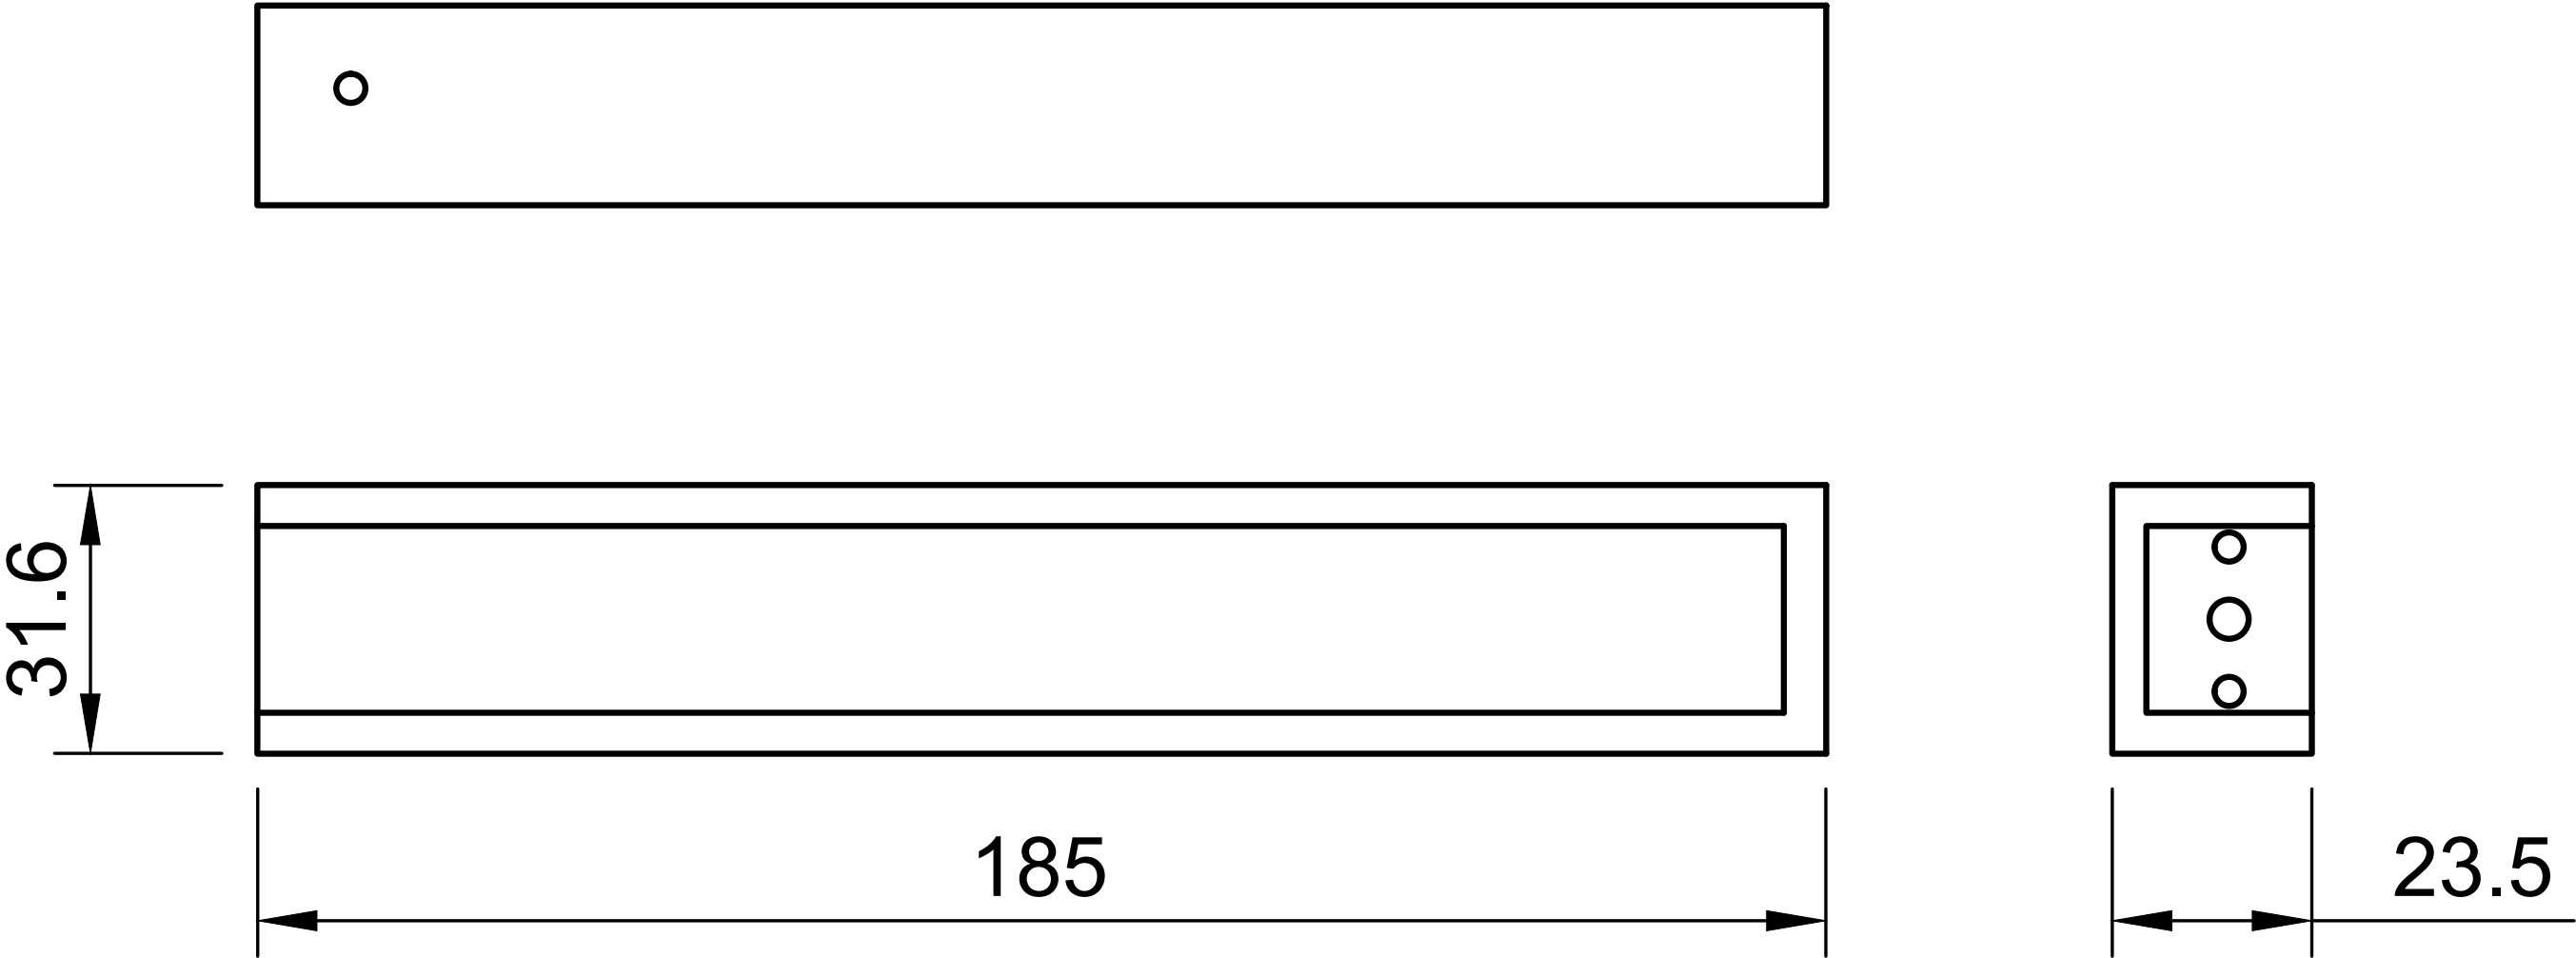

COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-01 (ISO 2768-m)	
Longitud Total del Pilón:	185.00 ± 0.50 mm (Carrera vertical total)
Ancho Exterior del Canal en U:	31.60 ± 0.20 mm
Profundidad del Canal de Guía:	23.50 ± 0.20 mm
Ancho Interior de Corredera:	26.00 ± 0.15 mm (Ajuste H9/d9 con Horquilla B3)
Taladros de Fijación Motor GA25:	4x M3x0.5 a 17.0 mm entre centros
Alojamiento de Buje de Pivote J2:	Ø 8.00 H7 (+0.015 / 0.000 mm)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO:	CÓDIGO / DWG NO.:	
Columna Tibial A2 (Canal en U)	P-01	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Tri-Hexagonal) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 92.3 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 3/9