


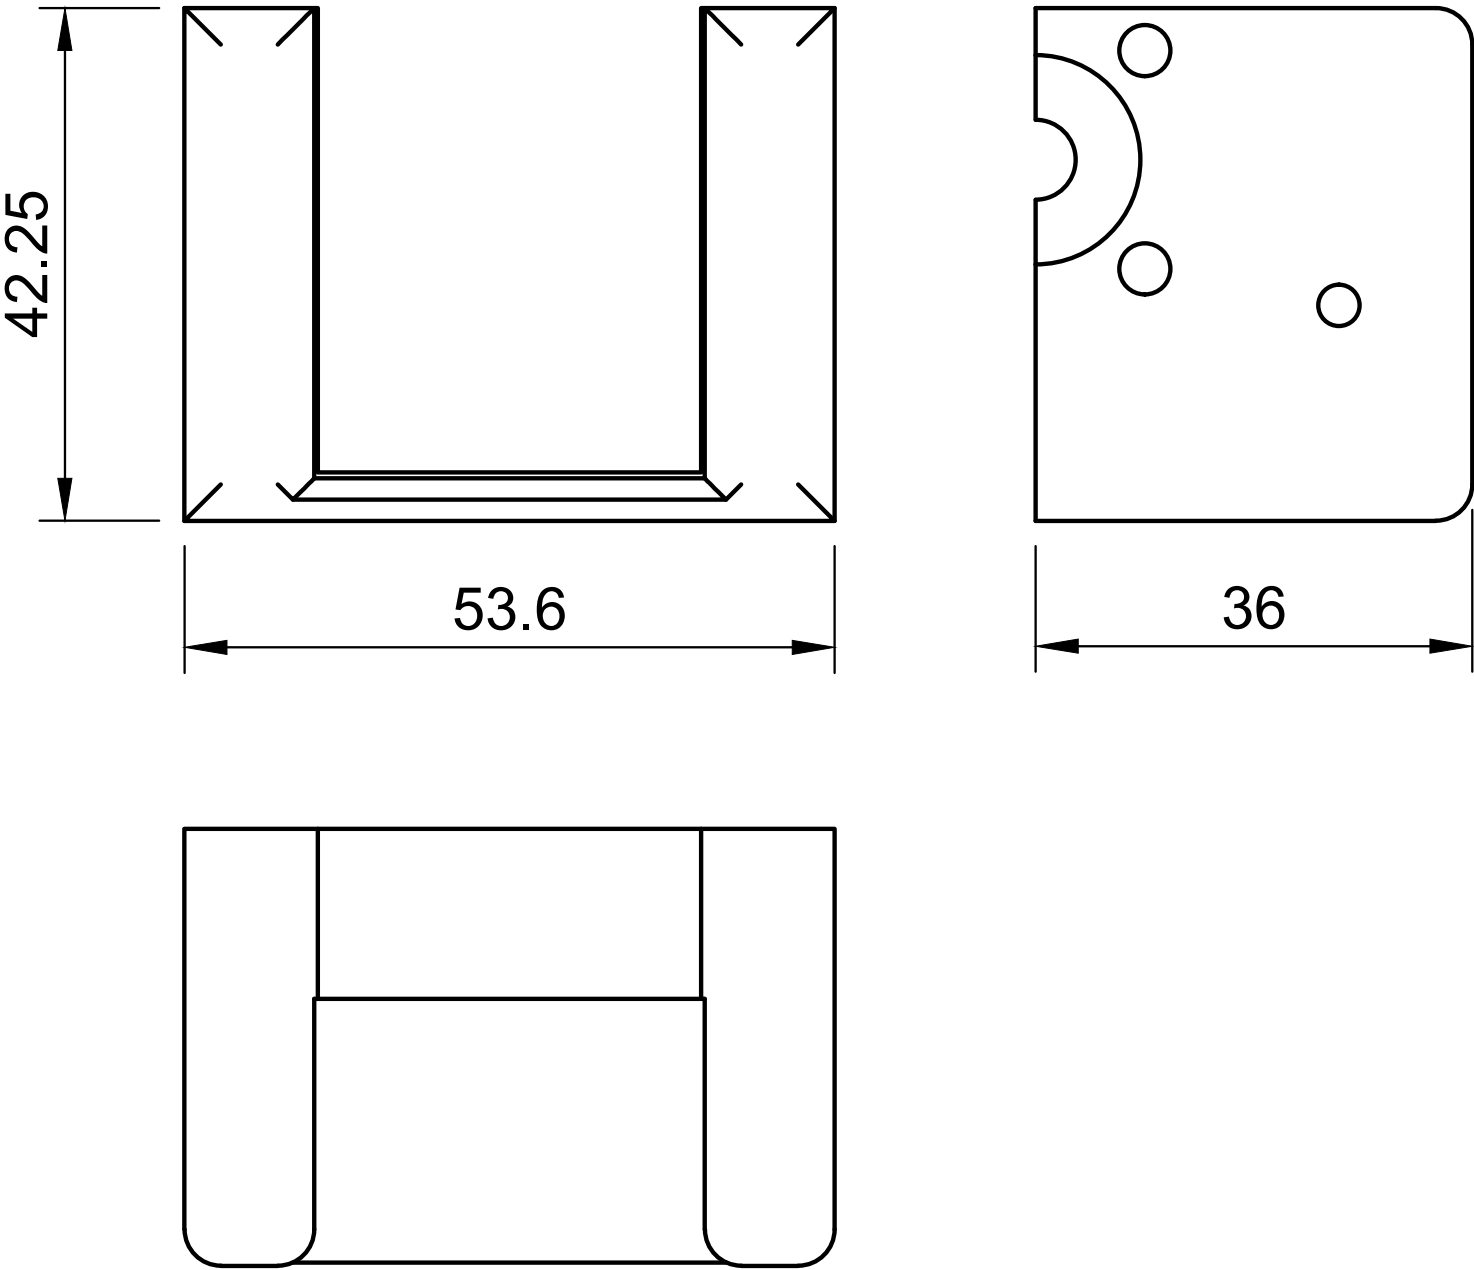

COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-02 (ISO 2768-m)	
Altura de Bloque Pivotante:	41.60 ± 0.20 mm
Ancho de Alojamiento de Eje:	38.20 ± 0.20 mm
Longitud de Base del Soporte:	34.00 ± 0.20 mm
Alojamiento Rodamientos 606RS:	2x Ø 17.00 H7 (+0.018 / 0.000 mm) Prof. 6.0 mm
Diámetro de Paso para Eje de Articulación:	Ø 6.00 mm libre
Taladros para Placa de Sensor AS5600:	2x M2.5x0.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Soporte Tobillo A3 (Cubo Pivote J2)	CÓDIGO / DWG NO.: P-02	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Tri-Hexagonal) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 53.2 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 4/9