

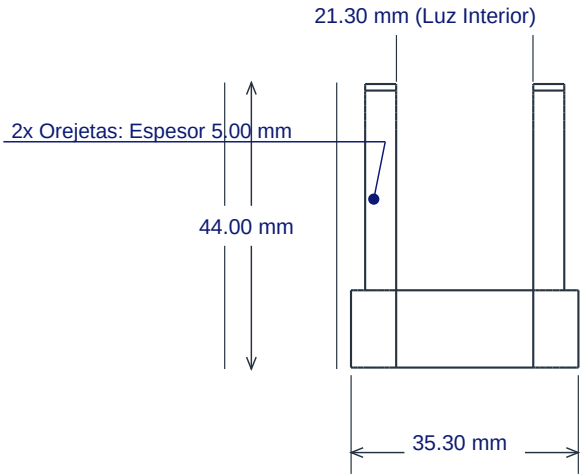


PROYECCIONES TÉCNICAS Y COTAS FUNCIONALES · P-04: PLANTA PIE ESTRUCTURAL A5 (BASE)

PARÁMETROS CINEMÁTICOS DE ARTICULACIÓN SAGITAL (BASE A5)	
Brazo de Palanca Cinemático (R):	12.00 ± 0.02 mm entrecentros [J2 a J5] (CRÍTICO)
Barrenos Eje Sagital Principal (J2):	2x Ø 5.92 mm (+0.05 / 0.00 mm) para eje Ø 6.00 mm
Barrenos Pasador Horquilla (J5):	2x Ø 3.90 mm (+0.05 / 0.00 mm) para pasador Ø 4.00 mm
Altura de Centros de Giro a Suelo:	37.00 ± 0.10 mm (Garantiza despeje articular)
Alojamientos Celdas de Carga:	2x cavidades [42.0 x 42.0 x 7.5 mm] (Talón y Antepié)
Sujeción de Componentes / Carenado:	8x Insertos roscados térmicos de latón M3x0.5 x 6 mm
Material y Densidad de Impresión:	PLA Pro al 100% infill (Tri-Hexagonal) · Masa 49.7 g

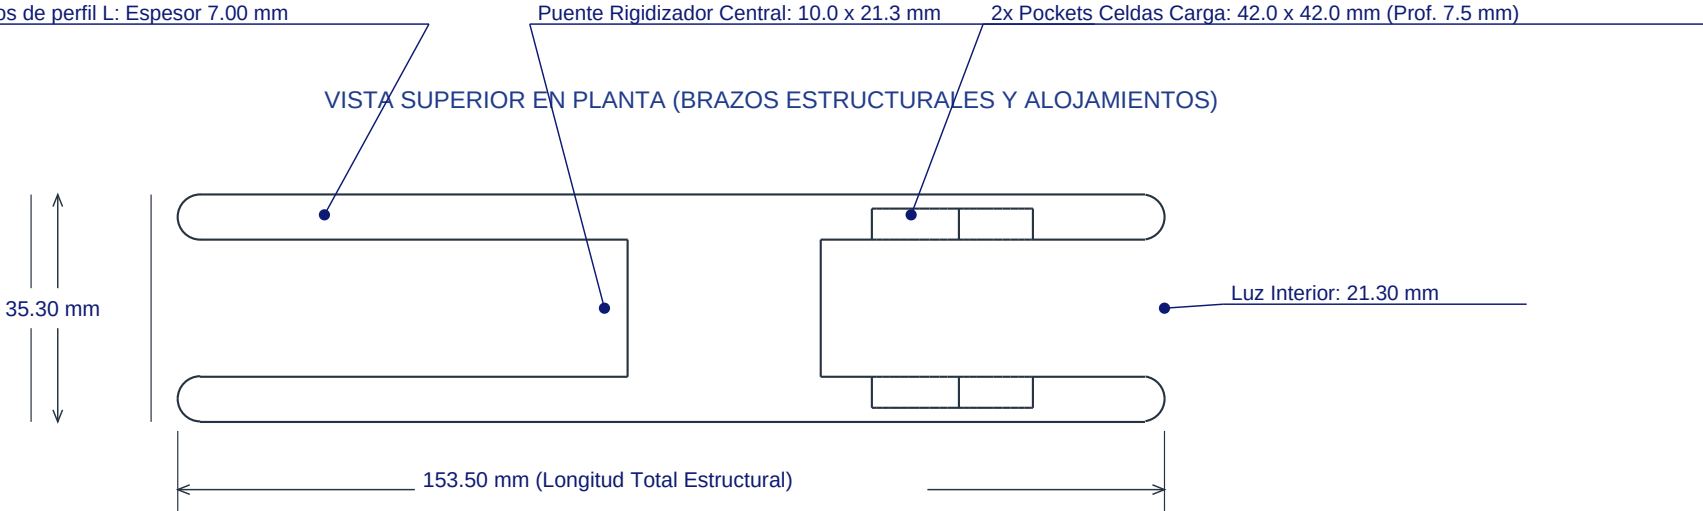

VISTA FRONTAL TRANSVERSAL (CANAL EN U)

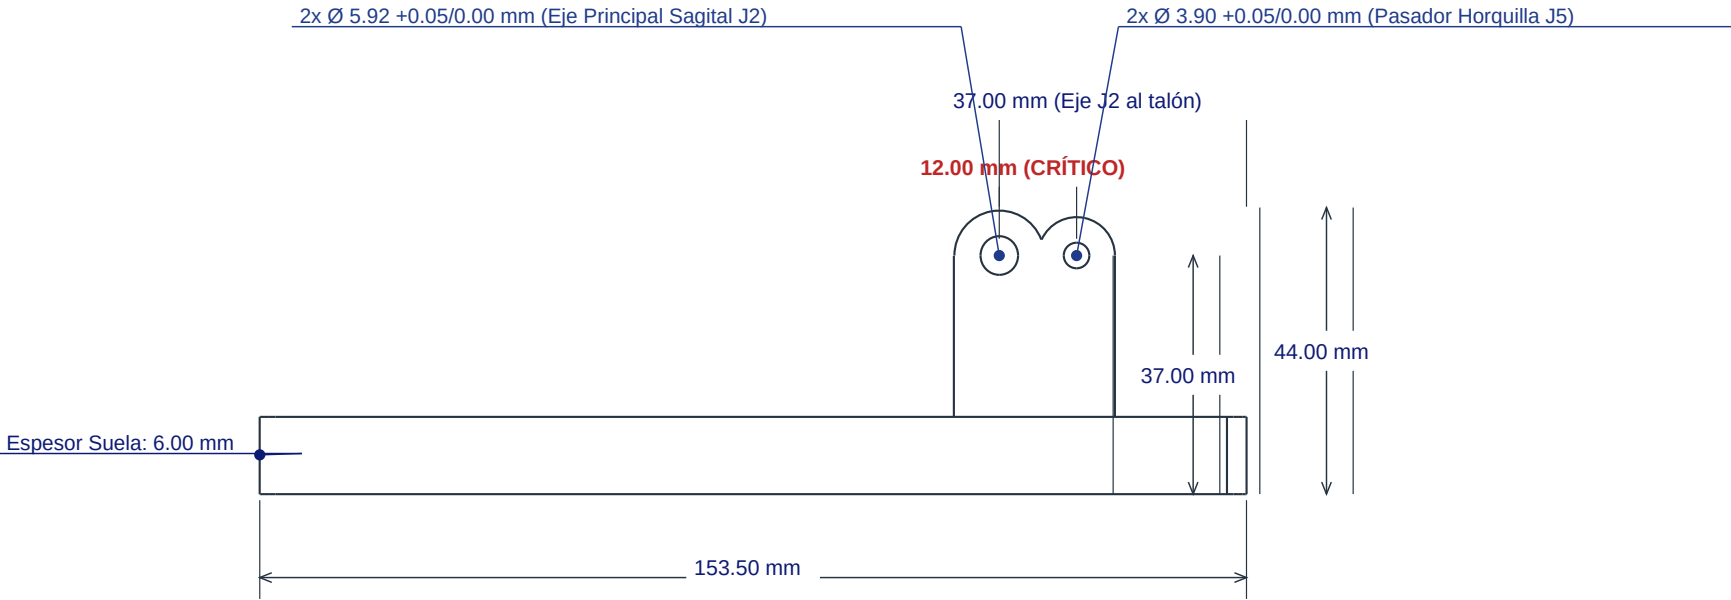

VISTA LATERAL DE ELEVACIÓN SAGITAL (OREJETAS DE ARTICULACIÓN J2 / J5)

COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-04 (ISO 2768-m)	
Longitud Total Estructural de la Planta (X):	153.50 ± 0.20 mm (Longitud estructural base)
Ancho Exterior Mediolateral (Z):	35.30 ± 0.15 mm (Ancho en travesaño y brazos)
Altura Estructural Total (Y):	44.00 ± 0.15 mm (Base a cúspide de orejetas)
Brazo de Palanca Cinemático (J2 a J5):	12.00 ± 0.02 mm (CRÍTICO: Relación de transmisión)
Barrenos Eje Principal J2:	2x Ø 5.92 (+0.05 / 0.00 mm) [Ajuste interferencia leve]
Barrenos Pasador de Horquilla J5:	2x Ø 3.90 (+0.05 / 0.00 mm) [Ajuste deslizante fino]
Altura Centro de Barrenos Articulares:	37.00 ± 0.10 mm desde plano base inferior
Distancia Posterior a Eje Sagital J2:	37.00 ± 0.15 mm desde borde de talón
Separación Interior Entre Orejetas:	21.30 ± 0.10 mm (Ajuste H9/d9 con Soporte A3)
Cavidades Celdas de Carga y Suelo:	2x [42.0 x 42.0 mm] · Espesor de suelo continuo 4.5 mm

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO:	CÓDIGO / DWG NO.:	
Planta Pie Estructural A5 (Base)	P-04	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Alta Resistencia) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 49.7 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 6/9