
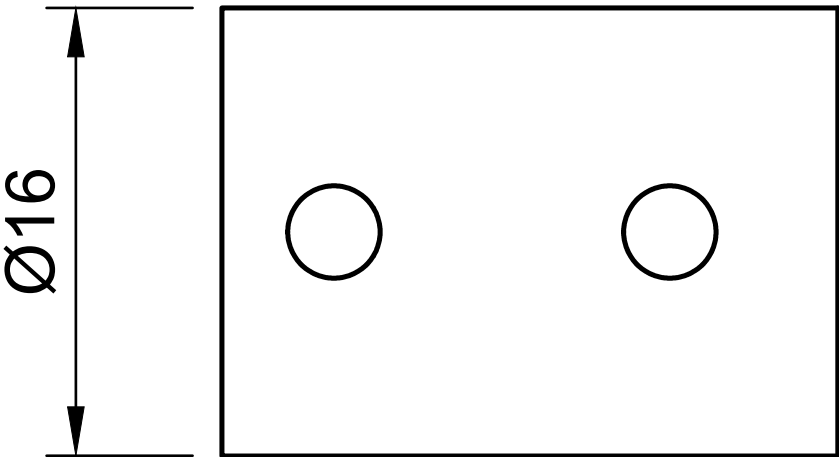
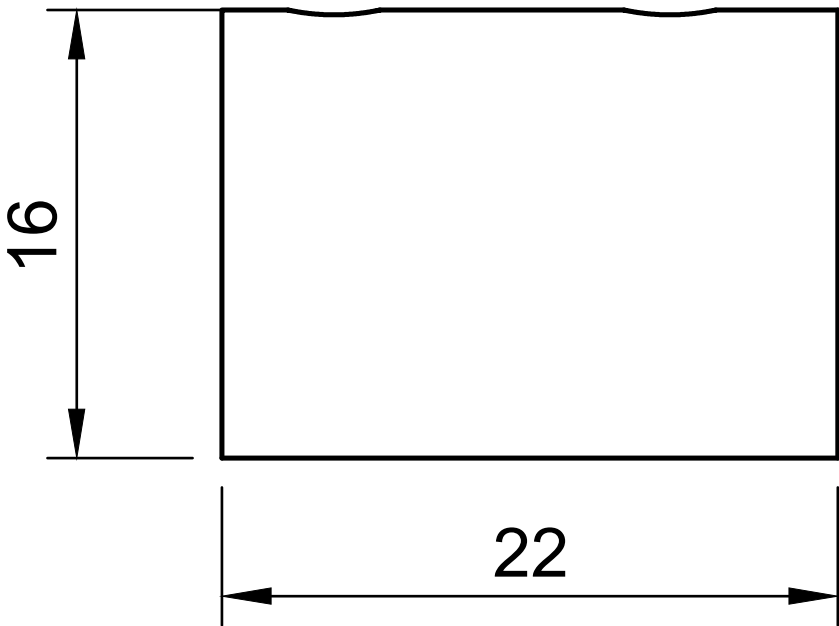


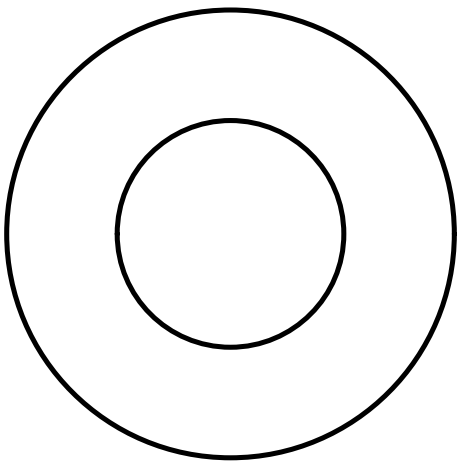

COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-07 (ISO 2768-m)	
Longitud Total del Acople:	22.00 ± 0.20 mm
Diámetro Exterior Cilíndrico:	Ø 16.00 ± 0.15 mm
Longitud de Alojamiento Husillo:	16.00 ± 0.15 mm
Diámetro Eje Motor (Lado GA25):	Ø 5.00 H7 (+0.012 / 0.000 mm) con D-Cut
Diámetro Eje Husillo (Lado T8):	Ø 8.00 H7 (+0.015 / 0.000 mm)
Roscas Prisioneros de Fijación:	2x M3x0.5 a 90° entre sí

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Acople Motor-Husillo B7	CÓDIGO / DWG NO.: P-07	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Sólido) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 4.5 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 9/9