

Prévalence de l'antigène D faible au CHU Oran, année 2026

L. NOUICER, S. BELFEKROUN, T. DEBA, S. AYAD, A. GHOZALI, MA. MOUEDEN

1Centre Hospitalo-Universitaire d’Oran
2Faculté de médecine d’Oran, Université d’Oran1


Introduction

Le groupage RH1 est un test indissociable du groupage ABO. Tout groupage D négatif chez le donneur de sang est obligatoirement complété par la recherche de l'Ag D faible par un test indirect à l’antiglobuline polyvalente (TIA) et par la recherche des antigènes C et E.

Objectif: Rapporter la prévalence de l’antigène D faible chez les donneurs et les patients receveurs de sang.


Matériels et méthode

- Etude rétrospective et descriptive s'étalant du 1er janvier au 31 mai 2026.
- 8 870 groupages sanguins ABO-RH1 effectués des donneurs de sang et des patients adressés à l’unité d’immunohématologie de la banque de sang du CHU d'Oran.
- Recherche de l'Ag D faible : TIA sur carte gel par technique de microfiltration.
- Recherche des Ag CDE : réaction d’agglutination sur plaque d’opaline, avec réactif monoclonal Ultracare Anti-CDE.

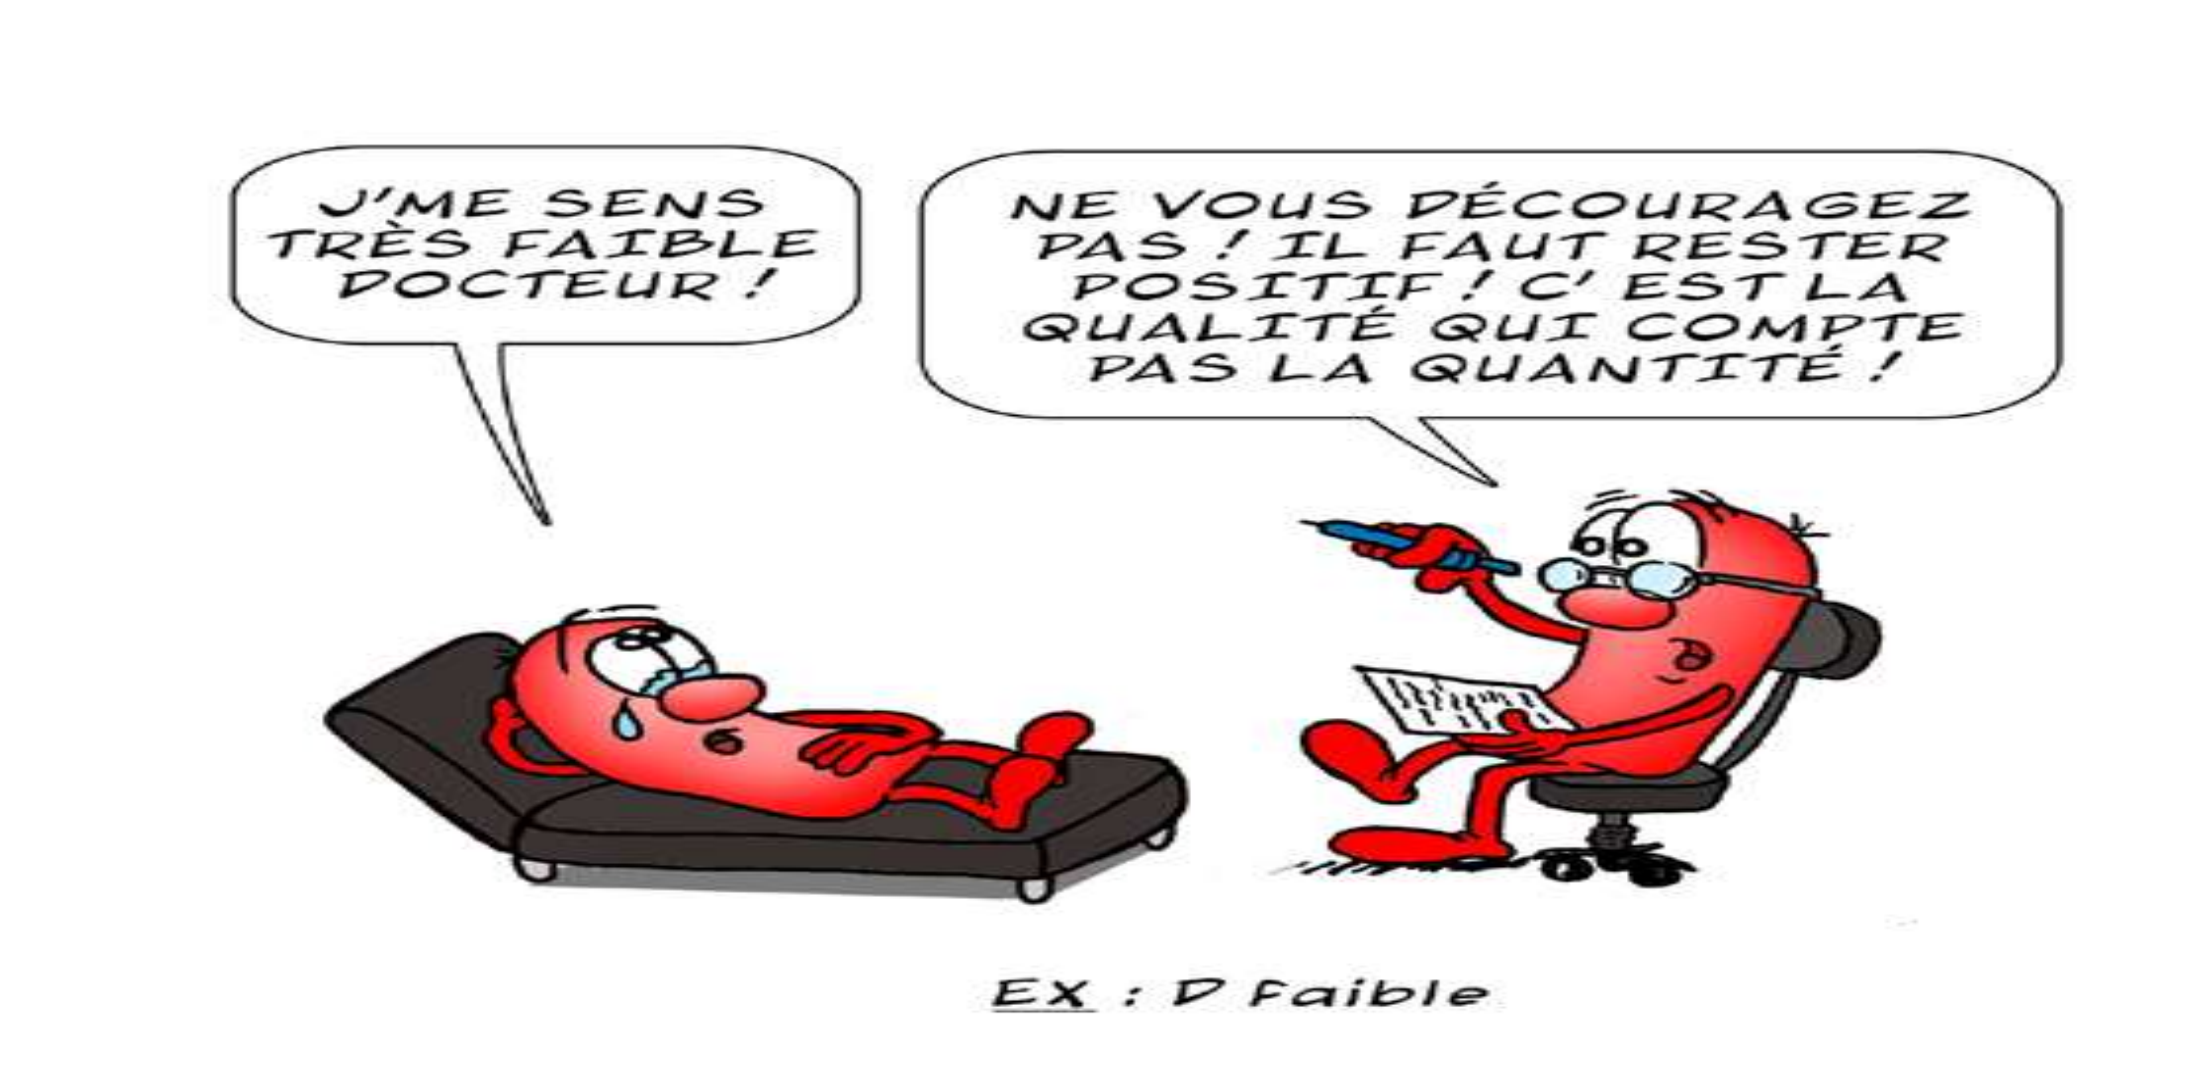

Résultats

- 631 / 8 870 groupages effectués se sont révélés négatifs(**7,11 %**).
- 25 ont réagi positivement avec le réactif anti-CDE (**0,28 % de l'ensemble des donneurs**) et (**3,96 % des RH-1**).
- 10 échantillons ont donné un résultat positif à la recherche de l’Ag D par TIA (**0,11 % des donneurs et 1,58 % des RH-1**).
- 2 cas de réactions discordantes au système Rhésus ont été observées avec l'utilisation de deux réactifs différents
- ✓ Un même prélèvement a réagi positivement avec les réactifs anti-D des laboratoires Diagnopharm et Cypress, et négativement avec l’anti-D du laboratoire Ultracare, sur les deux supports (plaque d’opaline et carte gel).
- ✓ La recherche de l’antigène D faible par TIA sur carte gel est revenue positive avec les trois réactifs cités. La patiente a été étiquetée « Rhésus D faible ou partiel » . Elle doit être traitée comme « Rhésus D négatif » pour les transfusions et « Rhésus D positif » pour les dons de sang.

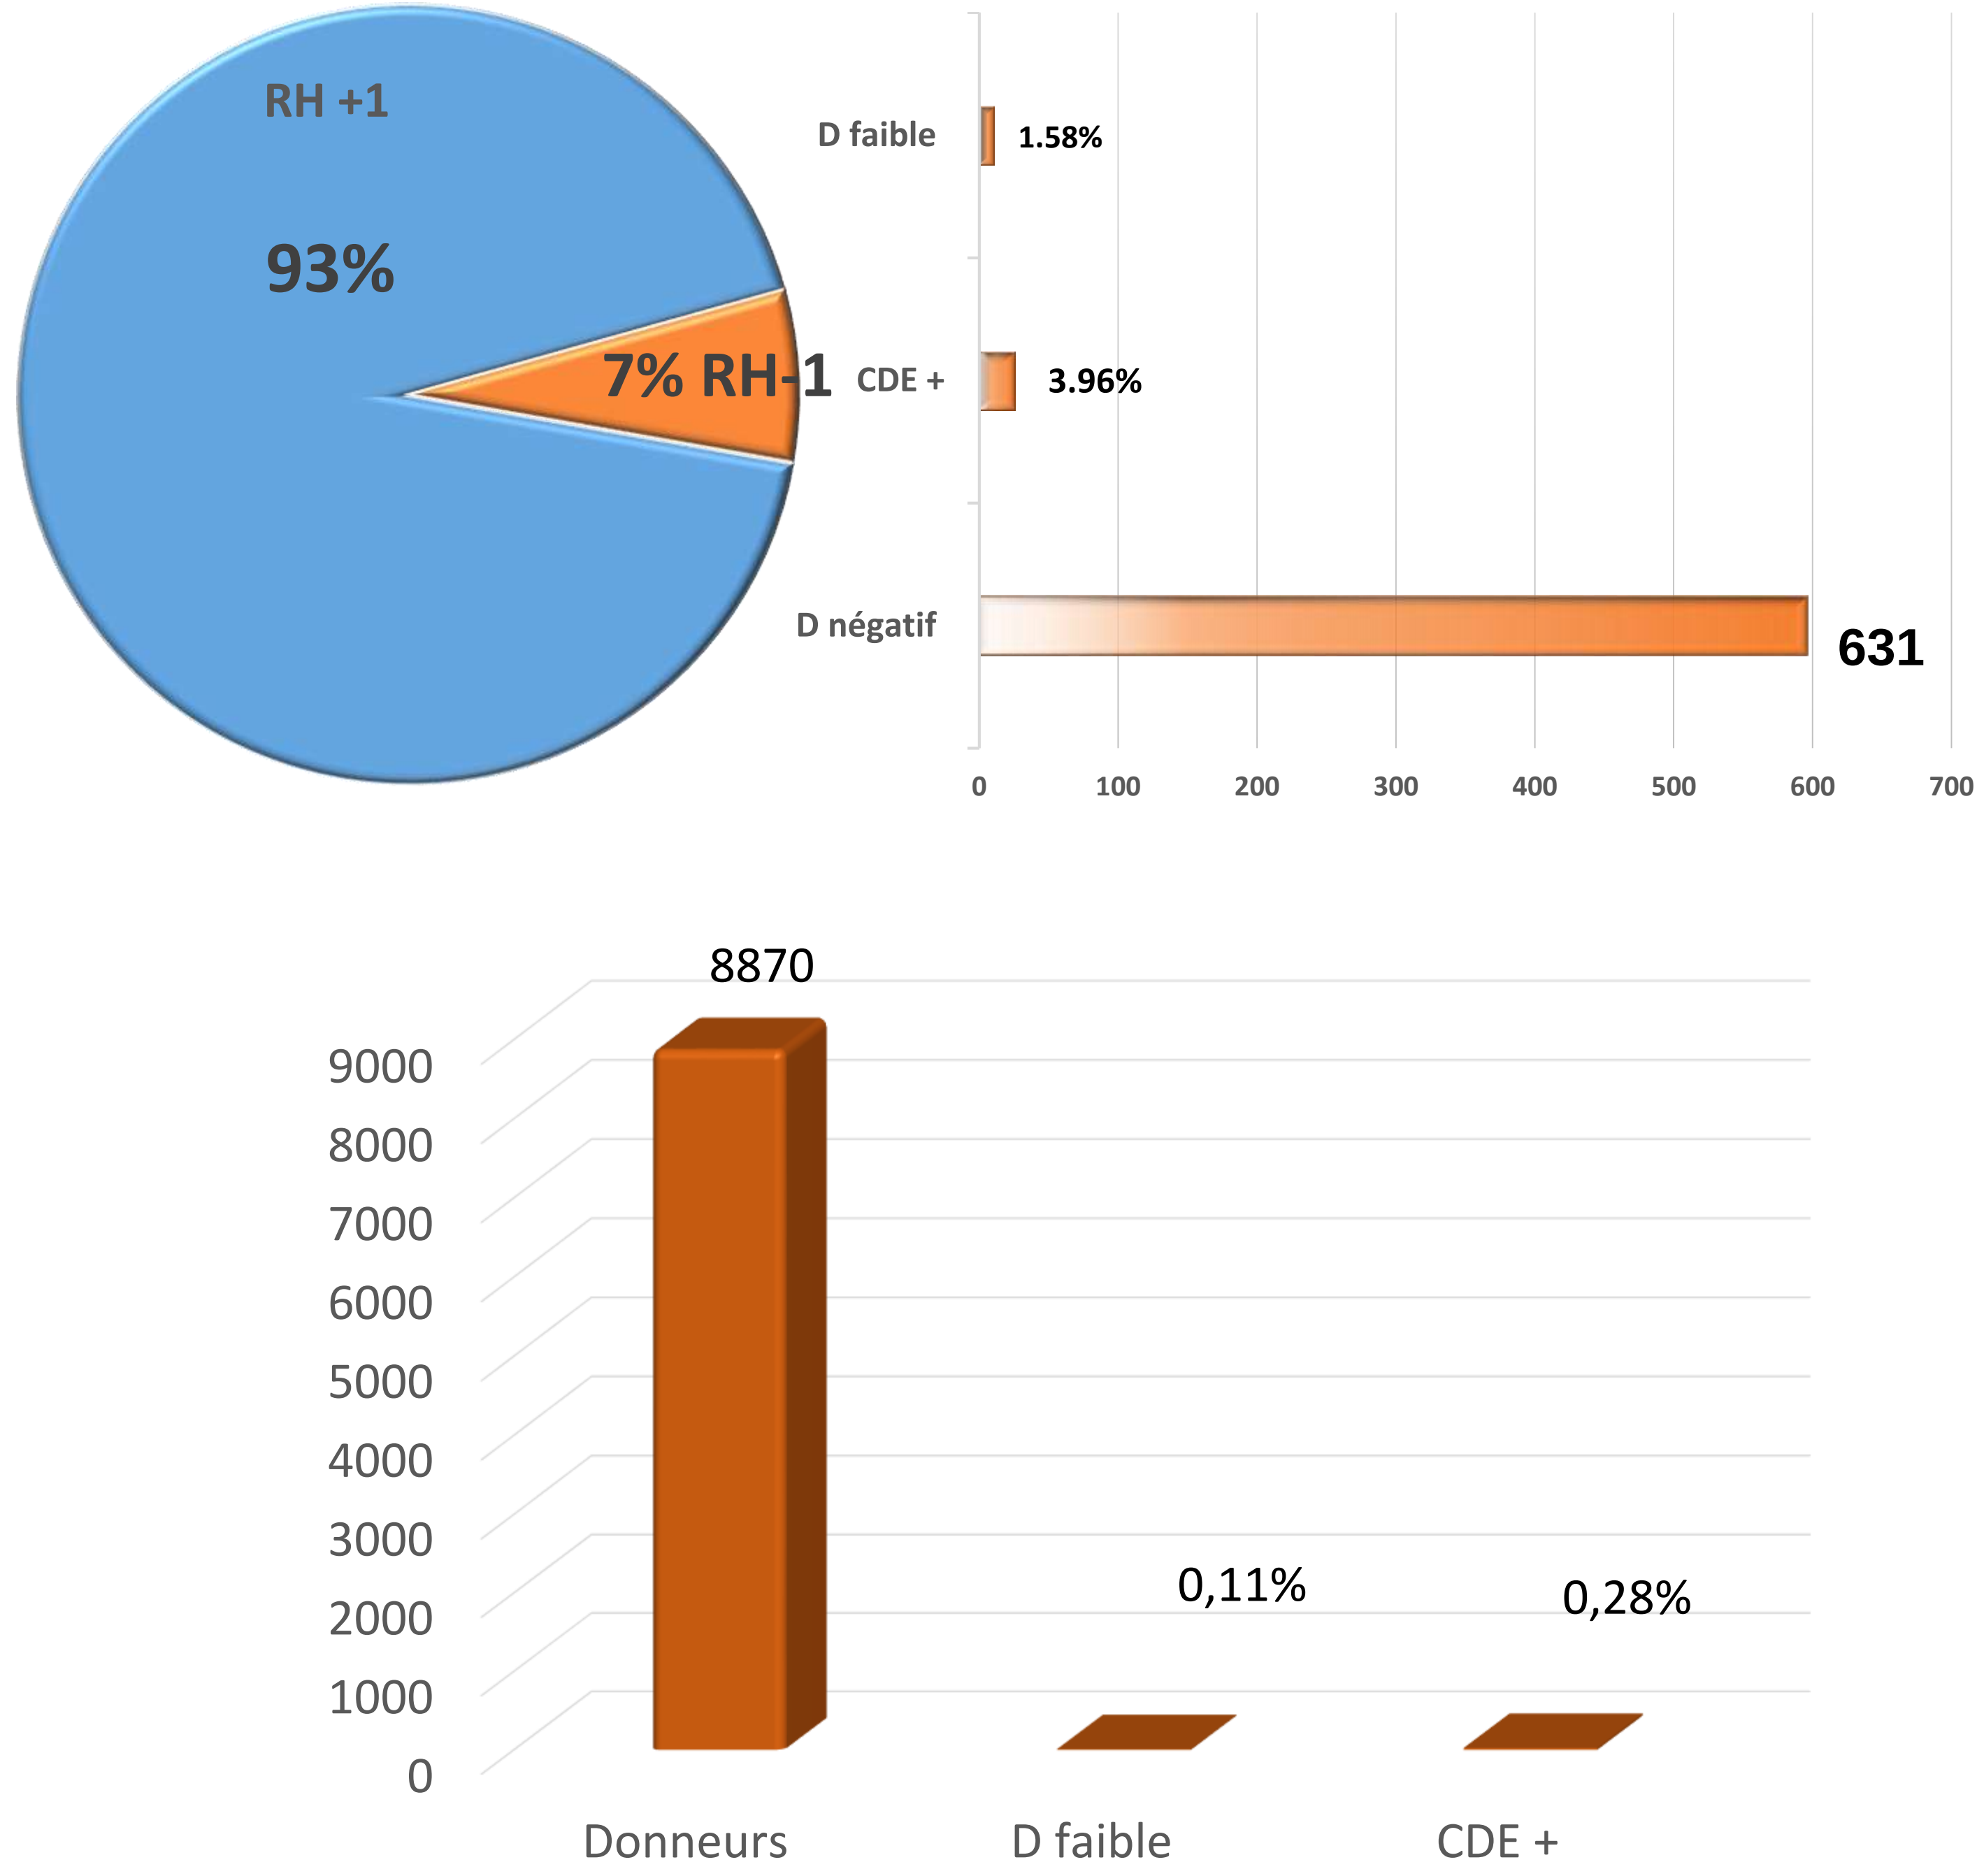

Discussion

- Prévalence globale de l'antigène D faible (**0,11 %**) est comparable avec celle du Maroc (**0,4 %**) et des Caucasiens (**0,2 % à 1 %**).
- Prévalence du phénotype D faible chez les donneurs RH-1 est de **1,58 %**, Ce résultat est proche de ceux des études de **Taouli KA (2,26 %)**, de **Khachaa B et al (2,78 %)** et En **Égypte (2,24 %)**
- Intérêt du génotypage du Rhésus D +++ .

Conclusion

- Bien que la prévalence de l’antigène D faible soit minime chez les donneurs de sang, sa recherche reste une préoccupation majeure en raison de sa forte immunogénicité.
- Les porteurs de l’Ag D faible doivent être informés de leur statut et traités comme des donneurs positifs et des receveurs négatifs.

Références

1 - Taouli KA. Évaluation de la recherche du phénotype D faible chez les donneurs de sang : expérience du centre de transfusion sanguine, CWS Tlemcen (Algérie). Transfus Clin Biol. 2017 ;2.
2 - Khachaa.B, El Horri.M, Berrah.A, Chikh.K, Benmahdi.L. La recherche de phénotype D faible chez une population de donneurs de sang militaires : Première expérience documentée de la banque du sang de l’hôpital universitaire d’Oran 2019 ;6(2) :923-7.
3 - Z. Kabiri, M. Benajiba, K. Hajjout, N. Dakka, et H. Bellaoui, « Prévalence du phénotype Rh D faible chez les donneurs de sang Rh D négatif au Maroc », *Immuno-Anal. Biol. Spéc.*, vol. 28, n° 1, p. 36-38, févr. 2013, doi: 10.1016/j.immbio.2012.09.003.