
S2-06 / EVIDENCE

反压 7 拍，结果与事务身份保持

0f 历史全核观察器 · cycle 181597 + 横轴偏移

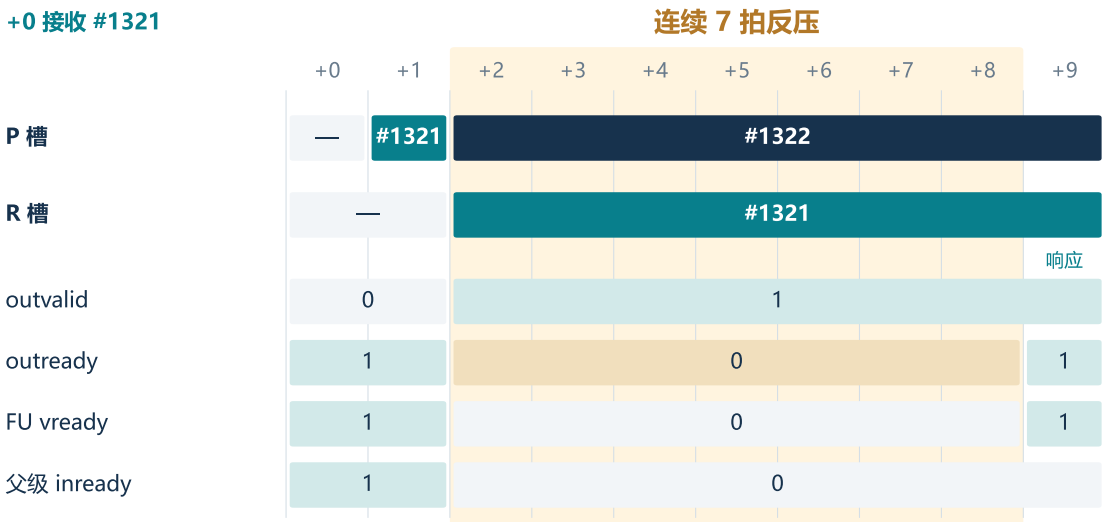

+9：#1321 单次响应，同时 #1322 从 P 转入 R

条带为沿前采样；接收到响应相隔 9 拍，包含 7 拍反压。

完整 128 位结果与控制字段逐行保持；原值、身份与来源见图注及附件。