



DO NOT UPDATE MASTER MANUALLY

REV.	DESCRIPTION	REVISOR	DATE

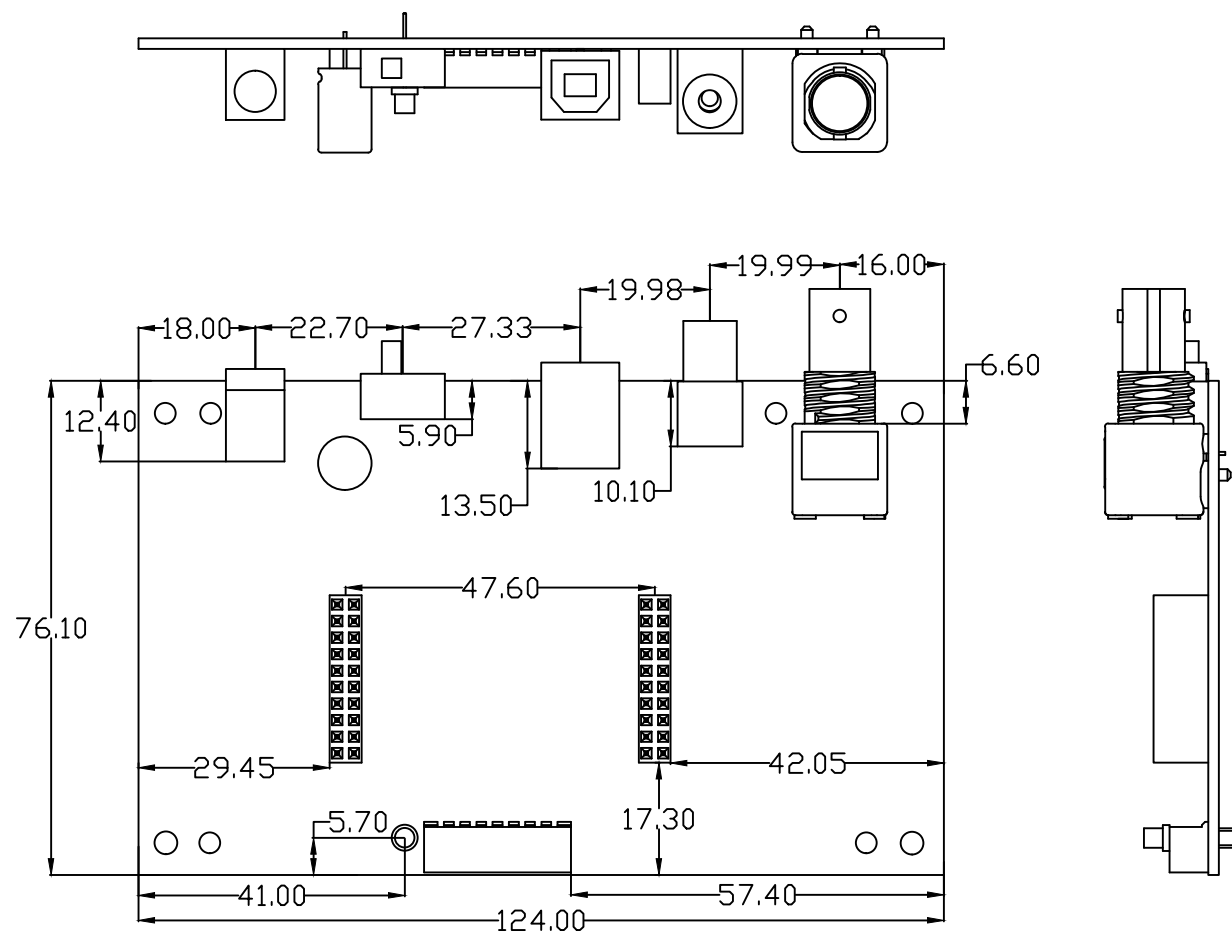

设 计	张雄兵	模号		型号	SP-1000_Lab		名称	PCB
审 核	戴远利							
开模日期		投 影 法	单 位	材 料	缩 水 率	比 例	表面处理	数 量
试模日期			mm			1:1		1
修改日期		东莞市图强电子有限公司						
修改日期								
修改日期								

东莞市图强电子有限公司