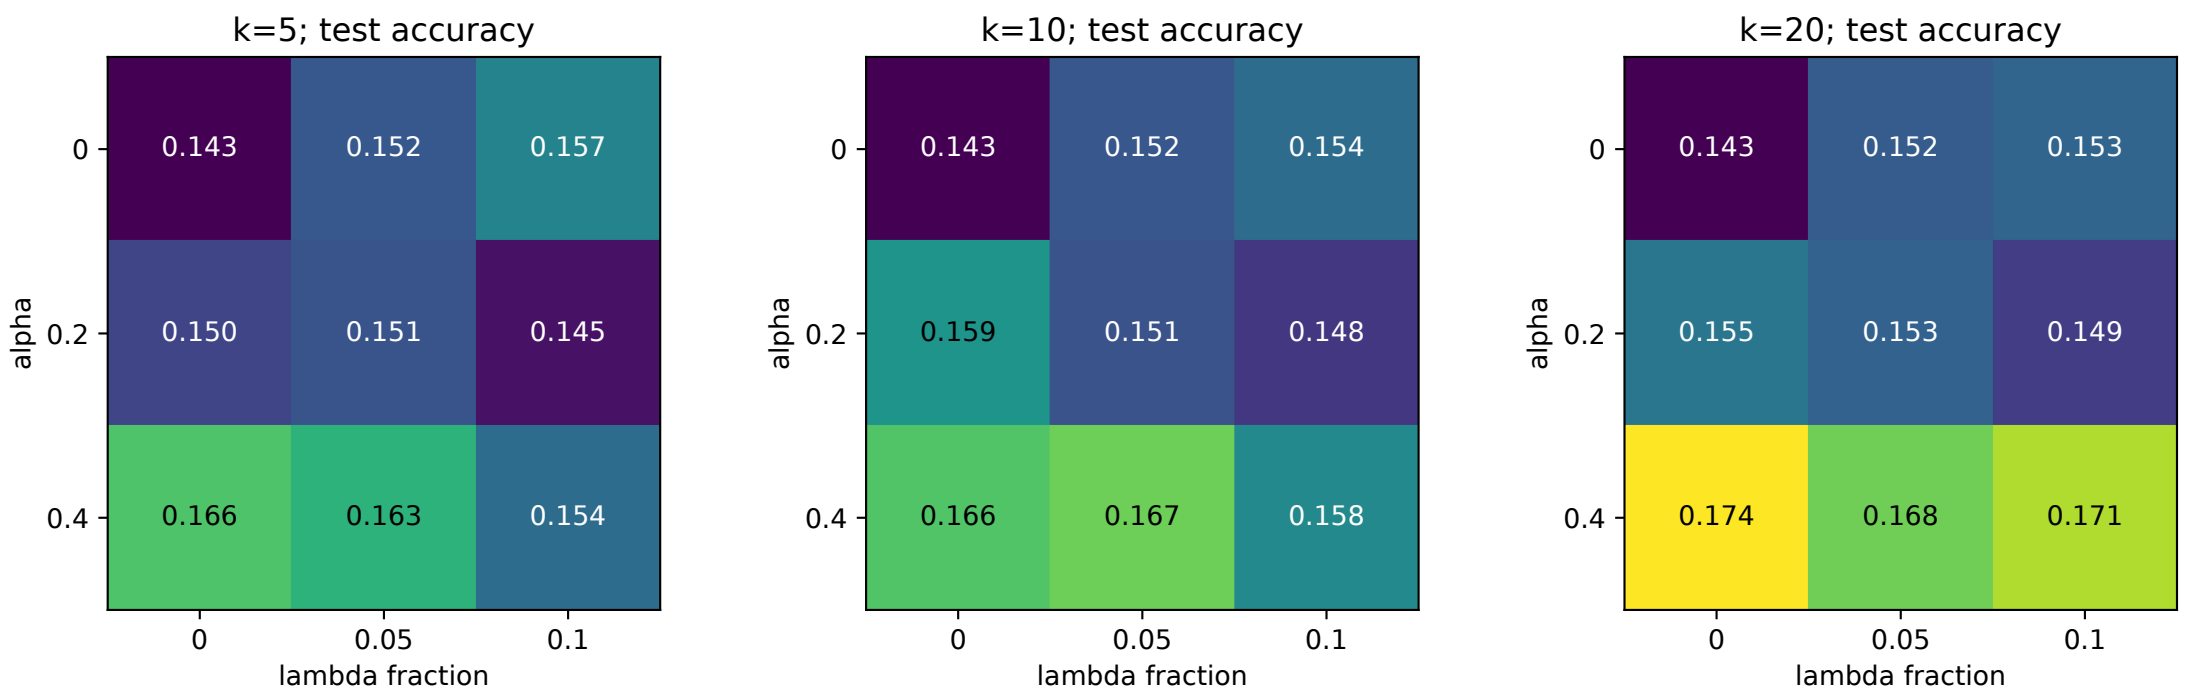
k=5; test accuracy
0.143
0.152
0.157
0.150
0.151
0.145
0.166
0.163
0.154
alpha
0
0.2
0.4
0
0.05
0.1
lambda fraction
k=10; test accuracy
0.143
0.152
0.154
0.159
0.151
0.148
0.166
0.167
0.158
alpha
0
0.2
0.4
0
0.05
0.1
lambda fraction
k=20; test accuracy
0.143
0.152
0.153
0.155
0.153
0.149
0.174
0.168
0.171
alpha
0
0.2
0.4
0
0.05
0.1
lambda fraction