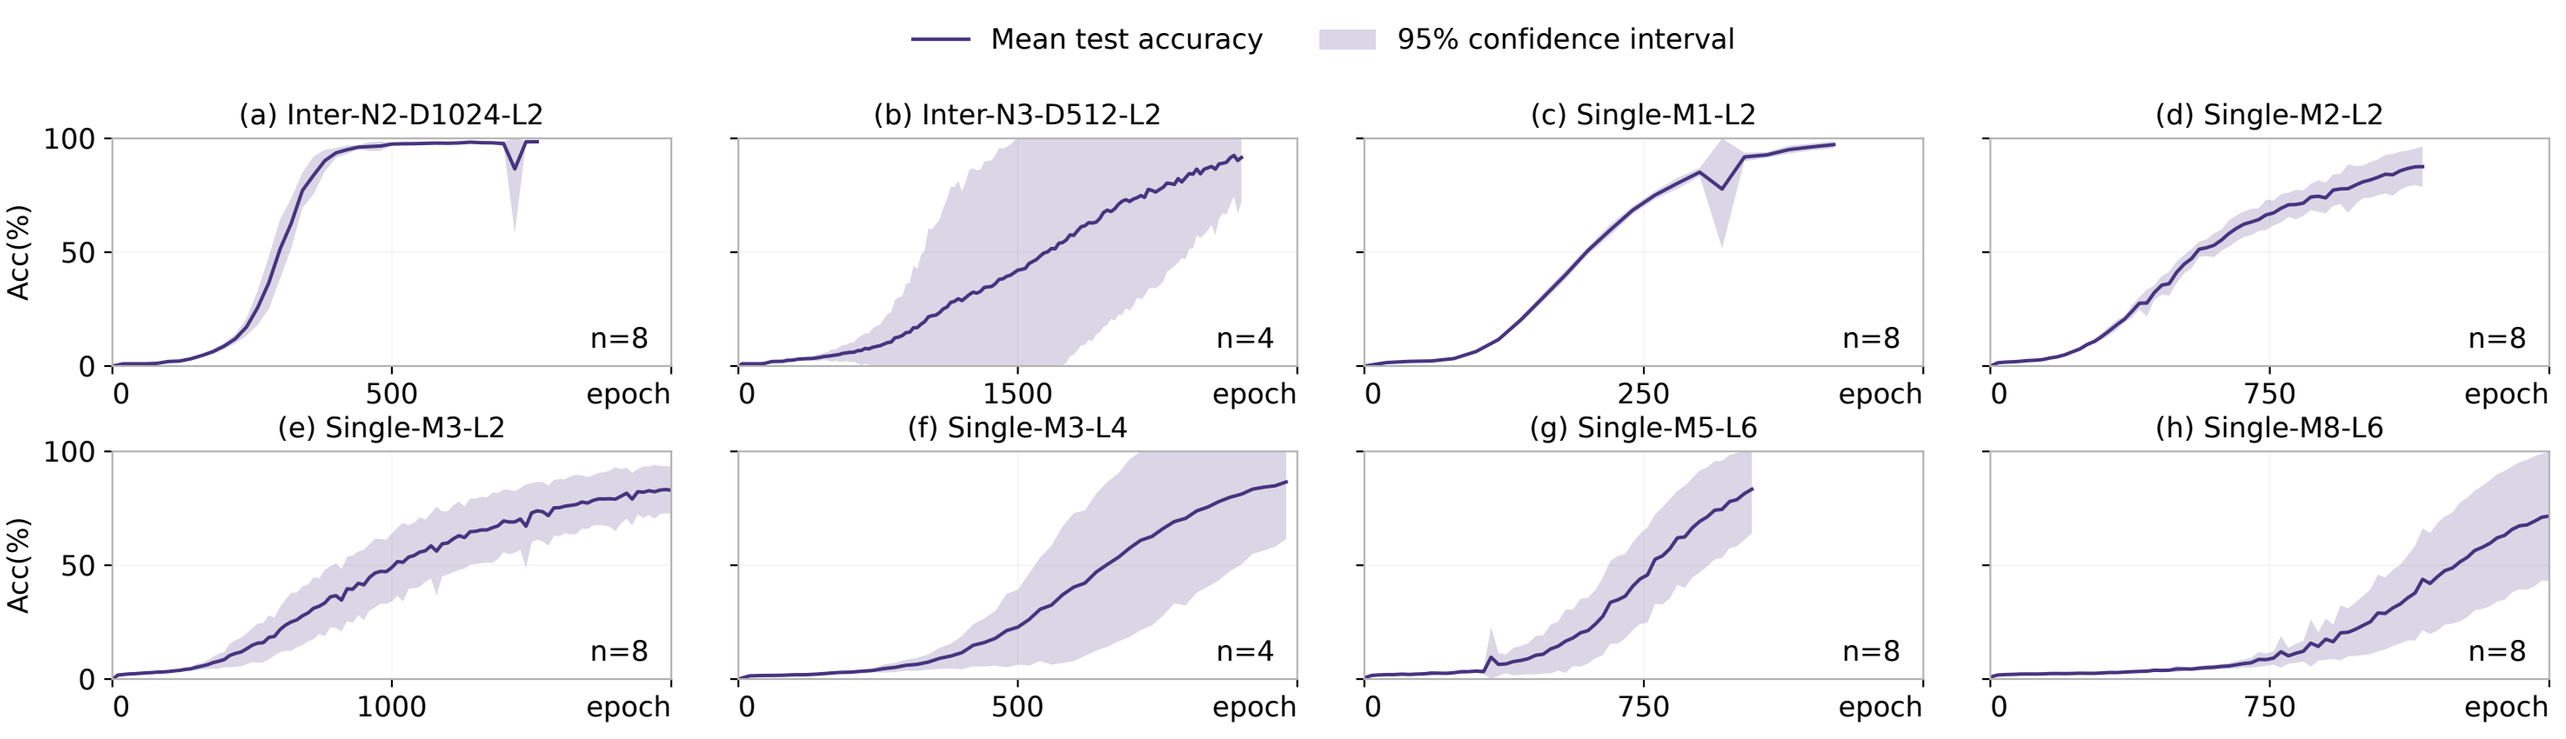
Mean test accuracy
95% confidence interval
(a) Inter-N2-D1024-L2
(b) Inter-N3-D512-L2
(c) Single-M1-L2
(d) Single-M2-L2
(e) Single-M3-L2
(f) Single-M3-L4
(g) Single-M5-L6
(h) Single-M8-L6
Acc(%)
epoch
n=8
n=4
0
50
100
500
1000
1500
250
750