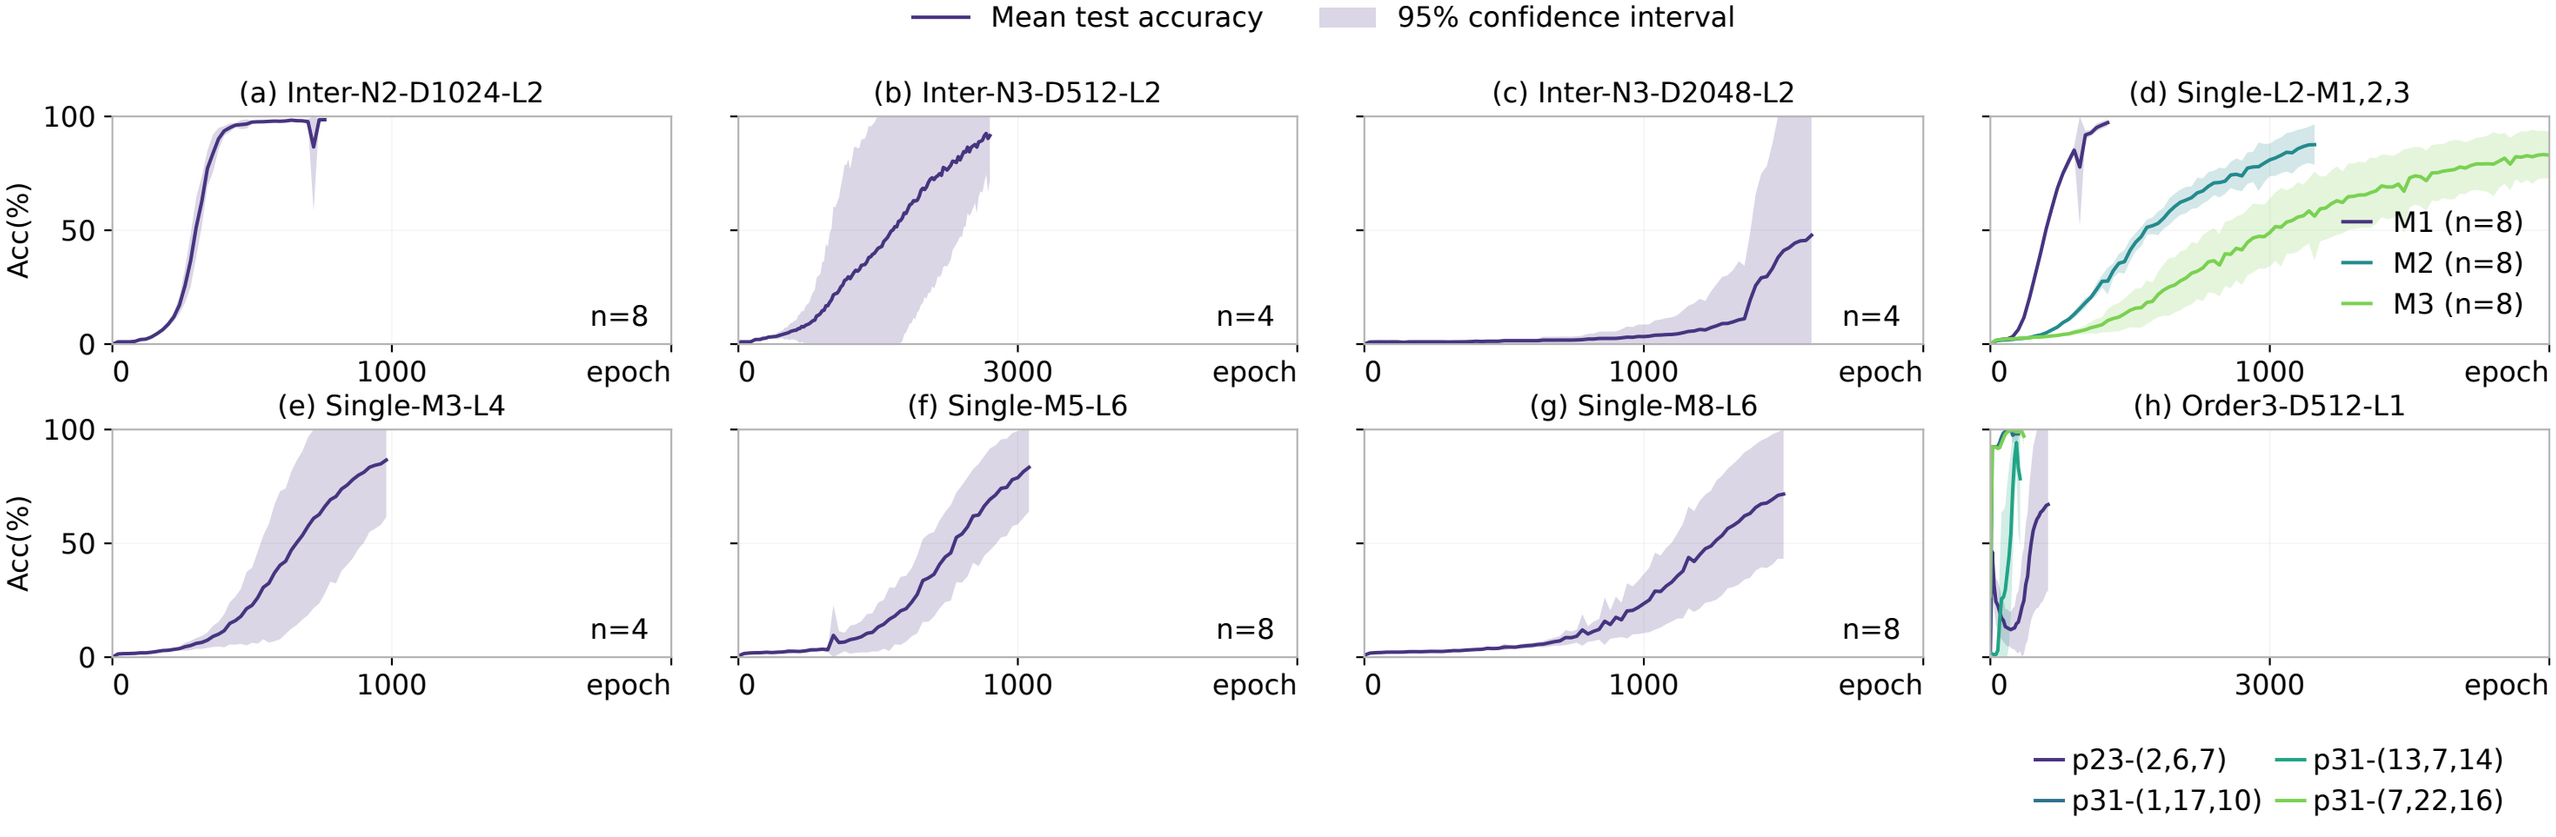
Mean test accuracy
95% confidence interval
(a) Inter-N2-D1024-L2
(b) Inter-N3-D512-L2
(c) Inter-N3-D2048-L2
(d) Single-L2-M1,2,3
(e) Single-M3-L4
(f) Single-M5-L6
(g) Single-M8-L6
(h) Order3-D512-L1
Acc(%)
epoch
n=8
n=4
M1 (n=8)
M2 (n=8)
M3 (n=8)
p23-(2,6,7)
p31-(13,7,14)
p31-(1,17,10)
p31-(7,22,16)