


Retest03\_chamber1\_2018\_04\_17\_fit

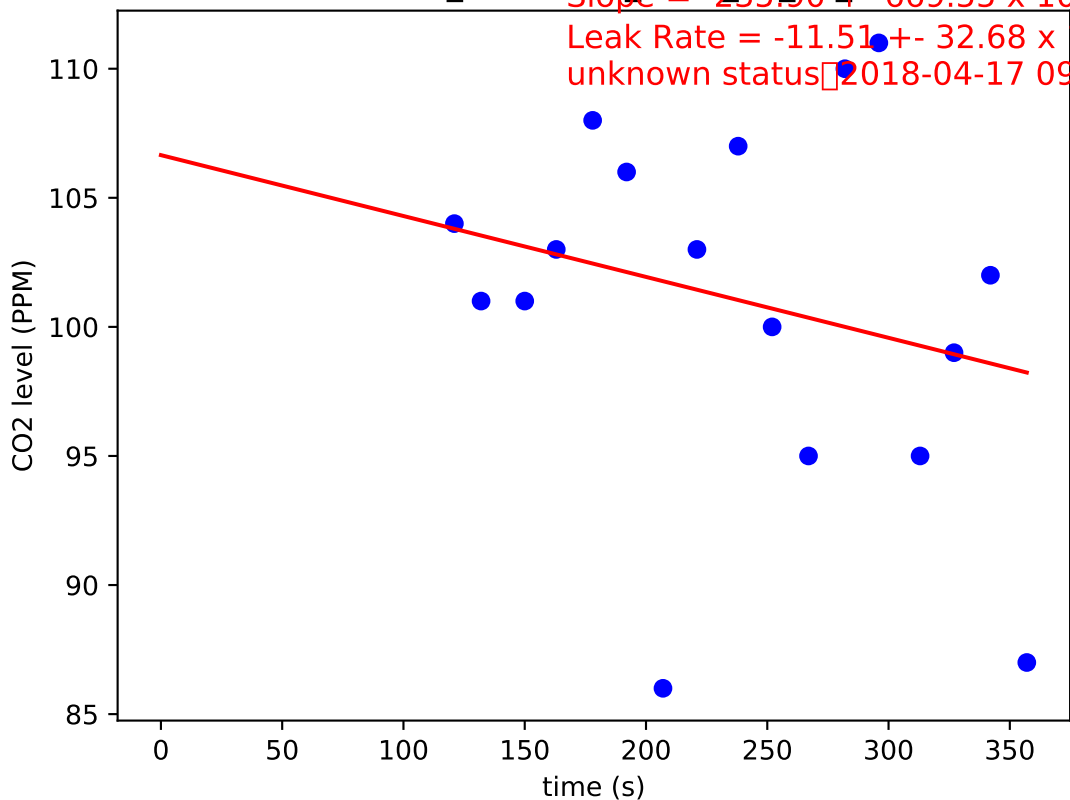

Slope =  $-235.90 \pm 669.55 \times 10^{-3}$  PPM/

Leak Rate =  $-11.51 \pm 32.68 \times 10^{-5}$  cc/

unknown status

2018-04-17 09:44:40