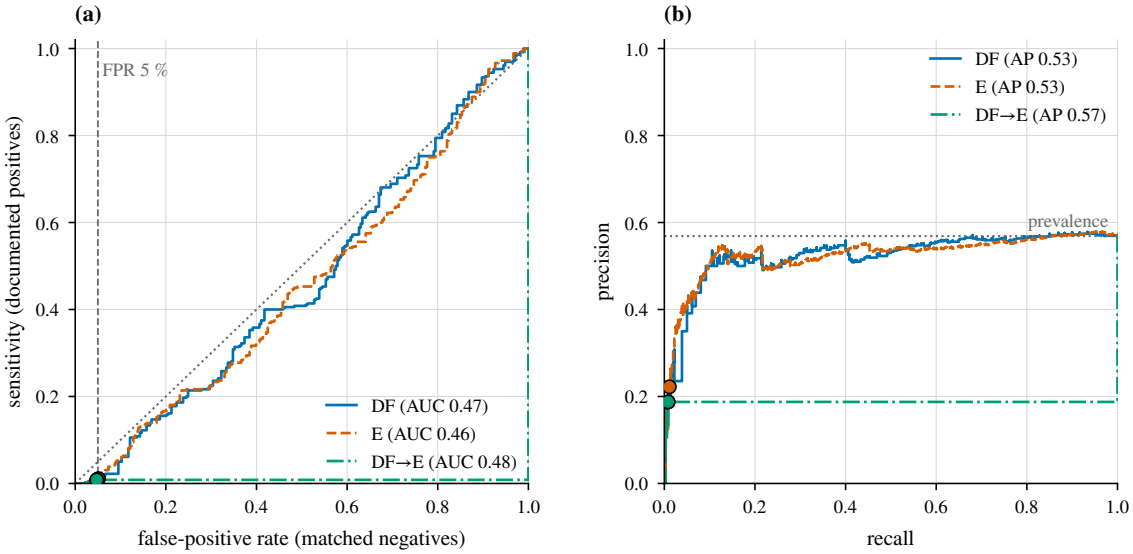
(a)
FPR 5 %
sensitivity (documented positives)
false-positive rate (matched negatives)
DF (AUC 0.47)
E (AUC 0.46)
DF→E (AUC 0.48)
(b)
precision
recall
prevalence
DF (AP 0.53)
E (AP 0.53)
DF→E (AP 0.57)