



昵称

男/42岁 2型糖尿病

CGM激活时间

100.0%

型号(系列)

CT3系列

发射器序列号

SN4740111585

2025/02/19 ~ 2025/03/05(14天)



## 监测结果

有效/测量

6721/6721 次

[查看数据](#)

平均值

7.5 mmol/L

标准差

1.6 mmol/L

变异系数 (CV,%)

21.3 %

HbA1c

6.0 %

GMI

6.5 %

最低值

16.5 mmol/L

4.2 mmol/L

12.3 mmol/L

6.8 %

0 %

93.2 %

3.9~10.0 mmol/L

7.0 mmol/L


7.0 mmol/L

7.0 mmol/L



## TIR 达标情况




## AGP 图谱

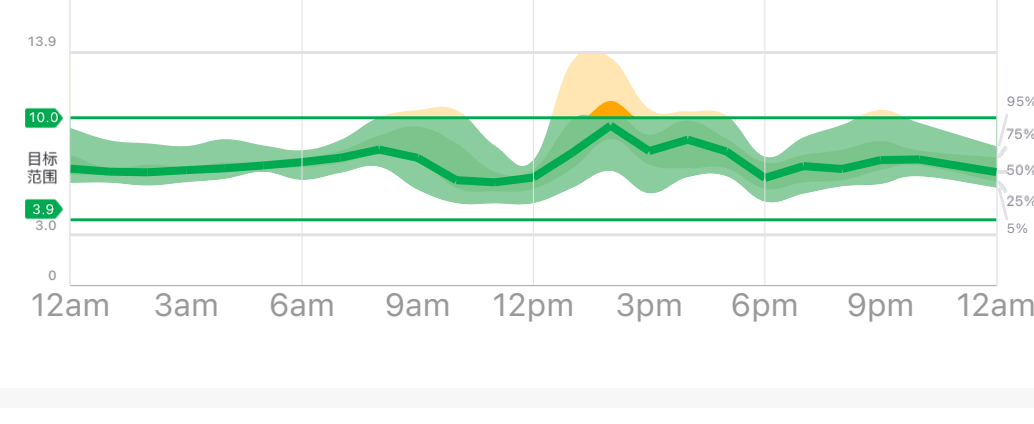

[每日图谱 >](#)

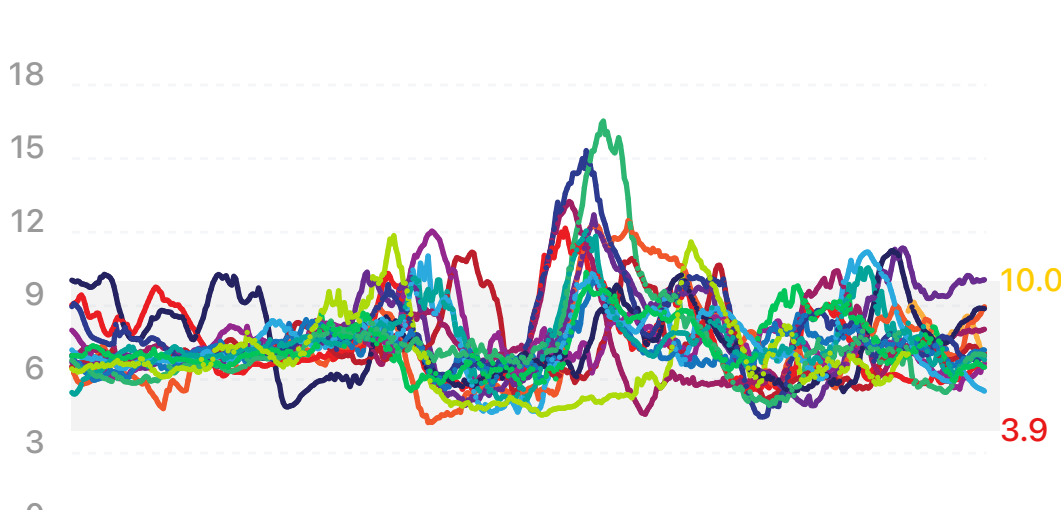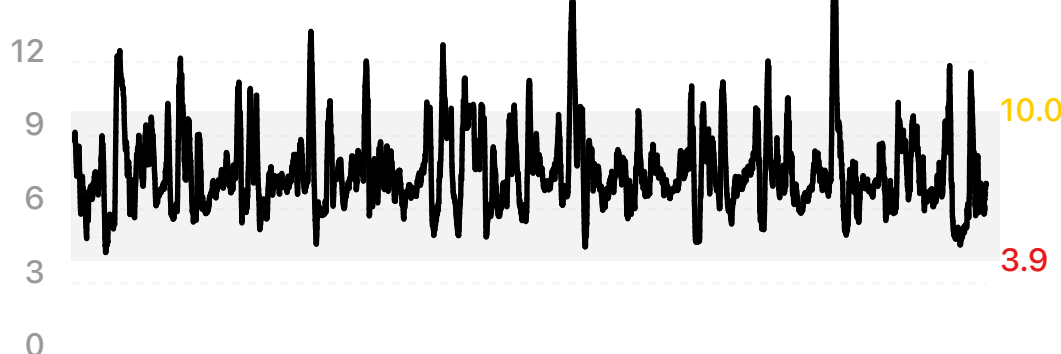

- 第1天
- 第2天
- 第3天
- 第4天
- 第5天
- 第6天
- 第7天
- 第8天
- 第9天
- 第10天
- 第11天
- 第12天
- 第13天
- 第14天
- 第15天

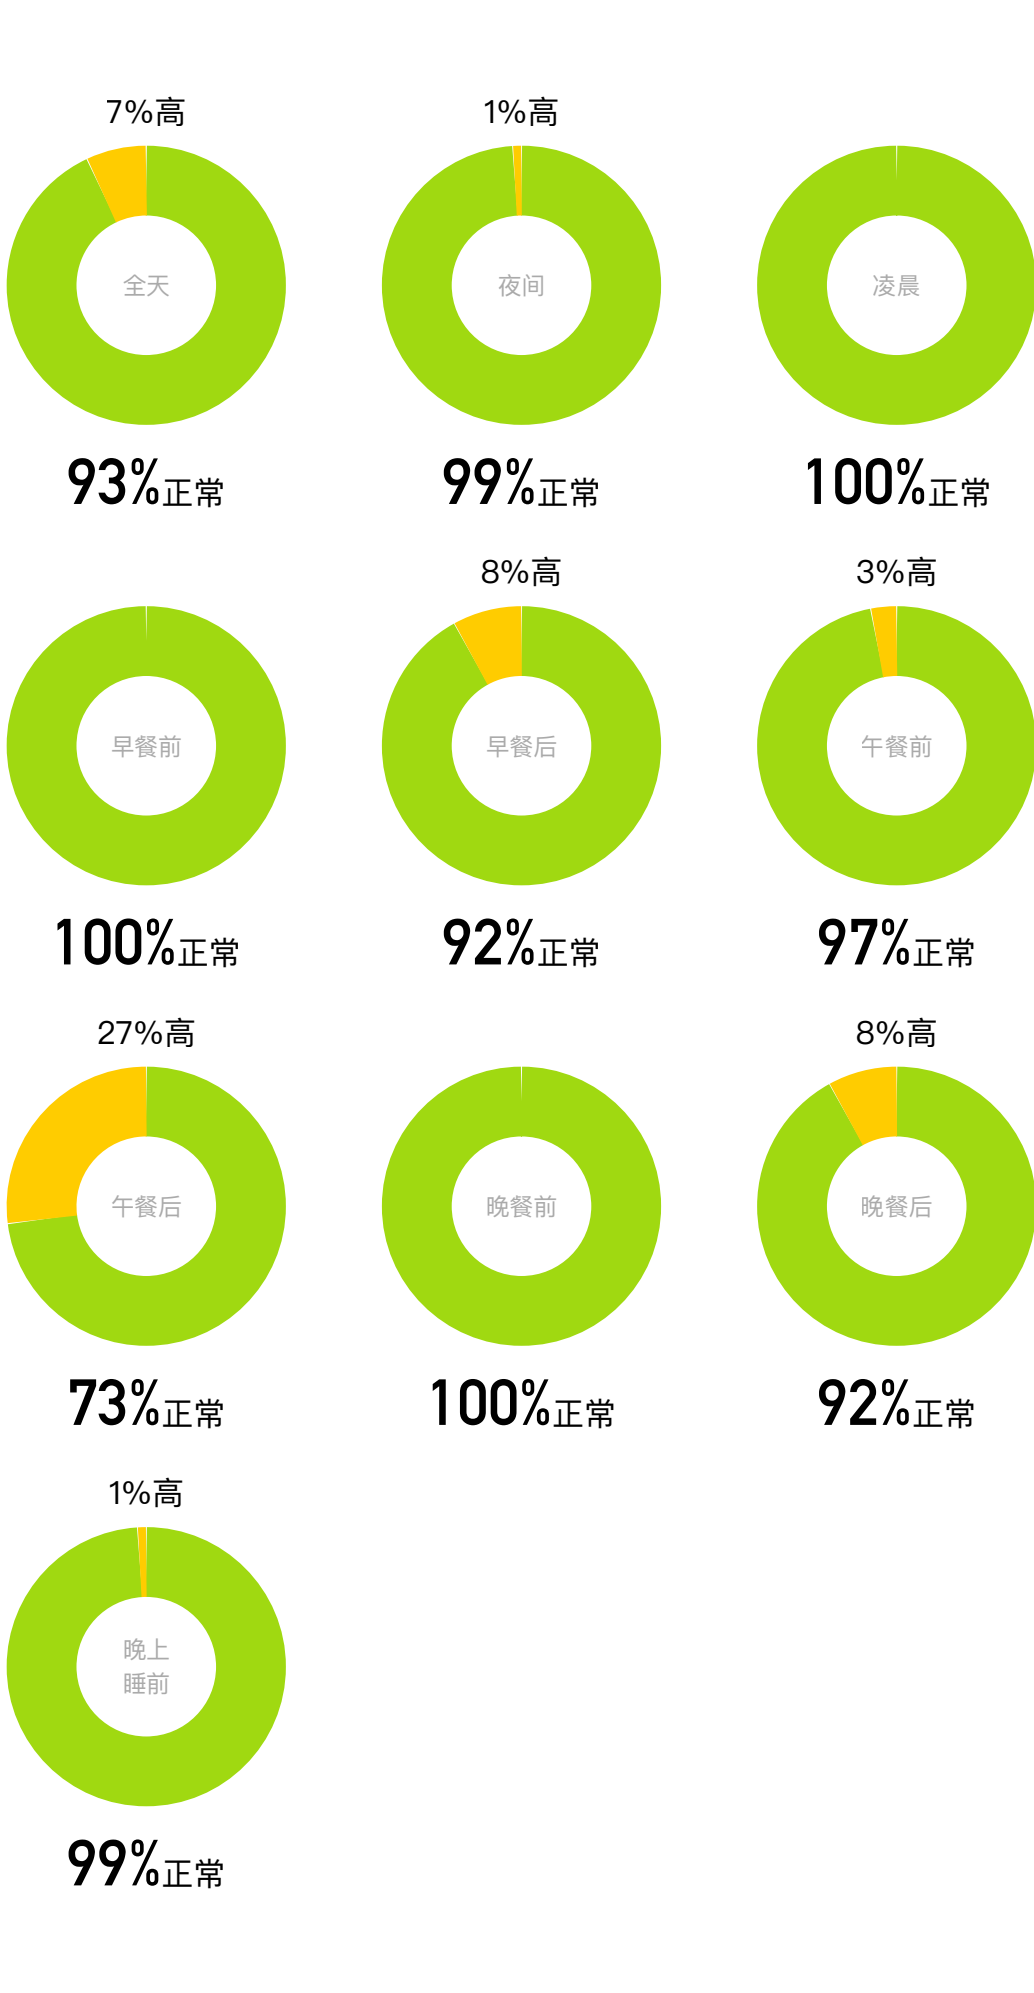

说明