
HSC | GLOBAL

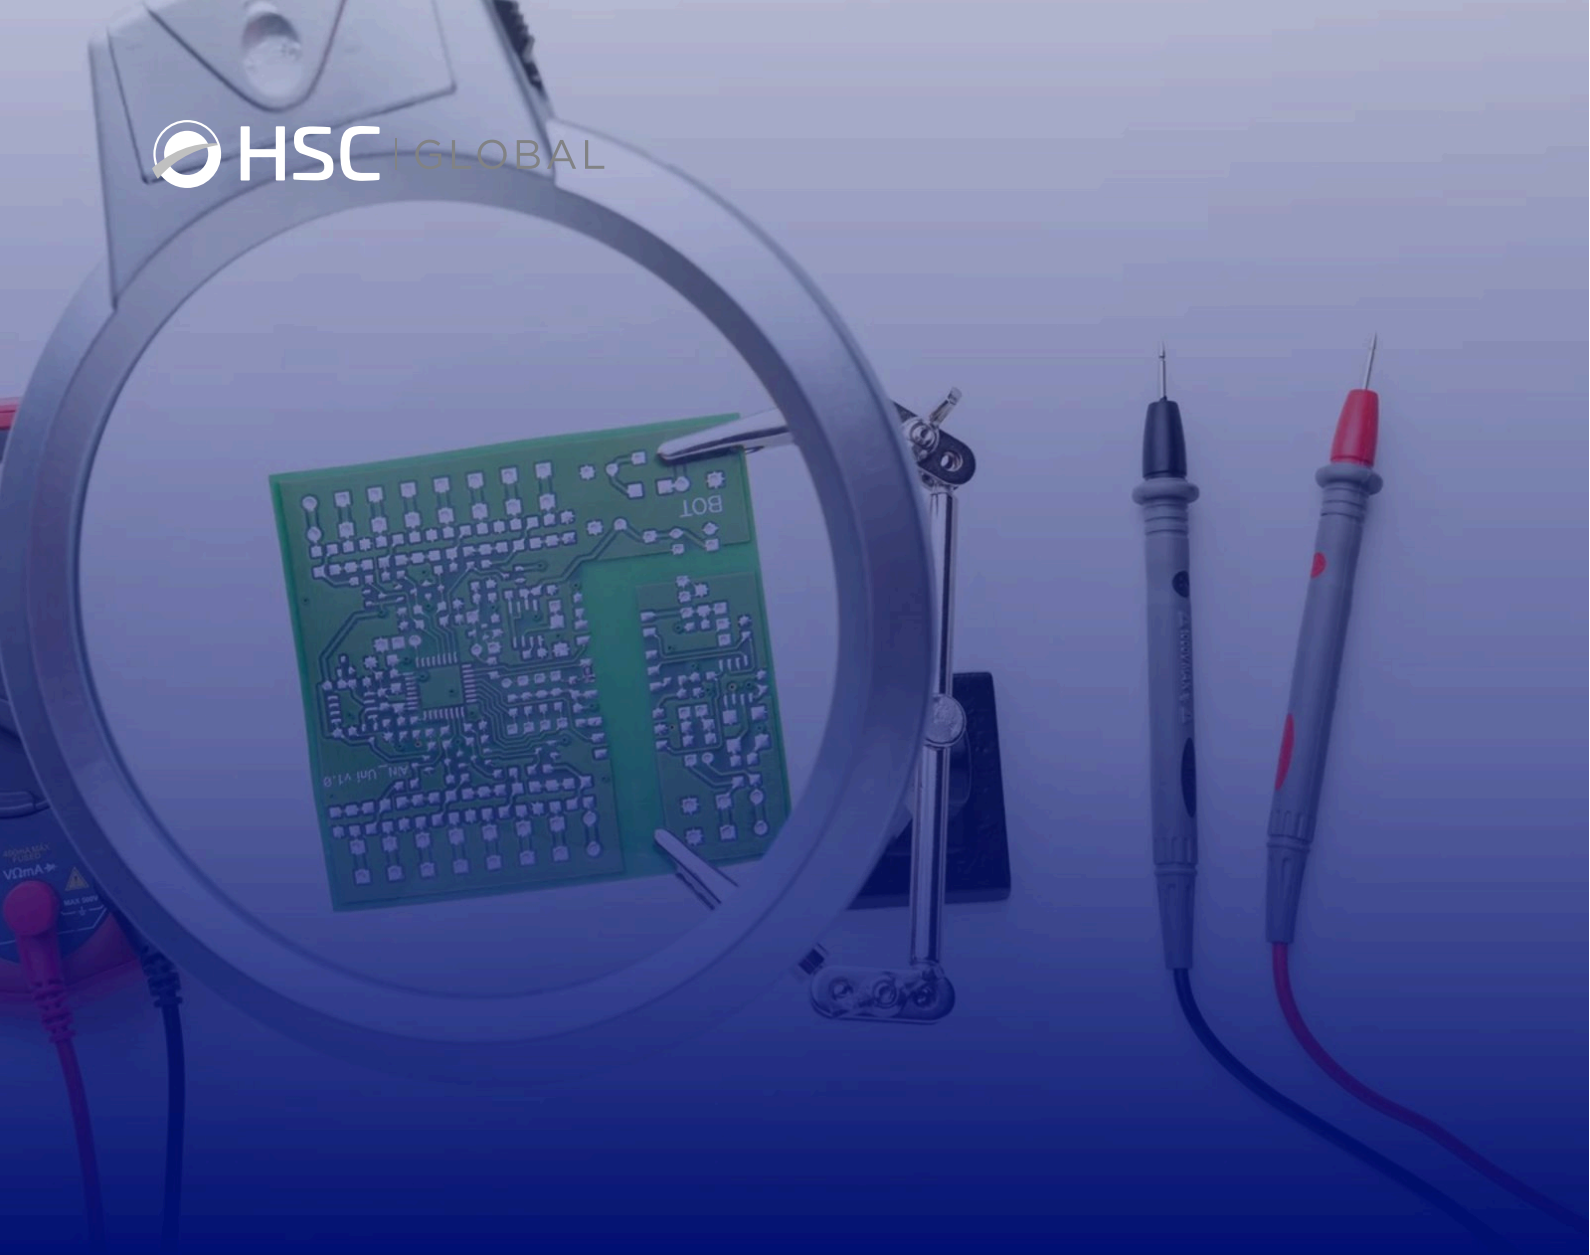

PORTARIA INMETRO 384/2020 • CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB VIGILÂNCIA SANITÁRIA

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 1

Do enquadramento à análise documental

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Dia 1 do curso

MÓDULO	Dia 1 de 2, ao vivo
DOCUMENTO BASE	Portaria Inmetro 384/2020; RGCP (Portaria Inmetro 200/2021); RDC Anvisa 549/2021; IN Anvisa 283/2024
INSTRUTORA	Laura Angélica de Pauli

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência do Dia 1, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica o mesmo conteúdo com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia: o organismo de certificação (OCP).

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e revisão	3
1	Inmetro e Anvisa: quem faz o quê	4
2	Avaliação da conformidade e o Modelo 5	7
3	Quem certifica, quem ensaia, quem detém	9
4	Escopo: o produto está na 384?	12
5	Normas aplicáveis e a IN 283	14
6	Projeto, unidade piloto e risco	17
7	Escolha do OCP e análise documental	20
8	Glossário	22
9	Para revisar	23

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e revisão

O Dia 1 tem quatro blocos e percorre as cinco primeiras etapas da jornada, do enquadramento à análise documental feita pelo OCP. O caso que acompanha os dois dias é o de um medidor de pressão arterial de uso doméstico, de uma empresa fictícia.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	PARA REVISAR
1	Inmetro, Anvisa e quem faz o quê	Dia 1, slides 4 a 9	Capítulos 1 a 3	Perguntas 1 a 3
2	Etapas 1 e 2: escopo e normas	Dia 1, slides 10 a 14	Capítulos 4 e 5	Perguntas 4 e 5
3	Etapa 3: projeto e o olhar do OCP	Dia 1, slides 15 a 18	Capítulo 6	Pergunta 6
4	Etapas 4 e 5: entrando no OCP	Dia 1, slides 19 a 23	Capítulo 7	Pergunta 7

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo do bloco com a Portaria 384/2020 aberta no item citado.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Anote quem decide cada etapa e qual documento sustenta a decisão.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda a pergunta de revisão do capítulo e registre suas dúvidas na página de anotações.

ANTES DO DIA 2

O Dia 2 começa no plano de ensaios e vai até a manutenção do certificado. Revise os Capítulos 3 e 6: os papéis de OCP e laboratório e o gerenciamento de risco voltam o tempo todo.

CAPÍTULO 1

Inmetro e Anvisa: quem faz o quê

NA AULA **Dia 1 • Bloco 1 • slides 5 e 6** **Para revisar • Pergunta 1**

Observe quem escreve a regra da certificação e quem decide se ela é obrigatória.

Quem entra no mundo da certificação de equipamentos costuma achar que o Inmetro manda em tudo. Não é assim. Para equipamentos sob vigilância sanitária, duas autoridades trabalham juntas, e cada uma responde por uma parte.

O lado do Inmetro

O Inmetro atua dentro do sistema de metrologia, normalização e qualidade industrial. Ele publica as regras da certificação: o regulamento geral (RGCP) e o requisito de avaliação da conformidade específico para equipamentos, a Portaria 384/2020. Pela coordenação de acreditação (Cgcre), reconhece os organismos de certificação e os laboratórios que podem atuar. Também supervisiona o uso do selo e, por meio da Dimel, aprova modelos de instrumentos de medição.

O lado da Anvisa

A Anvisa decide quais equipamentos precisam de certificação compulsória e quais normas se aplicam a eles. Ela regulariza o produto, acompanha o mercado com tecnovigilância e exige boas práticas de fabricação. Em resumo: a obrigação nasce na Anvisa; a forma de cumprir, no Inmetro.

PERGUNTA	QUEM RESPONDE
Meu equipamento precisa de certificado?	Anvisa (RDC 549/2021 e IN 283/2024)
Como a certificação é feita?	Inmetro (RGCP e Portaria 384/2020)
Quem pode certificar?	OCP acreditado pela Cgcre
Posso vender?	Anvisa, com a regularização do produto

ERRO COMUM

Achar que o certificado autoriza a venda. Ele demonstra que o equipamento atende às normas. A autorização para comercializar vem da regularização na Anvisa, que exige o certificado quando ele é compulsório.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

Inmetro e Anvisa: quem faz o quê

IDEIA-CHAVE

O Inmetro define como se certifica; a Anvisa define quem precisa e autoriza a venda.

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, art. 1º; RDC Anvisa 549/2021; IN Anvisa 283/2024; RDC Anvisa 751/2022; RDC Anvisa 665/2022.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Inmetro e Anvisa: quem faz o quê

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

Avaliação da conformidade e o Modelo 5

NA AULA **Dia 1 • Bloco 1 • slide 6** **Para revisar • Pergunta 2**

Observe por que uma norma técnica, sozinha, não obriga ninguém.

Uma norma técnica é um acordo entre especialistas. Ela só vira obrigação quando um regulamento do Estado diz que precisa ser cumprida. A avaliação da conformidade é o jeito de demonstrar, com regras, que o produto cumpre.

Três documentos que trabalham juntos

- **RGCP (Portaria Inmetro 200/2021).** As regras gerais, válidas para vários produtos certificados.
- **Portaria 384/2020.** Adapta essas regras aos equipamentos sob vigilância sanitária.
- **IN Anvisa 283/2024.** Diz quais normas técnicas o equipamento precisa atender.

Os modelos de certificação

O sistema brasileiro tem modelos que vão de uma avaliação única até a certificação de sistemas, passando por ensaio de lote e por ensaio com coleta periódica de amostras. A Portaria 384 usa o Modelo 5: ensaio inicial do produto, auditoria do sistema da qualidade e manutenção ao longo do tempo.

NO MODELO 5

Produto e fábrica

O OCP avalia o projeto por ensaios e verifica, na auditoria, se a fábrica é capaz de repetir o que foi ensaiado.

O QUE A 384 ACRESCENTA

Risco no centro

O gerenciamento de risco é analisado pelo OCP antes do plano de ensaios e da auditoria.

Pense num fabricante de oxímetros de pulso. Mesmo que o produto passe nos ensaios, o certificado só faz sentido se as unidades produzidas no mês seguinte forem iguais à que foi ensaiada. É isso que a auditoria e a manutenção sustentam.

IDEIA-CHAVE

Ensaio prova o projeto; auditoria e manutenção provam que a produção continua igual.

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020; RGCP (Portaria Inmetro 200/2021).

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Avaliação da conformidade e o Modelo 5

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Quem certifica, quem ensaia, quem detém

NA AULA **Dia 1 • Bloco 1 • slides 7 a 9** Para revisar • Pergunta 3

Observe por que o laboratório não certifica e por que o OCP não ensaia.

Quatro atores aparecem em toda a jornada. Confundir o papel de um com o de outro é a origem de muitos atrasos.

ATOR	O QUE FAZ	O QUE NÃO FAZ
OCP	Analisa documentos, define o plano de ensaios, audita, decide e emite o certificado	Não ensaia e não presta consultoria
Laboratório	Ensaia conforme o plano e emite o relatório	Não interpreta o resultado para certificar
Fabricante	Projeta e fabrica; tem a fábrica auditada, no Brasil ou no exterior	Não precisa ser o solicitante
Solicitante	Pede a certificação, detém o certificado e o selo, regulariza na Anvisa	Não pode atuar sem CNPJ no Brasil

O OCP precisa estar estabelecido no Brasil e acreditado pelo Inmetro no escopo da Portaria 384. Quem certifica é o OCP, não o Inmetro.

Qual laboratório vale

A regra segue uma ordem de preferência. Laboratórios designados pelo Inmetro entram em caráter excepcional; depois vêm os acreditados, do mais completo ao menos completo, e o laboratório independente vem antes do laboratório do próprio fabricante. Quanto menor a acreditação, mais o OCP precisa testemunhar e registrar. A lista desce quando não há laboratório disponível ou quando o início do ensaio passaria de quatro meses.

RELATÓRIO DO EXTERIOR

Vale quando o laboratório tem acreditação reconhecida (Inmetro ou acordo como ILAC), o método é equivalente e documentado pelo OCP, o ensaio considerou tensão e frequência do Brasil, a amostra é rastreável ao produto e há declaração de que o produto não mudou depois do ensaio.

IDEIA-CHAVE

O laboratório produz o dado; o OCP decide o que ele significa.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Quem certifica, quem ensaia, quem detém

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, art. 1º, § 1º, itens 4.8 a 4.10 e 4.20; 6.2.4.1.3 e 6.2.4.3; RGCP (Portaria Inmetro 200/2021), 6.2.4.3.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Quem certifica, quem ensaia, quem detém

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Escopo: o produto está na 384?

NA AULA **Dia 1 • Bloco 2 • slide 11** **Para revisar • Pergunta 4**

Observe por que o escopo descreve o universo e a obrigação vem norma por norma.

A primeira etapa da jornada é saber se o produto entra na certificação compulsória. Quatro textos ajudam a responder, e nenhum deles sozinho resolve.

- **Portaria 384/2020.** Abrange equipamentos, suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial, fisioterápica ou estética. Mas é a Anvisa quem obriga.
- **RDC 751/2022.** Coloca o certificado no pedido de regularização quando ele é compulsório e trata da venda do que foi fabricado na vigência.
- **ABNT NBR IEC 60601-1, seção 1.** Define o campo de segurança básica e desempenho essencial de equipamentos e sistemas eletromédicos, com exclusões.
- **Definição de equipamento eletromédico (60601-1, 3.63).** Tem parte aplicada ou transfere energia com o paciente, tem no máximo uma conexão à rede e tem finalidade médica.

A regra prática

O escopo diz quais produtos podem estar no sistema. A obrigação concreta vem da IN 283/2024: cada norma da lista vale para os equipamentos dentro do seu campo de aplicação. Por isso o avaliador pergunta, para cada norma, se o produto está no campo dela.

Um exemplo: uma balança de bebê com finalidade médica e alimentação pela rede tende a entrar; um software isolado, sem hardware, não é equipamento eletromédico.

> **ERRO COMUM**
>
> Decidir o enquadramento só pelo nome do produto. Finalidade declarada, conexão à rede e contato com o paciente mudam a resposta.

IDEIA-CHAVE

O escopo é o universo; a obrigação vem da IN 283, norma por norma.

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, art. 1º; RDC Anvisa 751/2022; IN Anvisa 283/2024; ABNT NBR IEC 60601-1:2016, itens 1.1 e 3.63.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Escopo: o produto está na 384?

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Normas aplicáveis e a IN 283

NA AULA Dia 1 • Bloco 2 • slides 12 a 14 Para revisar • Pergunta 5

Observe como a data do Anexo II muda a norma que você precisa atender.

Depois de enquadrar o produto, é hora de montar a lista de normas que ele precisa atender. A IN 283/2024 é a referência, e ela tem uma lógica em camadas.

Três camadas

- **Geral**: ABNT NBR IEC 60601-1, que vale para todo equipamento eletromédico.
- **Colaterais (60601-1-x)**: temas transversais, como compatibilidade eletromagnética, usabilidade, alarmes, projeto ecorresponsável e uso doméstico.
- **Particulares (60601-2-x e 80601-2-x)**: requisitos de um tipo específico de equipamento.

Quando a versão nova passa a valer

O Anexo II da IN 283 fixa as datas em que novas edições ou emendas se tornam exigíveis. Antes da data, a versão nova pode ser usada; depois, passa a ser obrigatória.

A PARTIR DE	NORMA OU EMENDA
31/07/2024	IEC 60601-1-11:2021
31/12/2025	60601-1-6, 1-8 e 1-9 (Emenda 2:2022); 1-11 (Emenda 1:2022)
31/12/2026	ISO 80601-2-30:2021
31/12/2027	60601-1 (Emenda 2:2022); 60601-1-2 (Emenda 1:2022)

Quatro situações especiais

- Sem laboratório no Brasil para um ensaio: certificação parcial, com exclusões no certificado.
- Norma que não se aplica: precisa de justificativa técnica.
- Norma cancelada ou substituída: a cancelada continua exigida; a nova pode ser usada antes.
- Na petição à Anvisa: o certificado precisa seguir os prazos do Anexo II.

IDEIA-CHAVE

Confira a data do Anexo II antes de fechar a lista de normas. A IN pode ter sido alterada.

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

Normas aplicáveis e a IN 283

Fonte: IN Anvisa 283/2024, arts. 2º a 5º e Anexo II.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Normas aplicáveis e a IN 283

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Projeto, unidade piloto e risco

NA AULA **Dia 1 • Bloco 3 • slides 16 a 18** **Para revisar • Pergunta 6**

Observe em que três momentos o OCP olha o gerenciamento de risco.

O OCP não certifica um protótipo de bancada. Ele certifica a fotografia de um produto que já é feito como será fabricado. E olha para o gerenciamento de risco como o centro de tudo.

A unidade piloto e a fotografia do produto

A unidade piloto usa materiais, processo e ferramental de produção, e vem depois da análise de risco. A fotografia do produto reúne as características originais: especificações, indicação de uso, componentes críticos, acessórios, manual e marcações, que precisam ser as mesmas do produto regularizado na Anvisa.

O gerenciamento de risco no centro

O OCP espera que o gerenciamento de risco, conforme a ISO 14971, mostre a aceitabilidade e o controle de cada perigo, tenha rastreabilidade e registre toda alteração de projeto, e se ligue aos requisitos das normas da IN 283. Ele atravessa todas as fases do desenvolvimento, junto com o registro histórico do projeto, a usabilidade, o software e o projeto ecorresponsável.

MOMENTO	O QUE O OCP OLHA
Solicitação	Resumo do gerenciamento de risco: comprometimento da direção, pessoal, plano
Análise documental	A parte que sai da fábrica, para planejar auditoria e ensaios
Auditoria	O gerenciamento de risco inteiro, na fábrica, guiado pelas tabelas do Anexo A

O AVALIADOR PERGUNTA

Depois das alterações de projeto, sobrou algum risco residual inaceitável? Cada requisito das Tabelas 2 a 7 do Anexo A tem evidência?

IDEIA-CHAVE

Sem gerenciamento de risco consistente, não há plano de ensaios nem auditoria que se sustentem.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Projeto, unidade piloto e risco

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, itens 4.2, 4.3 e 4.21; 6.2.1.2.9, 6.2.2.1 e 6.2.3.7; Anexo A, Tabelas 1 a 7; RDC Anvisa 665/2022; ISO 14971.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Projeto, unidade piloto e risco

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Escolha do OCP e análise documental

NA AULA **Dia 1 • Bloco 4 • slides 20 a 23** Para revisar • Pergunta 7

Observe quais erros de documentação o OCP mais encontra.

Com o produto definido e as normas mapeadas, o solicitante entra no OCP. A partir daqui, o processo tem um dono formal, e cada pendência fica registrada.

Escolher o OCP

A escolha é livre entre os organismos acreditados no escopo da Portaria 384. Vale comparar escopo, experiência com o tipo de equipamento, auditores com conhecimento de software e risco, laboratórios com que trabalha e prazos. A proposta deve deixar claros a análise, os dias de auditoria, o solicitante, as viagens e as manutenções.

Solicitação em dois tempos

- Primeiro, uma análise preliminar de viabilidade.
- Depois do acordo, o envio da documentação completa. Um documento pendente não trava o andamento do processo, mas trava a emissão do certificado.

O que o OCP faz na análise documental

O OCP lê o gerenciamento de risco para planejar a auditoria e os ensaios. Não conformidades documentais são comunicadas formalmente. Os problemas mais comuns são normas excluídas sem justificativa, componente crítico sem certificado, manual de outra versão e gerenciamento de risco sem ligação com as normas da IN.

DICA

Peça as regras do OCP

Cada OCP tem um documento de regras próprio, escrito com base na 384. Ele diz como o processo vai correr.

OITO PARES PARA NÃO CONFUNDIR

Certificado e regularização

O OCP atesta o atendimento às normas; a Anvisa autoriza a venda.

IDEIA-CHAVE

A análise documental é onde o OCP decide o que vai ensaiar e o que vai auditar.

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, 6.2.1.2 e 6.2.6.1.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Escolha do OCP e análise documental

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

OCP

Organismo de certificação de produto, acreditado pelo Inmetro, que analisa, audita, decide e emite o certificado.

Cgcre

Coordenação do Inmetro que acredita OCPs e laboratórios.

RGCP

Requisitos gerais de certificação de produtos (Portaria Inmetro 200/2021).

RAC

Requisito de avaliação da conformidade específico; para equipamentos, a Portaria 384/2020.

Modelo 5

Modelo de certificação com ensaio inicial, auditoria do sistema da qualidade e manutenção.

Solicitante

Empresa com CNPJ no Brasil que pede a certificação, detém o certificado e regulariza o produto.

Fotografia do produto

Conjunto de características originais avaliadas: especificações, componentes críticos, manual e marcações.

Unidade piloto

Unidade feita com materiais, processo e ferramental de produção, depois da análise de risco.

Norma colateral

Norma 60601-1-x sobre tema transversal, como EMC, usabilidade ou alarmes.

Norma particular

Norma 60601-2-x ou 80601-2-x com requisitos de um tipo de equipamento.

Anexo A

Parte da Portaria 384 com as tabelas de requisitos de risco, usabilidade, ecodesign e software verificados pelo OCP.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que o certificado do Inmetro não basta para vender um equipamento? *(Cap. 1)*

2. O que o Modelo 5 verifica que um ensaio único não verifica? *(Cap. 2)*

3. Se o laboratório reprova uma amostra, quem decide o que acontece com o processo? *(Cap. 3)*

4. Como você decide se uma norma da IN 283 se aplica ao seu equipamento? *(Cap. 4)*

5. Uma emenda nova foi publicada, mas a data do Anexo II ainda não chegou. O que você pode e o que precisa fazer? *(Cap. 5)*

6. Por que um protótipo de bancada não serve para a certificação? *(Cap. 6)*

7. Quais erros de documentação mais aparecem na análise do OCP e como cada um afeta o plano de ensaios? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Portaria Inmetro 384/2020

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com