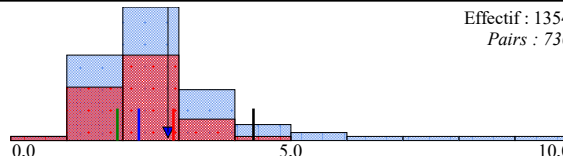
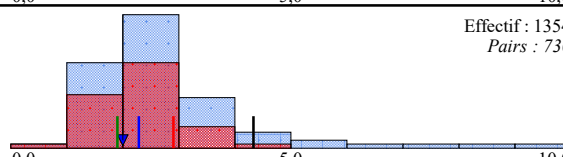
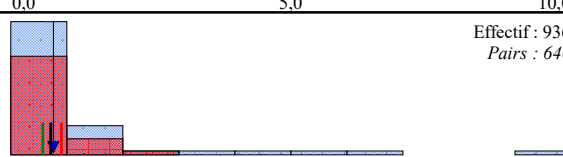
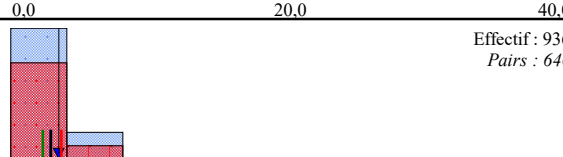
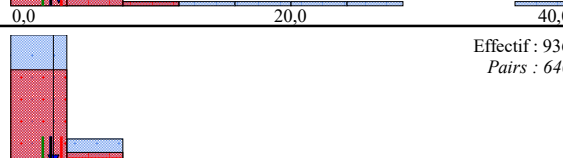
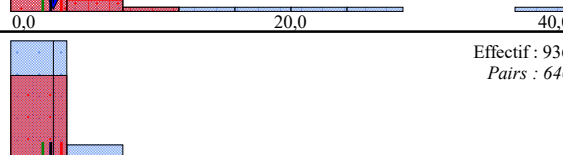
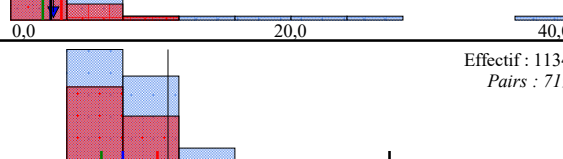
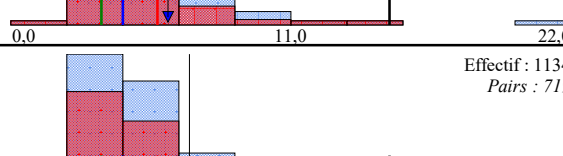
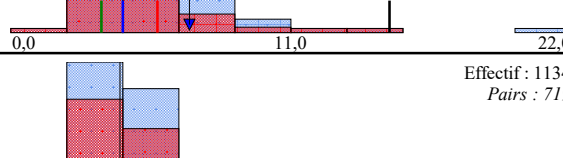
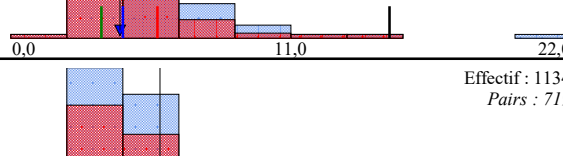
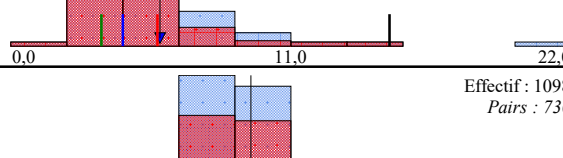
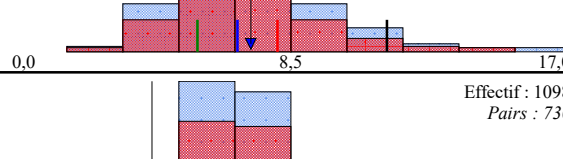
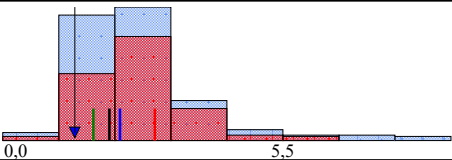
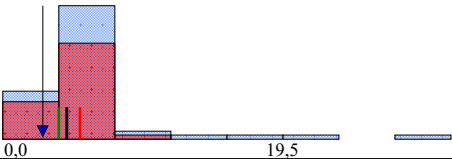
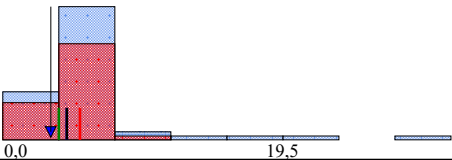
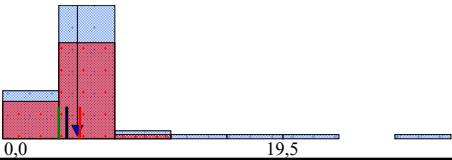
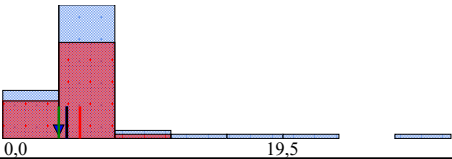


Analyte	Votre labo		Incertitude	Distribution de l'incertitude élargie	
	N°	Nb Incertitude		Tous	Pairs
pour la période 2024 - 2025					
LBM HEMATOLOGIE CHU CAEN					
14000 CAEN					
Hématies (impédance) ↓	1952A	18	2,7 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 1100 Pairs : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				2,0% 2,3% 2,8% 4,6%	1,9 2,3 2,6 8,0
Hématies (impédance) ↓	1952B	18	1,9 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 1100 Pairs : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				2,0% 2,3% 2,8% 4,6%	1,9 2,3 2,6 8,0
Hématies (impédance) ↓	54	2,2 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 1100 Pairs : 730	
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]	1952+1952A+1952B			2,0% 2,3% 2,8% 4,6%	1,9 2,3 2,6 8,0
Hématies (optique) ↓	1952A	18	7,4 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 486 Pairs : 369
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				3,6% 4,5% 5,5% 4,6%	3,8 4,7 5,6 11,0
Hématies (optique) ↓	1952B	18	4,8 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 486 Pairs : 369
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				3,6% 4,5% 5,5% 4,6%	3,8 4,7 5,6 11,0
Hématies (optique) ↓	36	6,2 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 486 Pairs : 369	
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]	1952A+1952B			3,6% 4,5% 5,5% 4,6%	3,8 4,7 5,6 11,0
Hématocrite ↓	1952	18	1,8 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 1161 Pairs : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				2,7% 3,4% 4,1% 4,2%	2,8 3,3 3,9 17,0
Hématocrite ↓	1952A	18	3,8 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 1161 Pairs : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				2,7% 3,4% 4,1% 4,2%	2,8 3,3 3,9 17,0
Hématocrite ↓	1952B	18	2,3 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 1161 Pairs : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				2,7% 3,4% 4,1% 4,2%	2,8 3,3 3,9 17,0
Hématocrite ↓	54	2,7 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 1161 Pairs : 730	
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]	1952+1952A+1952B			2,7% 3,4% 4,1% 4,2%	2,8 3,3 3,9 17,0
Hémoglobine ↓	1952	18	1,6 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 1354 Pairs : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				1,9% 2,3% 2,9% 4,3%	1,8 2,2 2,6 10,0
Hémoglobine ↓	1952A	18	1,3 %	1er quartile Médiane 3e quartile U souh	Effectif : 1354 Pairs : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				1,9% 2,3% 2,9% 4,3%	1,8 2,2 2,6 10,0

Hémoglobine	↓	1952B	18	2,8 %	1er quartile	1,9%	1,8		Effectif : 1354 Paires : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	2,3%	2,2			
				3e quartile	2,9%	2,6			
				U souh	4,3%				
Hémoglobine	↓	54	2,0 %	1er quartile	1,9%	1,8		Effectif : 1354 Paires : 730	
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]		1952+1952A+1952B		Médiane	2,3%	2,2			
				3e quartile	2,9%	2,6			
				U souh	4,3%				
IDR	↓	1952	18	3,0 %	1er quartile	2,3%	2,2		Effectif : 936 Paires : 640
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	2,9%	2,8			
				3e quartile	3,7%	3,5			
				U souh	2,9%				
IDR	↓	1952A	18	3,4 %	1er quartile	2,3%	2,2		Effectif : 936 Paires : 640
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	2,9%	2,8			
				3e quartile	3,7%	3,5			
				U souh	2,9%				
IDR	↓	1952B	18	3,1 %	1er quartile	2,3%	2,2		Effectif : 936 Paires : 640
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	2,9%	2,8			
				3e quartile	3,7%	3,5			
				U souh	2,9%				
IDR	↓	54	3,1 %	1er quartile	2,3%	2,2		Effectif : 936 Paires : 640	
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]		1952+1952A+1952B		Médiane	2,9%	2,8			
				3e quartile	3,7%	3,5			
				U souh	2,9%				
Leucocytes	↓	1952	18	6,2 %	1er quartile	3,6%	3,6		Effectif : 1134 Paires : 719
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	4,5%	4,3			
				3e quartile	5,8%	5,4			
				U souh	14,8%				
Leucocytes	↓	1952A	18	7,0 %	1er quartile	3,6%	3,6		Effectif : 1134 Paires : 719
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	4,5%	4,3			
				3e quartile	5,8%	5,4			
				U souh	14,8%				
Leucocytes	↓	1952B	18	4,3 %	1er quartile	3,6%	3,6		Effectif : 1134 Paires : 719
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	4,5%	4,3			
				3e quartile	5,8%	5,4			
				U souh	14,8%				
Leucocytes	↓	54	5,9 %	1er quartile	3,6%	3,6		Effectif : 1134 Paires : 719	
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]		1952+1952A+1952B		Médiane	4,5%	4,3			
				3e quartile	5,8%	5,4			
				U souh	14,8%				
Plaquettes (impédance)	↓	1952	18	7,3 %	1er quartile	5,7%	5,7		Effectif : 1098 Paires : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	6,9%	6,8			
				3e quartile	8,1%	8,0			
				U souh	11,4%				
Plaquettes (impédance)	↓	1952A	18	4,3 %	1er quartile	5,7%	5,7		Effectif : 1098 Paires : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	6,9%	6,8			
				3e quartile	8,1%	8,0			
				U souh	11,4%				

Plaquettes (impédance)	↓	1952B 18	8,7 %	1er quartile	5,7%	5,7		Effectif : 1098 Paires : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	6,9%	6,8		
				3e quartile	8,1%	8,0		
				U souh	11,4%	0,0	17,0	
Plaquettes (impédance)	↓	54	6,8 %	1er quartile	5,7%	5,7		Effectif : 1098 Paires : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]		1952+1952A+1952B		Médiane	6,9%	6,8		
				3e quartile	8,1%	8,0		
				U souh	11,4%	0,0	17,0	
Plaquettes (optique)	↓	1952A 18	13,1 %	1er quartile	7,4%	7,4		Effectif : 412 Paires : 298
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	9,2%	9,1		
				3e quartile	11,9%	11,4		
				U souh	11,4%	0,0	33,0	
Plaquettes (optique)	↓	1952B 18	8,5 %	1er quartile	7,4%	7,4		Effectif : 412 Paires : 298
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	9,2%	9,1		
				3e quartile	11,9%	11,4		
				U souh	11,4%	0,0	33,0	
Plaquettes (optique)	↓	36	10,9 %	1er quartile	7,4%	7,4		Effectif : 412 Paires : 298
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]		1952A+1952B		Médiane	9,2%	9,1		
				3e quartile	11,9%	11,4		
				U souh	11,4%	0,0	33,0	
TGMH	↓	1952 18	2,9 %	1er quartile	2,1%	2,1		Effectif : 1131 Paires : 731
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	2,5%	2,5		
				3e quartile	3,0%	2,9		
				U souh	2,5%	0,0	6,0	
TGMH	↓	1952A 18	3,0 %	1er quartile	2,1%	2,1		Effectif : 1131 Paires : 731
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	2,5%	2,5		
				3e quartile	3,0%	2,9		
				U souh	2,5%	0,0	6,0	
TGMH	↓	1952B 17	3,4 %	1er quartile	2,1%	2,1		Effectif : 1131 Paires : 731
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	2,5%	2,5		
				3e quartile	3,0%	2,9		
				U souh	2,5%	0,0	6,0	
TGMH	↓	53	3,0 %	1er quartile	2,1%	2,1		Effectif : 1131 Paires : 731
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]		1952+1952A+1952B		Médiane	2,5%	2,5		
				3e quartile	3,0%	2,9		
				U souh	2,5%	0,0	6,0	
VGM	↓	1952 18	1,5 %	1er quartile	1,8%	2,0		Effectif : 1134 Paires : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	2,3%	2,5		
				3e quartile	3,0%	3,0		
				U souh	2,1%	0,0	11,0	
VGM	↓	1952A 18	1,6 %	1er quartile	1,8%	2,0		Effectif : 1134 Paires : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	2,3%	2,5		
				3e quartile	3,0%	3,0		
				U souh	2,1%	0,0	11,0	
VGM	↓	1952B 18	1,3 %	1er quartile	1,8%	2,0		Effectif : 1134 Paires : 730
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]				Médiane	2,3%	2,5		
				3e quartile	3,0%	3,0		
				U souh	2,1%	0,0	11,0	

Analyte	Votre labo			Incertitude		Distribution de l'incertitude élargie		Effectif : 1134 Pairs : 730	
	N°	Nb	Incertitude	Tous	Pairs	pour la période 2024 - 2025			
LBM HEMATOLOGIE CHU CAEN									
14000 CAEN									
VGM	↓	54	1,4 %	1er quartile	1,8%	2,0			
1952+1952A+1952B			Médiane	2,3%	2,5				
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]			3e quartile	3,0%	3,0				
			U souh	2,1%					
VPM	↓	1952	16	2,8 %	1er quartile	3,9%	3,8		Effectif : 974 Pairs : 673
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]			Médiane	4,5%	4,4				
			3e quartile	5,3%	5,1				
			U souh	4,4%					
VPM	↓	1952A	18	3,4 %	1er quartile	3,9%	3,8		Effectif : 974 Pairs : 673
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]			Médiane	4,5%	4,4				
			3e quartile	5,3%	5,1				
			U souh	4,4%					
VPM	↓	1952B	17	5,2 %	1er quartile	3,9%	3,8		Effectif : 974 Pairs : 673
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]			Médiane	4,5%	4,4				
			3e quartile	5,3%	5,1				
			U souh	4,4%					
VPM	↓	51	3,8 %	1er quartile	3,9%	3,8		Effectif : 974 Pairs : 673	
1952+1952A+1952B			Médiane	4,5%	4,4				
Sysmex XN 1000/1500/2000/3000/9000 (SYSMEX) [XX/NK9]			3e quartile	5,3%	5,1				
			U souh	4,4%					

Hématologie : Hémostase










Antithrombine activité	↓	1952	16	11,7 %	1er quartile	9,8%	8,8		Effectif : 299 Pairs : 16
Biophen ATanti-(h)-Xa-LRT (Liquide) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W8/PB7]				Médiane	12,1%	11,3			
				3e quartile	14,6%	12,9			
				U souh	5,3%				
Antithrombine activité	↓	1952A	15	14,8 %	1er quartile	9,8%	8,8		Effectif : 299 Pairs : 16
Biophen ATanti-(h)-Xa-LRT (Liquide) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W8/PB7]				Médiane	12,1%	11,3			
				3e quartile	14,6%	12,9			
				U souh	5,3%				
Antithrombine activité	↓	31	12,9 %	1er quartile	9,8%	8,8		Effectif : 299 Pairs : 16	
Biophen ATanti-(h)-Xa-LRT (Liquide) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W8/PB7]		1952+1952A		Médiane	12,1%	11,3			
				3e quartile	14,6%	12,9			
				U souh	5,3%				
Apixaban	↓	1952	10	14,1 %	1er quartile	8,4%	10,9		Effectif : 173 Pairs : 8
Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]				Médiane	10,4%	14,8			
				3e quartile	13,6%	16,1			
Apixaban	↓	1952A	9	16,0 %	1er quartile	8,4%	10,9		Effectif : 173 Pairs : 8
Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]				Médiane	10,4%	14,8			
				3e quartile	13,6%	16,1			
Apixaban	↓	19	14,3 %	1er quartile	8,4%	10,9		Effectif : 173 Pairs : 8	
Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]		1952+1952A		Médiane	10,4%	14,8			
				3e quartile	13,6%	16,1			


dRVVT Conf. Tps	↓	1952	13	8,3 %	1er quartile	4,4%	4,4		Effectif : 148 Pairs : 39
Plasma					Médiane	5,2%	5,0		
HemosIL DRVVT Confirm (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G2/PG4]					3e quartile	6,7%	5,7		
dRVVT Dép. Tps	↓	1952	16	3,4 %	1er quartile	5,1%	3,6		Effectif : 159 Pairs : 40
Plasma					Médiane	7,1%	5,1		
HemosIL DRVVTScreen (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G1/PG4]					3e quartile	8,8%	7,5		
Facteur II	↓	1952	8	7,4 %	1er quartile	10,8%			Effectif : 380 Pairs : 2
SIEMENS Plasma ex de FII (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D3/PB6]					Médiane	13,4%			
					3e quartile	15,9%			
					U souh	7,9%			
Facteur II	↓	1952	32	17,4 %	1er quartile	10,8%	14,2		Effectif : 380 Pairs : 25
Facteur II Deficient Plasma (Immunodéplété) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN [W3/PB7]					Médiane	13,4%	15,3		
					3e quartile	15,9%	17,6		
					U souh	7,9%			
Facteur II	↓	1952A	8	15,8 %	1er quartile	10,8%			Effectif : 380 Pairs : 2
SIEMENS Plasma ex de FII (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D3/PB6]					Médiane	13,4%			
					3e quartile	15,9%			
					U souh	7,9%			
Facteur II	↓	1952A	32	15,4 %	1er quartile	10,8%	14,2		Effectif : 380 Pairs : 25
Facteur II Deficient Plasma (Immunodéplété) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN [W3/PB7]					Médiane	13,4%	15,3		
					3e quartile	15,9%	17,6		
					U souh	7,9%			
Facteur II	↓		16	12,2 %	1er quartile	10,8%			Effectif : 380 Pairs : 2
			1952+1952A		Médiane	13,4%			
SIEMENS Plasma ex de FII (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D3/PB6]					3e quartile	15,9%			
					U souh	7,9%			
Facteur II	↓		64	16,2 %	1er quartile	10,8%	14,2		Effectif : 380 Pairs : 25
			1952+1952A		Médiane	13,4%	15,3		
Facteur II Deficient Plasma (Immunodéplété) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN [W3/PB7]					3e quartile	15,9%	17,6		
					U souh	7,9%			
Facteur IX	↓	1952	8	16,8 %	1er quartile	13,1%			Effectif : 324 Pairs : 4
SIEMENS Plasma ex. de FIX (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [B2/PB6]					Médiane	15,5%			
					3e quartile	18,3%			
					U souh	11,0%			
Facteur IX	↓	1952	31	17,0 %	1er quartile	13,1%			Effectif : 324 Pairs : 6
SIEMENS Plasma ex. de FIX (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Sysmex CN [B2/PB7]					Médiane	15,5%			
					3e quartile	18,3%			
					U souh	11,0%			
Facteur IX	↓	1952A	8	19,9 %	1er quartile	13,1%			Effectif : 324 Pairs : 4
SIEMENS Plasma ex. de FIX (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [B2/PB6]					Médiane	15,5%			
					3e quartile	18,3%			
					U souh	11,0%			
Facteur IX	↓	1952A	31	14,8 %	1er quartile	13,1%			Effectif : 324 Pairs : 6
SIEMENS Plasma ex. de FIX (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Sysmex CN [B2/PB7]					Médiane	15,5%			
					3e quartile	18,3%			
					U souh	11,0%			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

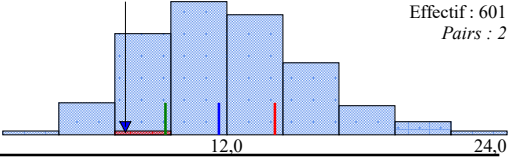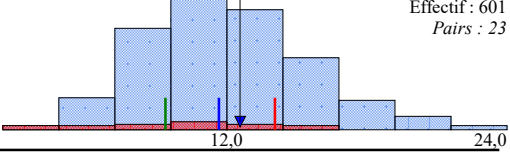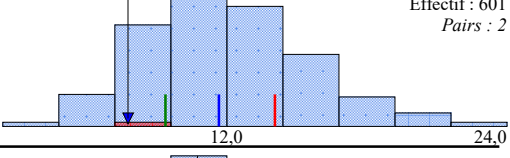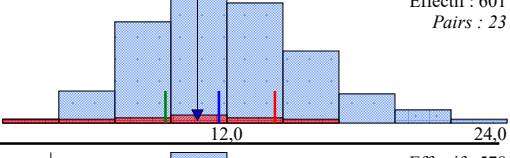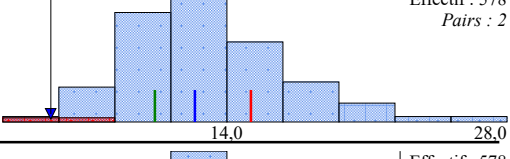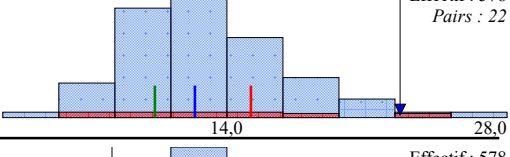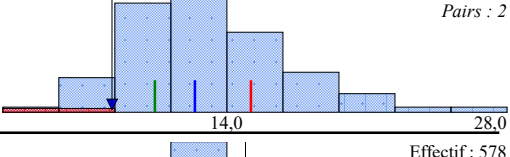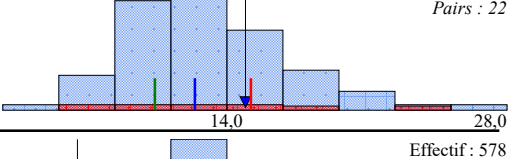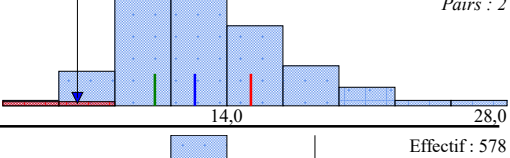Analyte	Votre labo			Incertitude		Distribution de l'incertitude élargie	
	N°	Nb	Incertitude	Tous	Pairs	pour la période 2024 - 2025	
LBM HEMATOLOGIE CHU CAEN							
14000 CAEN							
Héparine Bas Poids Moléculaire INNOVANCE anti-Xa (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [B3/PB6]	↓ 1952	10	8,3 %	1er quartile 9,4% Médiane 11,6% 3e quartile 14,0%			Effectif : 601 Pairs : 2
Héparine Bas Poids Moléculaire Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]	↓ 1952	10	9,4 %	1er quartile 9,4% Médiane 11,6% 3e quartile 14,0%	8,3 10,6 12,5		Effectif : 601 Pairs : 23
Héparine Bas Poids Moléculaire INNOVANCE anti-Xa (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [B3/PB6]	↓ 1952A	10	7,7 %	1er quartile 9,4% Médiane 11,6% 3e quartile 14,0%			Effectif : 601 Pairs : 2
Héparine Bas Poids Moléculaire Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]	↓ 1952A	10	12,6 %	1er quartile 9,4% Médiane 11,6% 3e quartile 14,0%	8,3 10,6 12,5		Effectif : 601 Pairs : 23
Héparine Bas Poids Moléculaire INNOVANCE anti-Xa (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [B3/PB6]	↓ 20 1952+1952A		7,7 %	1er quartile 9,4% Médiane 11,6% 3e quartile 14,0%			Effectif : 601 Pairs : 2
Héparine Bas Poids Moléculaire Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]	↓ 20 1952+1952A		10,8 %	1er quartile 9,4% Médiane 11,6% 3e quartile 14,0%	8,3 10,6 12,5		Effectif : 601 Pairs : 23
Héparine Standard INNOVANCE anti-Xa (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [B3/PB6]	↓ 1952	10	5,2 %	1er quartile 10,4% Médiane 12,4% 3e quartile 15,2%			Effectif : 578 Pairs : 2
Héparine Standard Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]	↓ 1952	10	22,7 %	1er quartile 10,4% Médiane 12,4% 3e quartile 15,2%	8,4 11,6 14,9		Effectif : 578 Pairs : 22
Héparine Standard INNOVANCE anti-Xa (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [B3/PB6]	↓ 1952A	10	8,2 %	1er quartile 10,4% Médiane 12,4% 3e quartile 15,2%			Effectif : 578 Pairs : 2
Héparine Standard Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]	↓ 1952A	10	14,9 %	1er quartile 10,4% Médiane 12,4% 3e quartile 15,2%	8,4 11,6 14,9		Effectif : 578 Pairs : 22
Héparine Standard INNOVANCE anti-Xa (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [B3/PB6]	↓ 20 1952+1952A		6,5 %	1er quartile 10,4% Médiane 12,4% 3e quartile 15,2%			Effectif : 578 Pairs : 2
Héparine Standard Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]	↓ 20 1952+1952A		18,4 %	1er quartile 10,4% Médiane 12,4% 3e quartile 15,2%	8,4 11,6 14,9		Effectif : 578 Pairs : 22

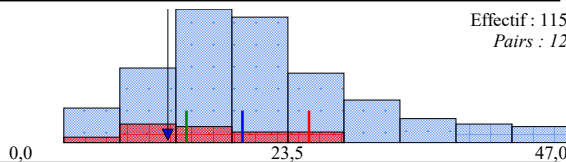I.N.R.	↓	1952	8	7,2 %	1er quartile	7,5%	6,1	Médiane	9,6%	8,3	3e quartile	12,0%	11,0		Effectif : 1123 Pairs : 7
Dade Innovin (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]															
I.N.R.	↓	1952	32	8,7 %	1er quartile	7,5%	8,9	Médiane	9,6%	10,6	3e quartile	12,0%	13,8		Effectif : 1123 Pairs : 34
(h)PT-phen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W2/PB7]															
I.N.R.	↓	1952A	8	5,1 %	1er quartile	7,5%	6,1	Médiane	9,6%	8,3	3e quartile	12,0%	11,0		Effectif : 1123 Pairs : 7
Dade Innovin (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]															
I.N.R.	↓	1952A	32	10,2 %	1er quartile	7,5%	8,9	Médiane	9,6%	10,6	3e quartile	12,0%	13,8		Effectif : 1123 Pairs : 34
(h)PT-phen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W2/PB7]															
I.N.R.	↓	16	5,9 %	1er quartile	7,5%	6,1	Médiane	9,6%	8,3	3e quartile	12,0%	11,0		Effectif : 1123 Pairs : 7	
Dade Innovin (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]															
I.N.R.	↓	64	9,4 %	1er quartile	7,5%	8,9	Médiane	9,6%	10,6	3e quartile	12,0%	13,8		Effectif : 1123 Pairs : 34	
(h)PT-phen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W2/PB7]															
Monomères de Fibrin	↓	1952	10	13,9 %	1er quartile	14,9%	13,4	Médiane	19,7%	15,8	3e quartile	25,2%	19,3		Effectif : 115 Pairs : 12
STA Liatest FM (STAGO (DIAGNOSTICA STAGO)) sur Sysmex CN (SYSMEX) [J1/PB7]															
Monomères de Fibrin	↓	1952A	10	13,4 %	1er quartile	14,9%	13,4	Médiane	19,7%	15,8	3e quartile	25,2%	19,3		Effectif : 115 Pairs : 12
STA Liatest FM (STAGO (DIAGNOSTICA STAGO)) sur Sysmex CN (SYSMEX) [J1/PB7]															
Monomères de Fibrin	↓	20	13,0 %	1er quartile	14,9%	13,4	Médiane	19,7%	15,8	3e quartile	25,2%	19,3		Effectif : 115 Pairs : 12	
STA Liatest FM (STAGO (DIAGNOSTICA STAGO)) sur Sysmex CN (SYSMEX) [J1/PB7]															
Protéine C activité	↓	1952B	14	29,6 %	1er quartile	6,9%		Médiane	10,2%		3e quartile	14,8%			Effectif : 131 Pairs : 5
Proclot (HemosIL) (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G3/PG4]															
Protéine S Libre	↓	1952B	20	8,7 %	1er quartile	7,8%	7,4	Médiane	9,1%	8,8	3e quartile	13,2%	11,2		Effectif : 33 Pairs : 17
Free Protein S (HemosIL) (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G4/PG4]															
Protéine S Totale	↓	1952B	20	15,0 %	1er quartile	14,6%	14,4	Médiane	18,0%	15,8	3e quartile	20,9%	20,6		Effectif : 102 Pairs : 19
Activité															
Activity Protein S (HemosIL) (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G5/PG4]															

Ratio dRVVT Conf. P/T	↓	1952	14	22,5 %	1er quartile	5,1%	7,7		Effectif : 144 Paires : 40
HemosIL DRVVT Confirm (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G2/PG4]									
					Médiane	7,6%	11,8		
					3e quartile	11,5%	15,8		
Ratio dRVVT Dép. P/T	↓	1952	14	18,4 %	1er quartile	6,9%	10,3		Effectif : 159 Paires : 41
HemosIL DRVVTScreen (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G1/PG4]									
					Médiane	9,5%	13,7		
					3e quartile	14,2%	18,4		
Ratio dRVVT Standardisé	↓	1952	14	17,4 %	1er quartile	7,6%	9,5		Effectif : 146 Paires : 40
HemosIL DRVVTScreen (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G1/PG4]									
					Médiane	10,0%	12,6		
					3e quartile	15,8%	17,4		
Ratio SCT Confirm P/T	↓	1952	16	35,7 %	1er quartile	12,7%	12,7		Effectif : 18 Paires : 18
HemosIL Silica Clotting Time (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G3/PG4]									
					Médiane	18,2%	18,2		
					3e quartile	29,6%	29,6		
Ratio SCT Screen P/T	↓	1952	15	18,1 %	1er quartile	17,7%	17,7		Effectif : 18 Paires : 18
HemosIL Silica Clotting Time (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G3/PG4]									
					Médiane	22,2%	22,2		
					3e quartile	27,2%	27,2		
Ratio SCT Standardisé	↓	1952	16	26,5 %	1er quartile	21,0%	21,0		Effectif : 18 Paires : 18
HemosIL Silica Clotting Time (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G3/PG4]									
					Médiane	25,5%	25,5		
					3e quartile	33,9%	33,9		
Ratio TCA T/M	↓	1952	16	10,6 %	1er quartile	7,4%	8,3		Effectif : 184 Paires : 38
HemosIL APTT-SP (liquid) (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G4/PG4]									
					Médiane	10,2%	13,4		
					3e quartile	14,3%	18,7		
Ratio Tps Thrombine P/T	↓	1952	14	29,6 %	1er quartile	8,5%	12,2		Effectif : 110 Paires : 14
Hemoclot Thrombin Time Liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W3/PB7]									
					Médiane	11,3%	15,8		
					3e quartile	14,4%	22,7		
Ratio Tps Thrombine P/T	↓	1952A	14	32,7 %	1er quartile	8,5%	12,2		Effectif : 110 Paires : 14
Hemoclot Thrombin Time Liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W3/PB7]									
					Médiane	11,3%	15,8		
					3e quartile	14,4%	22,7		
Ratio Tps Thrombine P/T	↓	28	30,0 %	1er quartile	8,5%	12,2			Effectif : 110 Paires : 14
Hemoclot Thrombin Time Liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W3/PB7]									
		1952+1952A			Médiane	11,3%	15,8		
					3e quartile	14,4%	22,7		
RATIO X/T (TCA)	↓	1952	8	10,6 %	1er quartile	5,6%	10,6		Effectif : 820 Paires : 7
Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]									
					Médiane	7,3%	20,4		
					3e quartile	9,5%	25,6		
RATIO X/T (TCA)	↓	1952	23	9,2 %	1er quartile	5,6%	7,1		Effectif : 820 Paires : 10
Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Sysmex CN (SYSMEX) [D1/PB7]									
					Médiane	7,3%	9,1		
					3e quartile	9,5%	10,2		

RATIO X/T (TCA)	↓	1952	8	21,1 %	1er quartile	5,6%	7,1		Effectif : 820 Pairs : 30
Cephen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W1/PB7]					Médiane	7,3%	9,2		
					3e quartile	9,5%	10,8		
RATIO X/T (TCA)	↓	1952A	8	8,9 %	1er quartile	5,6%	10,6		Effectif : 820 Pairs : 7
Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]					Médiane	7,3%	20,4		
					3e quartile	9,5%	25,6		
RATIO X/T (TCA)	↓	1952A	23	9,0 %	1er quartile	5,6%	7,1		Effectif : 820 Pairs : 10
Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Sysmex CN (SYSMEX) [D1/PB7]					Médiane	7,3%	9,1		
					3e quartile	9,5%	10,2		
RATIO X/T (TCA)	↓	16	9,5 %	1er quartile	5,6%	10,6			Effectif : 820 Pairs : 7
1952+1952A					Médiane	7,3%	20,4		
Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]					3e quartile	9,5%	25,6		
RATIO X/T (TCA)	↓	46	8,9 %	1er quartile	5,6%	7,1			Effectif : 820 Pairs : 10
1952+1952A					Médiane	7,3%	9,1		
Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Sysmex CN (SYSMEX) [D1/PB7]					3e quartile	9,5%	10,2		
Rivaroxaban	↓	1952	10	15,2 %	1er quartile	8,0%	9,5		Effectif : 173 Pairs : 8
Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]					Médiane	9,9%	11,9		
					3e quartile	12,1%	17,7		
Rivaroxaban	↓	1952A	9	18,6 %	1er quartile	8,0%	9,5		Effectif : 173 Pairs : 8
Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]					Médiane	9,9%	11,9		
					3e quartile	12,1%	17,7		
Rivaroxaban	↓	19	16,3 %	1er quartile	8,0%	9,5			Effectif : 173 Pairs : 8
1952+1952A					Médiane	9,9%	11,9		
Biophen héparine liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W5/PB7]					3e quartile	12,1%	17,7		
Rosner Indice	↓	1952	10	13,9 %	1er quartile	13,5%	18,4		Effectif : 150 Pairs : 12
HemosIL APTT-SP (liquid) (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP (Plasma normal congelé CRYOCHECK) [G4/PG4/P11]					Médiane	16,4%	26,4		
					3e quartile	23,8%	32,1		
SCT Confirm Tps	↓	1952	16	15,5 %	1er quartile	15,5%	15,5		Effectif : 18 Pairs : 18
Plasma					Médiane	16,3%	16,3		
HemosIL Silica Clotting Time (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G3/PG4]					3e quartile	20,6%	20,6		
SCT Screen Tps	↓	1952	14	13,0 %	1er quartile	8,4%	8,4		Effectif : 17 Pairs : 17
Plasma					Médiane	9,5%	9,5		
HemosIL Silica Clotting Time (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G3/PG4]					3e quartile	11,1%	11,1		
Taux de prothrombine	↓	1952	8	19,4 %	1er quartile	6,8%	8,3		Effectif : 1090 Pairs : 7
Dade Innovin (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]					Médiane	8,5%	11,5		
					3e quartile	10,5%	16,2		

Taux de prothrombine	↓	1952	32	8,9 %	1er quartile	6,8%	8,7		Effectif : 1090
(h)PT-phen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W2/PB7]					Médiane	8,5%	9,7		Pairs : 34
					3e quartile	10,5%	11,6		
Taux de prothrombine	↓	1952A	8	5,5 %	1er quartile	6,8%	8,3		Effectif : 1090
Dade Innovin (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]					Médiane	8,5%	11,5		Pairs : 7
					3e quartile	10,5%	16,2		
Taux de prothrombine	↓	1952A	32	9,0 %	1er quartile	6,8%	8,7		Effectif : 1090
(h)PT-phen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W2/PB7]					Médiane	8,5%	9,7		Pairs : 34
					3e quartile	10,5%	11,6		
Taux de prothrombine	↓	16		14,1 %	1er quartile	6,8%	8,3		Effectif : 1090
1952+1952A					Médiane	8,5%	11,5		Pairs : 7
Dade Innovin (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]					3e quartile	10,5%	16,2		
Taux de prothrombine	↓	64		8,8 %	1er quartile	6,8%	8,7		Effectif : 1090
1952+1952A					Médiane	8,5%	9,7		Pairs : 34
(h)PT-phen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W2/PB7]					3e quartile	10,5%	11,6		
TCA	↓	1952	8	13,7 %	1er quartile	3,9%	11,9		Effectif : 828
Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]					Médiane	4,9%	13,7		Pairs : 7
					3e quartile	6,5%	17,7		
TCA	↓	1952	23	6,8 %	1er quartile	3,9%	4,3		Effectif : 828
Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Sysmex CN (SYSMEX) [D1/PB7]					Médiane	4,9%	5,8		Pairs : 10
					3e quartile	6,5%	6,8		
TCA	↓	1952	8	8,0 %	1er quartile	3,9%	6,3		Effectif : 828
Cephen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W1/PB7]					Médiane	4,9%	7,5		Pairs : 33
					3e quartile	6,5%	9,2		
TCA	↓	1952A	8	11,9 %	1er quartile	3,9%	11,9		Effectif : 828
Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]					Médiane	4,9%	13,7		Pairs : 7
					3e quartile	6,5%	17,7		
TCA	↓	1952A	23	6,0 %	1er quartile	3,9%	4,3		Effectif : 828
Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Sysmex CN (SYSMEX) [D1/PB7]					Médiane	4,9%	5,8		Pairs : 10
					3e quartile	6,5%	6,8		
TCA	↓	1952A	8	8,4 %	1er quartile	3,9%	6,3		Effectif : 828
Cephen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W1/PB7]					Médiane	4,9%	7,5		Pairs : 33
					3e quartile	6,5%	9,2		
TCA	↓	16		12,7 %	1er quartile	3,9%	11,9		Effectif : 828
1952+1952A					Médiane	4,9%	13,7		Pairs : 7
Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]					3e quartile	6,5%	17,7		

TCA Dade Actin FS (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Sysmex CN (SYSMEX) [D1/PB7]	↓	46	6,3 %	1er quartile Médiane 3e quartile	3,9% 4,9% 6,5%	4,3 5,8 6,8		Effectif : 828 Pairs : 10
TCA Cephen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W1/PB7]	↓	16	8,2 %	1er quartile Médiane 3e quartile	3,9% 4,9% 6,5%	6,3 7,5 9,2		Effectif : 828 Pairs : 33
TCA (Rosner) Mélange HemosIL APTT-SP (liquid) (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP [G4/PG4]	↓	195216	4,9 %	1er quartile Médiane 3e quartile	6,1% 9,0% 10,6%	7,7 9,4 11,3		Effectif : 174 Pairs : 36
TCA sensible (Rosner) ACC Plasma HemosIL APTT-SP (liquid) (INSTRUMENTATION LABORATORY (Groupe WERFEN)) sur ACL TOP (Plasma normal congelé CRYOCHECK) [G4/PG4/P11]	↓	195216	5,9 %	1er quartile Médiane 3e quartile	7,7% 10,2% 12,8%	5,2 7,6 10,5		Effectif : 221 Pairs : 14
Temps de Quick (h)PT-phen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W2/PB7]	↓	195231	9,2 %	1er quartile Médiane 3e quartile	5,9% 7,7% 10,0%	6,9 8,3 10,4		Effectif : 1014 Pairs : 34
Temps de Quick Dade Innovin (SIEMENS Healthcare Diagnostics) sur Atellica COAG360 [D1/PB6]	↓	1952A8	4,5 %	1er quartile Médiane 3e quartile	5,9% 7,7% 10,0%			Effectif : 1014 Pairs : 6
Temps de Quick (h)PT-phen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W2/PB7]	↓	1952A32	5,2 %	1er quartile Médiane 3e quartile	5,9% 7,7% 10,0%	6,9 8,3 10,4		Effectif : 1014 Pairs : 34
Temps de Quick (h)PT-phen (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W2/PB7]	↓	631952+1952A	7,3 %	1er quartile Médiane 3e quartile	5,9% 7,7% 10,0%	6,9 8,3 10,4		Effectif : 1014 Pairs : 34
Temps de Thrombine Hemoclot Thrombin Time Liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W3/PB7]	↓	195216	14,9 %	1er quartile Médiane 3e quartile	7,8% 10,7% 13,8%	7,2 10,5 13,8		Effectif : 121 Pairs : 14
Temps de Thrombine Hemoclot Thrombin Time Liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W3/PB7]	↓	1952A16	20,6 %	1er quartile Médiane 3e quartile	7,8% 10,7% 13,8%	7,2 10,5 13,8		Effectif : 121 Pairs : 14
Temps de Thrombine Hemoclot Thrombin Time Liquide (LRT) (HYPHEN BIOMED) sur Sysmex CN (SYSMEX) [W3/PB7]	↓	321952+1952A	17,5 %	1er quartile Médiane 3e quartile	7,8% 10,7% 13,8%	7,2 10,5 13,8		Effectif : 121 Pairs : 14