E1 Raw rejection gap as recorded (all evaluation beats, matched threshold)

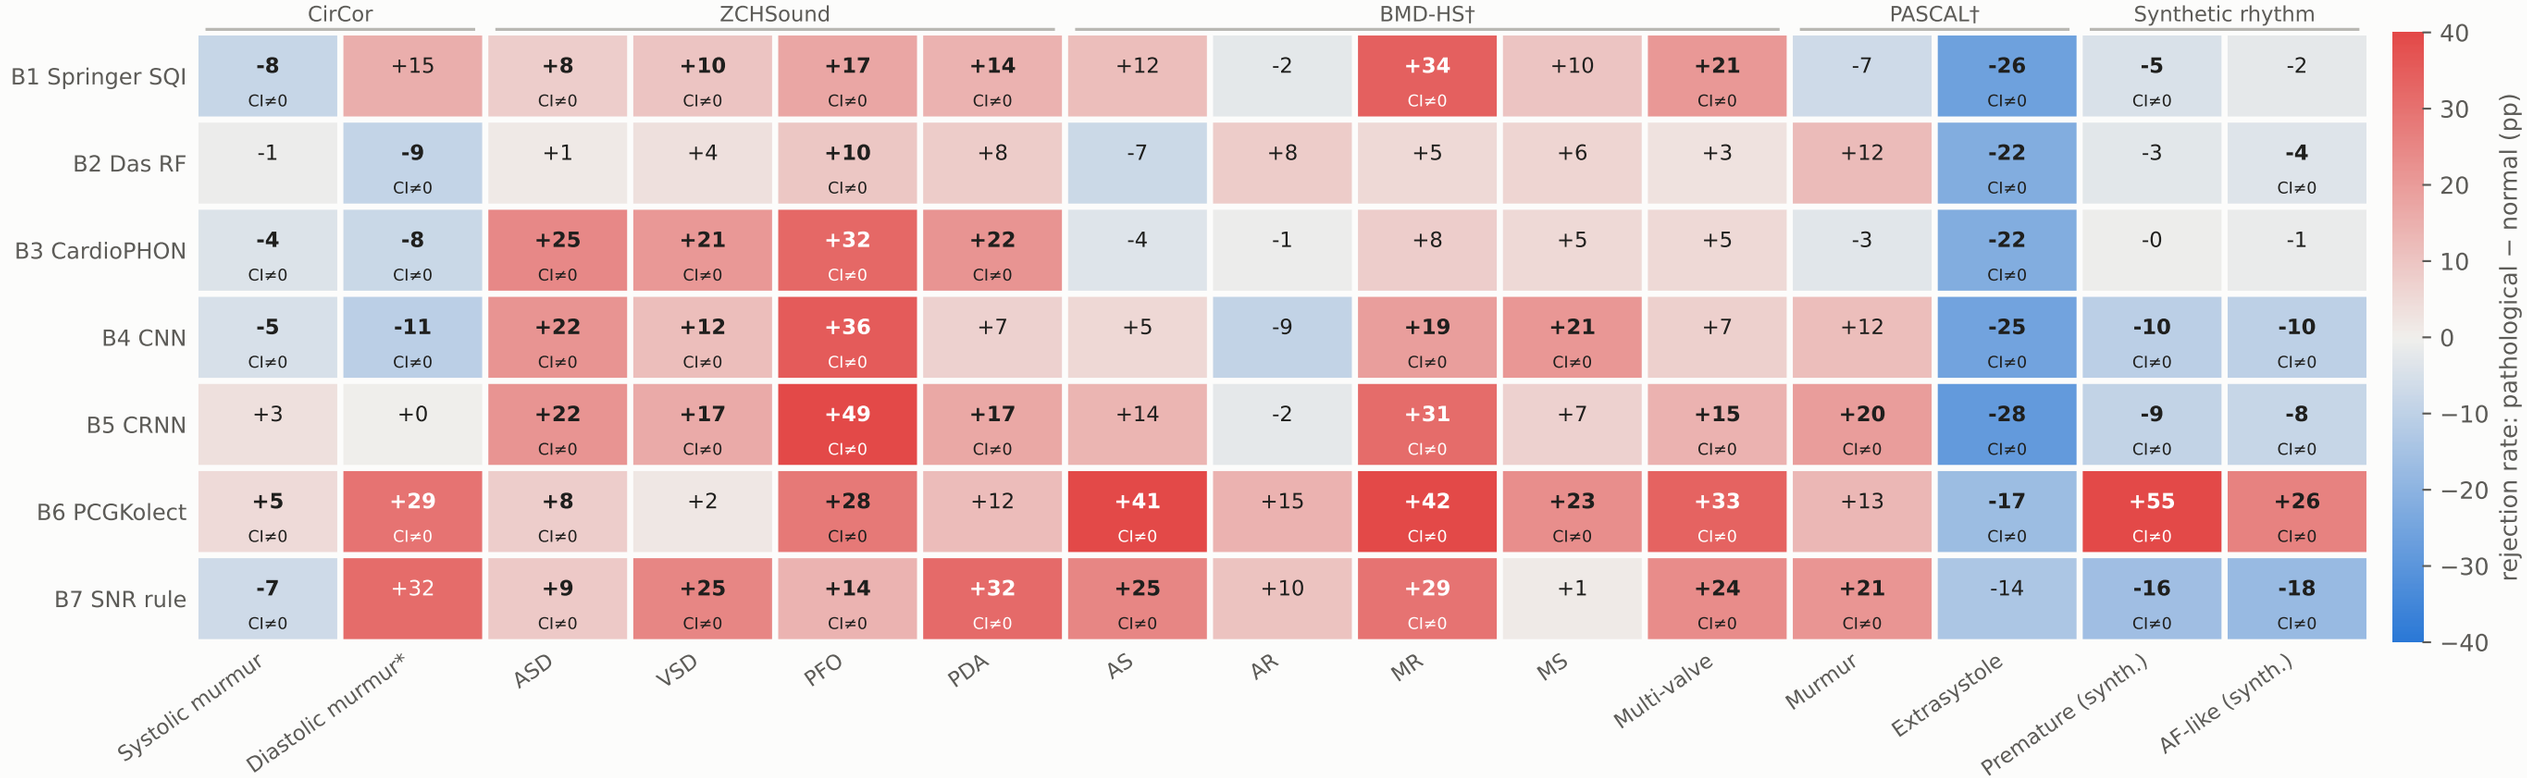

	Systolic murmur	Diastolic murmur*	ASD	VSD	PFO	PDA	AS	AR	MR	MS	Multi-valve	Murmur	Extrasystole	Premature (synth.)	AF-like (synth.)
B1 Springer SQI	**-8** CI≠0	+15	**+8** CI≠0	**+10** CI≠0	**+17** CI≠0	**+14** CI≠0	+12	-2	**+34** CI≠0	+10	**+21** CI≠0	-7	**-26** CI≠0	**-5** CI≠0	-2
B2 Das RF	-1	**-9** CI≠0	+1	+4	**+10** CI≠0	+8	-7	+8	+5	+6	+3	+12	**-22** CI≠0	-3	**-4** CI≠0
B3 CardioPHON	**-4** CI≠0	**-8** CI≠0	**+25** CI≠0	**+21** CI≠0	**+32** CI≠0	**+22** CI≠0	-4	-1	+8	+5	+5	-3	**-22** CI≠0	-0	-1
B4 CNN	**-5** CI≠0	**-11** CI≠0	**+22** CI≠0	**+12** CI≠0	**+36** CI≠0	+7	+5	-9	**+19** CI≠0	**+21** CI≠0	+7	+12	**-25** CI≠0	**-10** CI≠0	**-10** CI≠0
B5 CRNN	+3	+0	**+22** CI≠0	**+17** CI≠0	**+49** CI≠0	**+17** CI≠0	+14	-2	**+31** CI≠0	+7	**+15** CI≠0	**+20** CI≠0	**-28** CI≠0	**-9** CI≠0	**-8** CI≠0
B6 PCGKolect	**+5** CI≠0	**+29** CI≠0	**+8** CI≠0	+2	**+28** CI≠0	+12	**+41** CI≠0	+15	**+42** CI≠0	**+23** CI≠0	**+33** CI≠0	+13	**-17** CI≠0	**+55** CI≠0	**+26** CI≠0
B7 SNR rule	**-7** CI≠0	+32	**+9** CI≠0	**+25** CI≠0	**+14** CI≠0	**+32** CI≠0	**+25** CI≠0	+10	**+29** CI≠0	+1	**+24** CI≠0	**+21** CI≠0	-14	**-16** CI≠0	**-18** CI≠0

Red = pathology rejected more often than normal beats. Bold/"CI≠0" = 95 % patient-bootstrap CI excludes 0. * 5 patients. † small calibration sets. E1 mixes recording quality and filter behaviour; E2 isolates the filter.