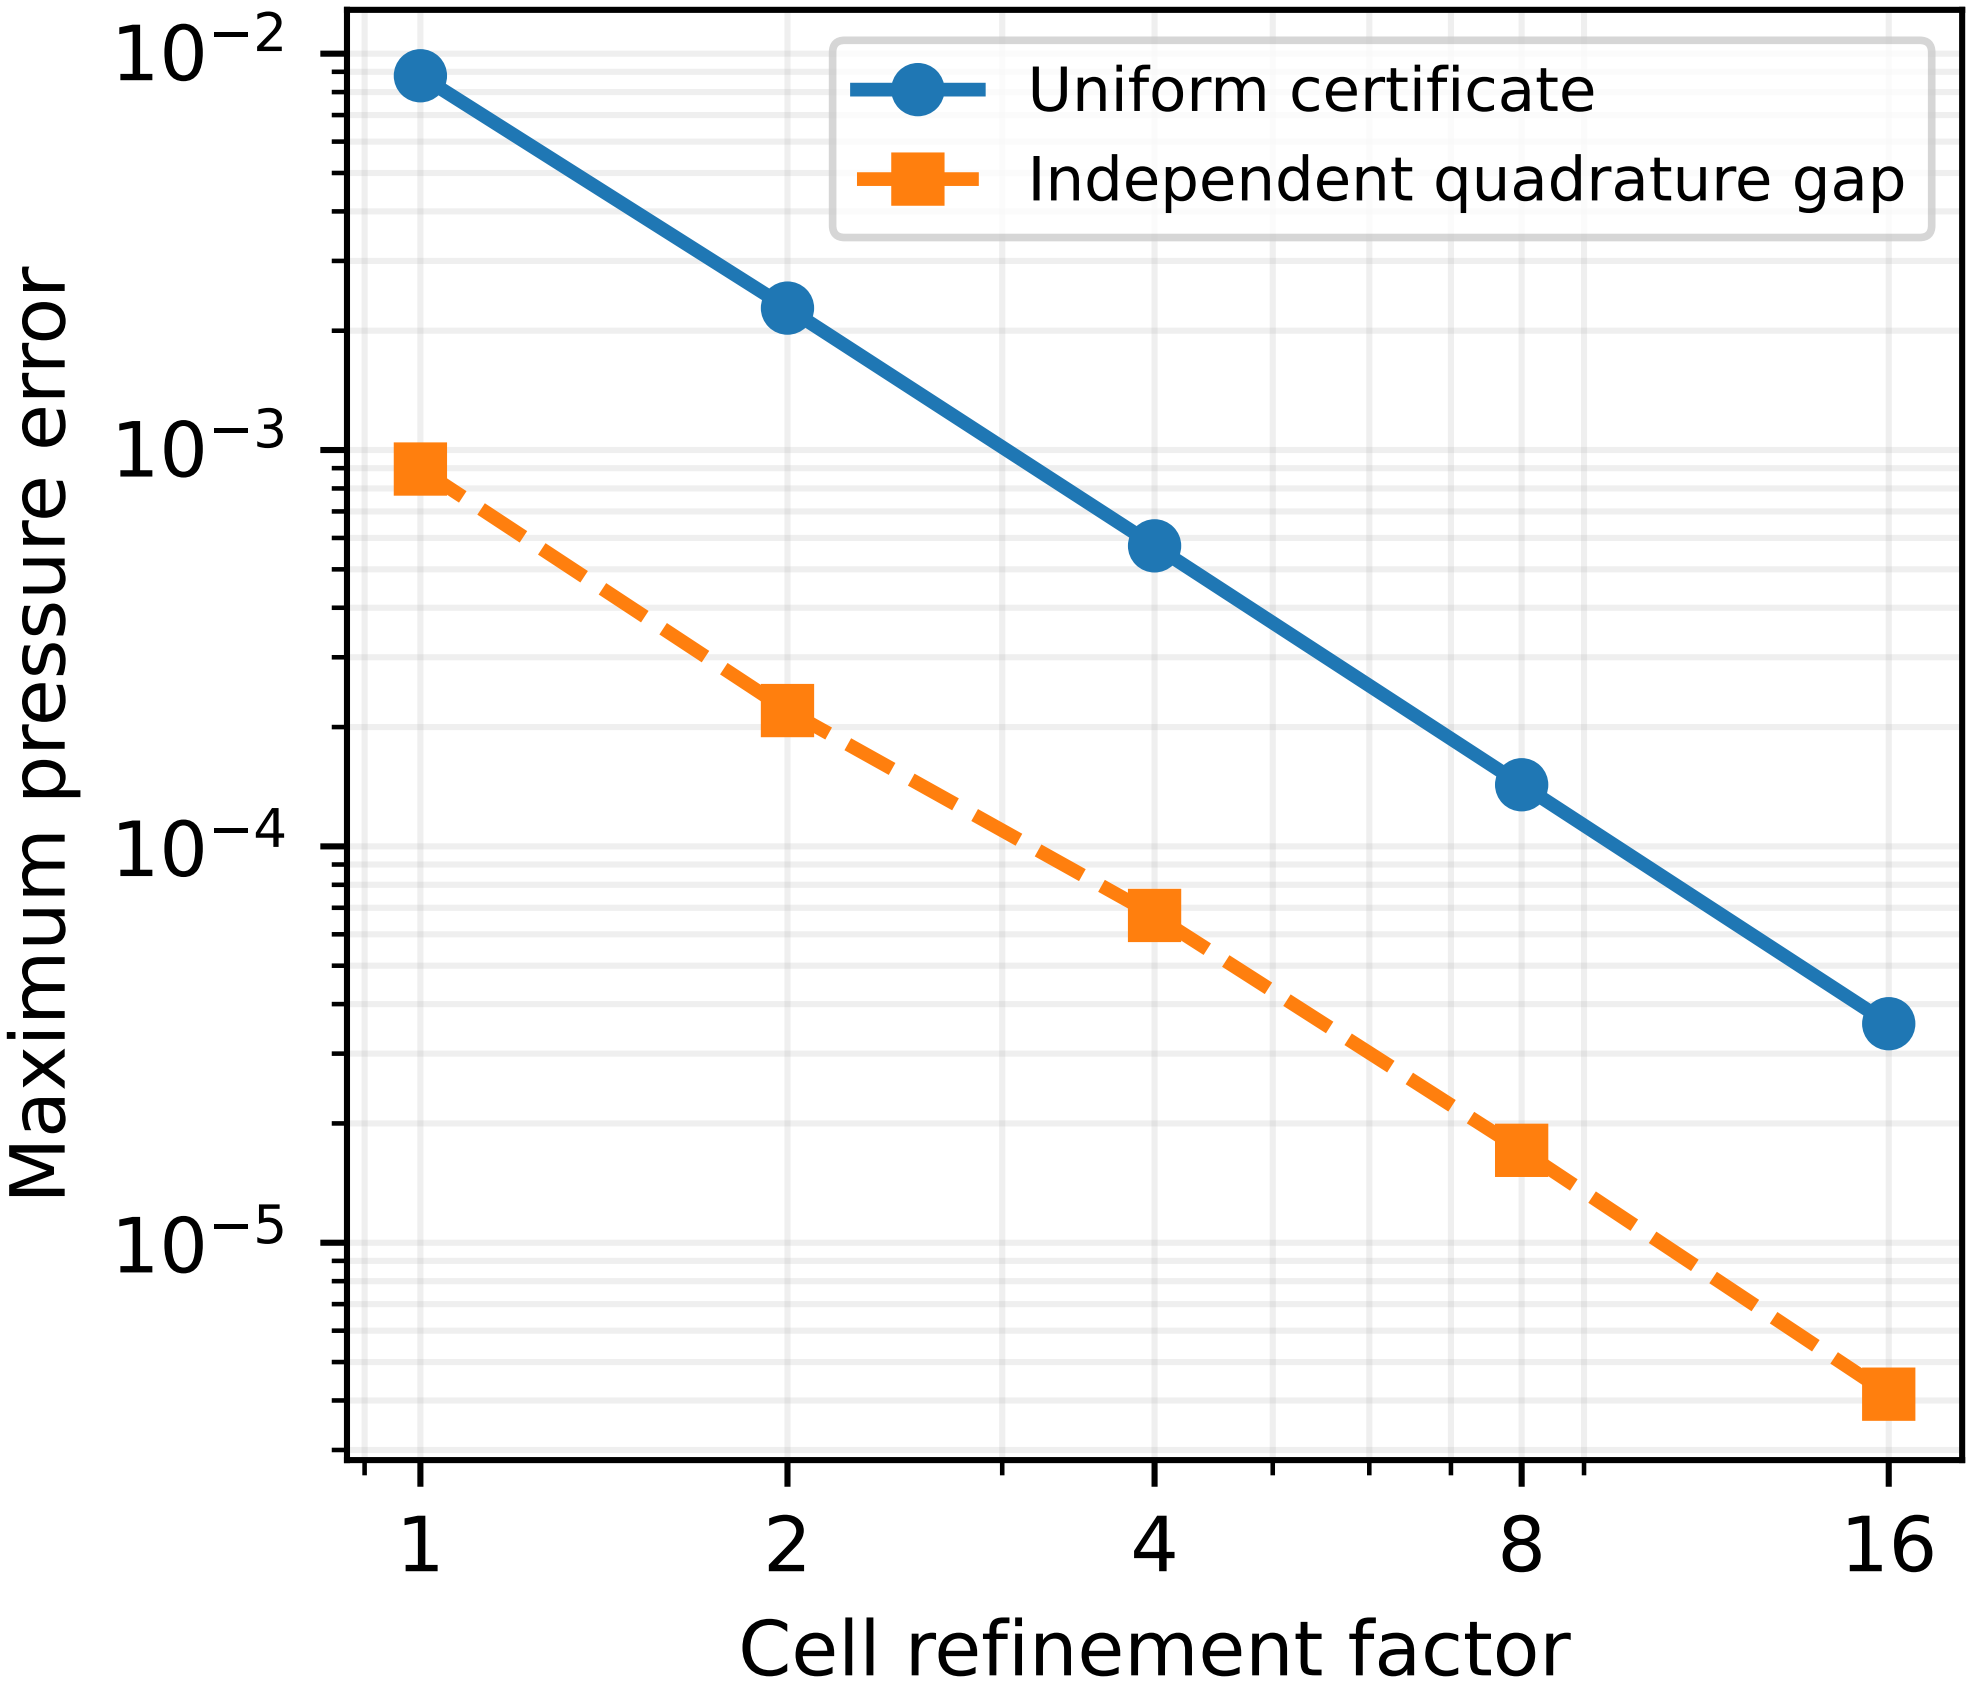
Uniform certificate
Independent quadrature gap
Maximum pressure error
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
1
2
4
8
16
Cell refinement factor