


TITRAGES


pH-métrie

conductimétrie

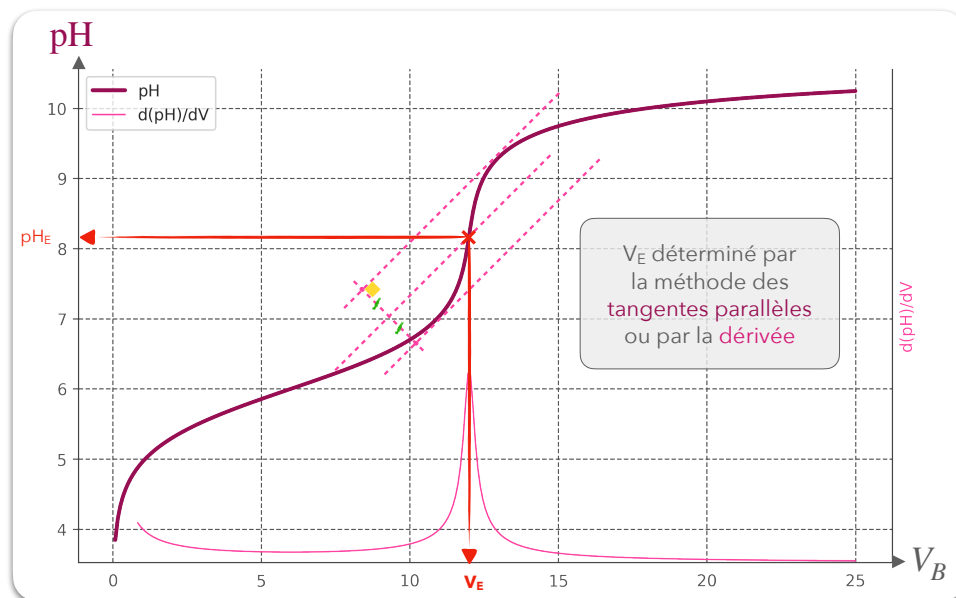

à l'équivalence :

saut de pH

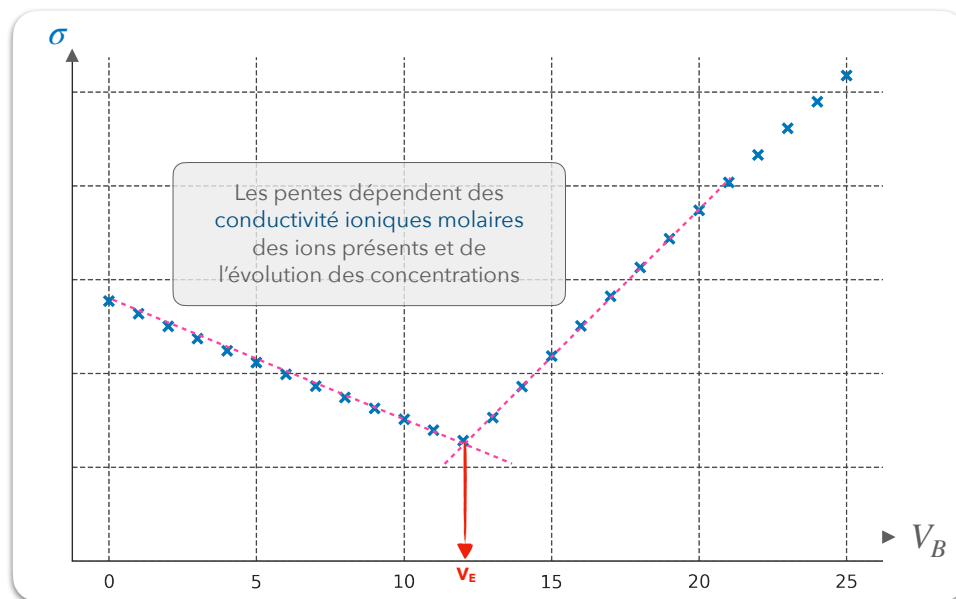

rupture de pente