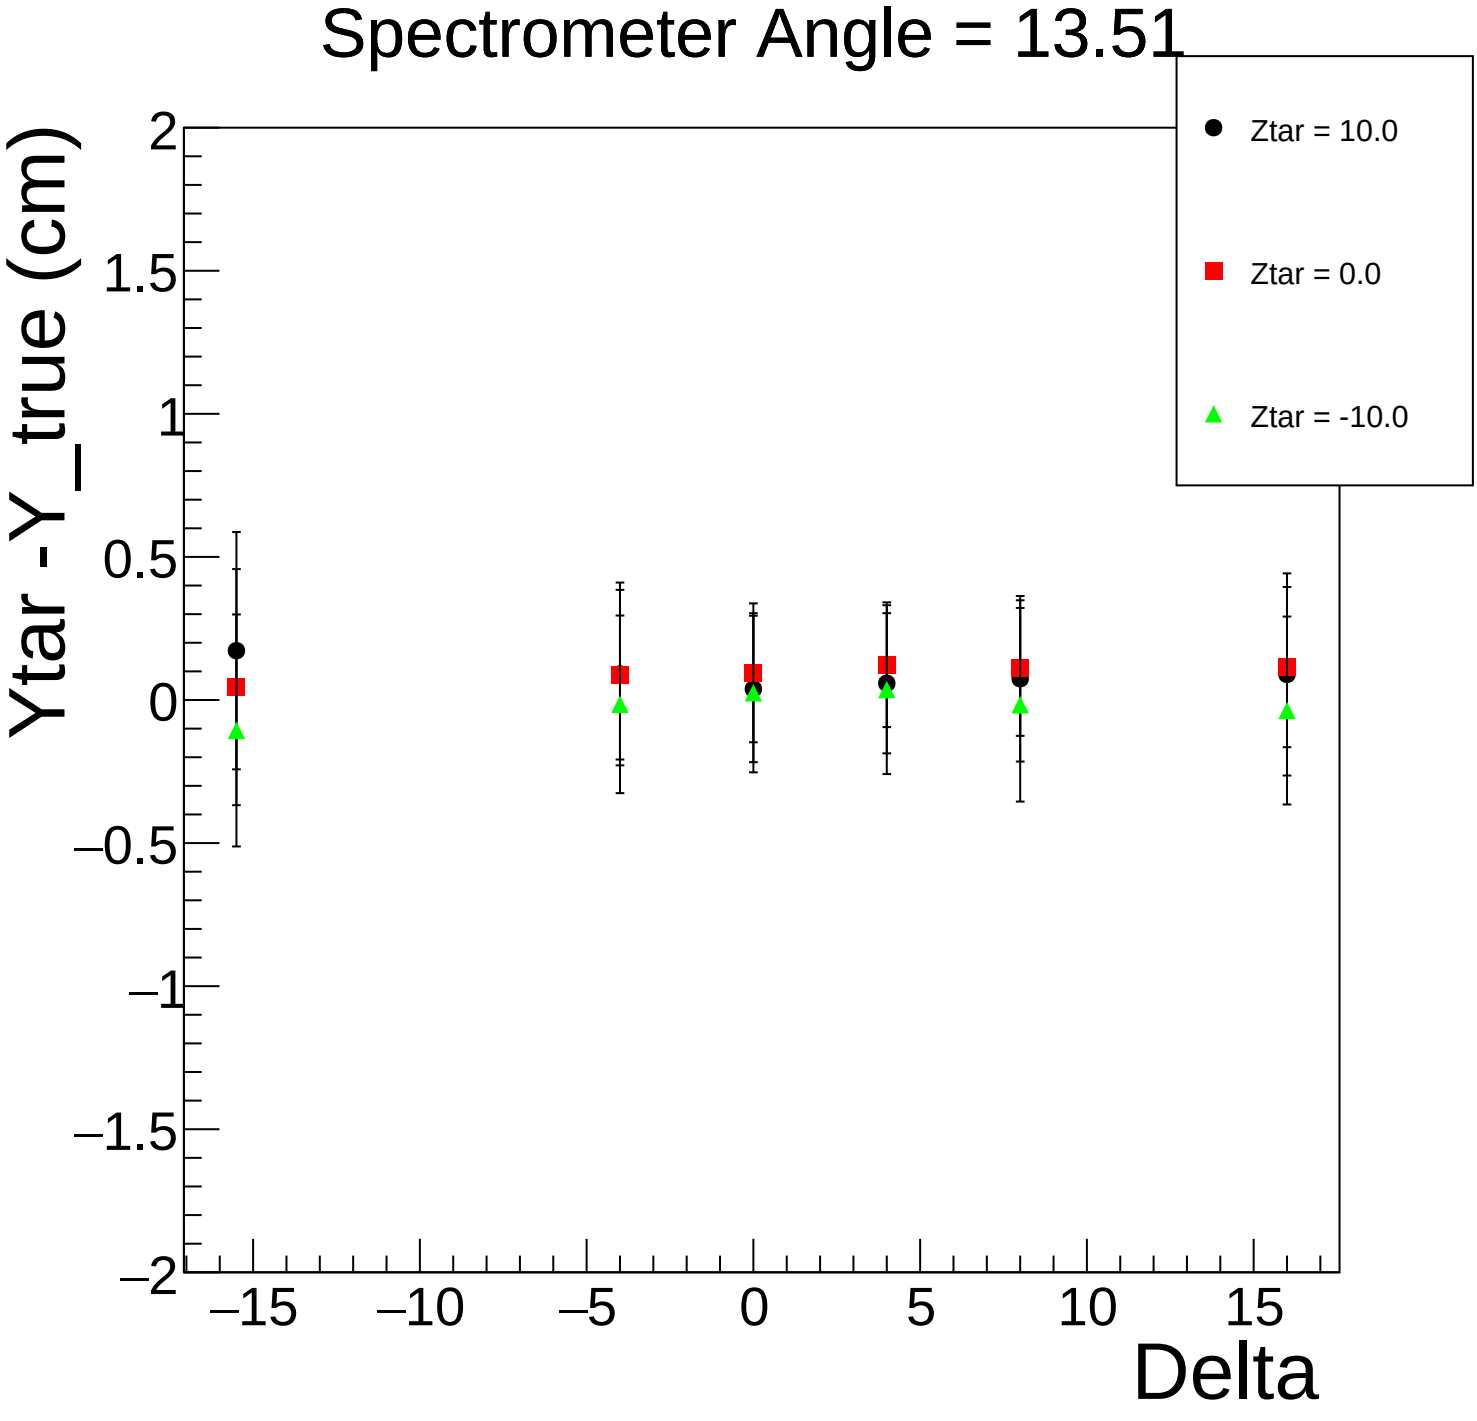
Spectrometer Angle = 13.51
Ztar = 10.0
Ztar = 0.0
Ztar = -10.0
Ytar -Y_true (cm)
2
1.5
1
0.5
0
–0.5
–1
–1.5
–2
–15
–10
–5
0
5
10
15
Delta