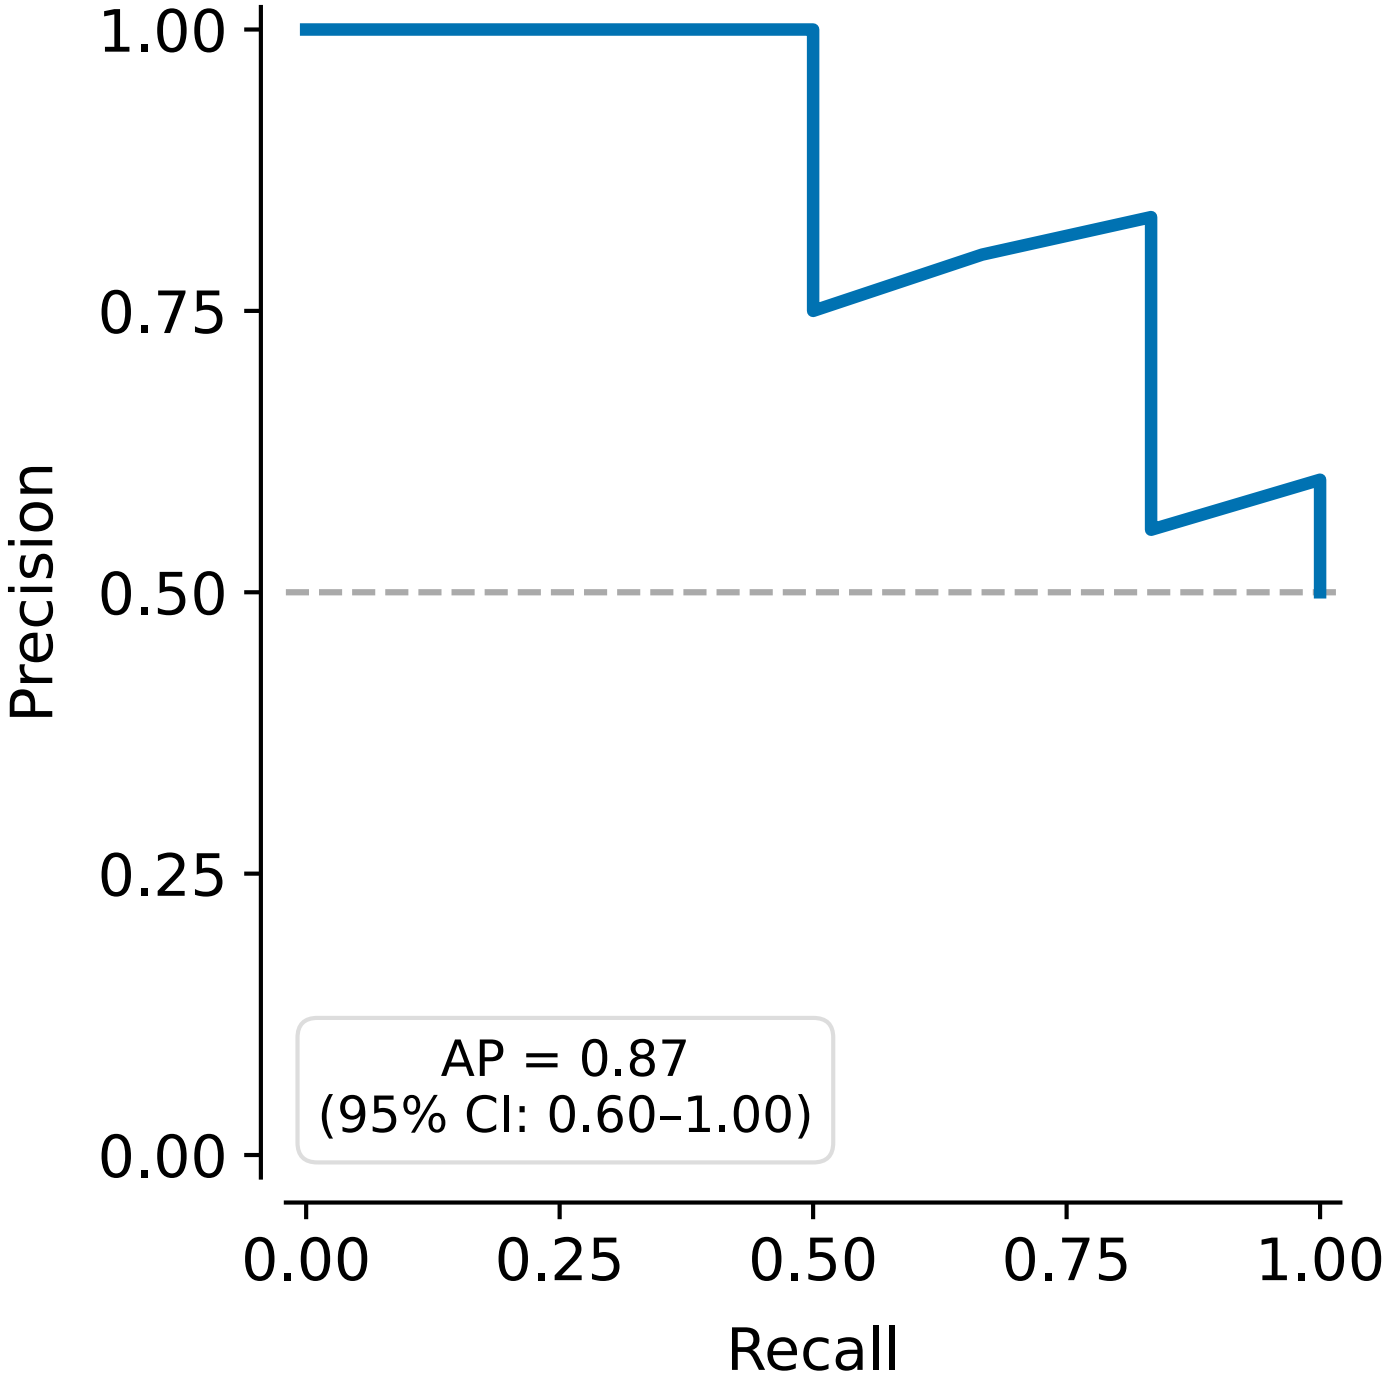
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Precision
AP = 0.87
(95% CI: 0.60–1.00)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Recall