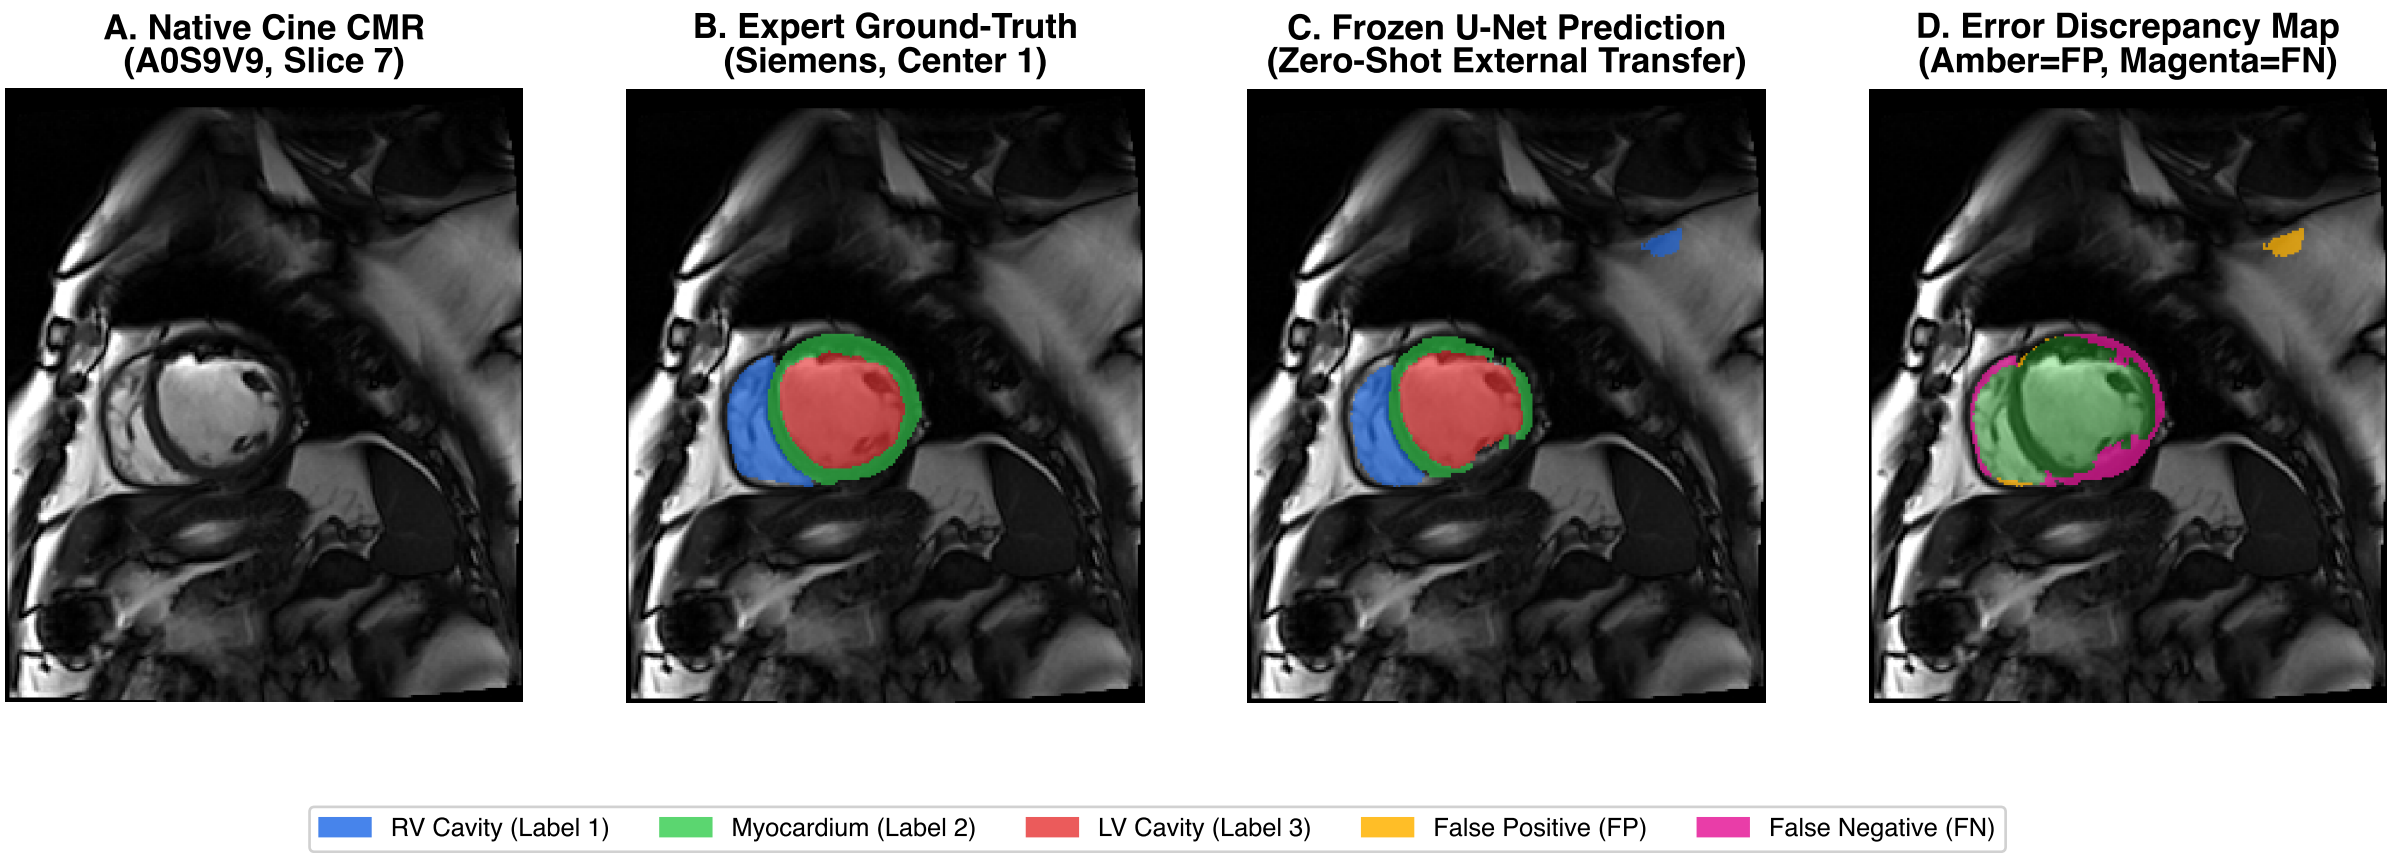

A. Native Cine CMR
(A0S9V9, Slice 7)
B. Expert Ground-Truth
(Siemens, Center 1)
C. Frozen U-Net Prediction
(Zero-Shot External Transfer)
D. Error Discrepancy Map
(Amber=FP, Magenta=FN)
RV Cavity (Label 1)
Myocardium (Label 2)
LV Cavity (Label 3)
False Positive (FP)
False Negative (FN)