

检 验 报 告

报告编号: ZC20190158

委 托 方: 吉林省杭盖桐博生物科技有限公司

样品名称: 医用水胶体敷料

规格型号: 240mg/瓶

检验类别: 注册检验

吉 林 省 医 疗 器 械 检 验 所



吉林省医疗器械检验所

检 验 报 告

报告编号: ZC20190158

共 6 页 第 1 页

样品名称	医用水胶体敷料	样品编号	ZC20190158
	送样	样品状态	包装完好
商 标	/	规格型号	240mg/瓶
委托方	吉林省杭盖桐博生物科技有限公司	检验类别	注册检验
委托方地址	吉林省长春市宽城区兴工路与海尔大街交汇以东约 500 米处一汽四环旭发厂房 B1、B2 栋	产品编号 / 批号	20190701
生产单位	吉林省杭盖桐博生物科技有限公司	抽样单编号	—
受检单位	吉林省杭盖桐博生物科技有限公司	生产 / 出厂日期	20190703
抽样单位	—	样品数量	60 瓶
抽样地点	—	抽样基数	—
抽样日期	—	检验地点	本所检验室
收样日期	2019.10.09	检验日期	2019.10.14 ~ 2020.06.02
检验项目	全项目		
检验依据	吉林省杭盖桐博生物科技有限公司《医用水胶体敷料》产品技术要求		
检验结论	被检样品符合吉林省杭盖桐博生物科技有限公司《医用水胶体敷料》产品技术要求。 (检验报告专用章) 签发日期 2020 年 6 月 5 日		
备 注	1) 报告中“—”表示此项不适用,“/”表示此项空白。 2) “本报告为内部参考,不具有对社会的证明作用”。		

批准:

(Signature)

职务:

副所长

编制:

李辉

吉林省医疗器械检验所



检 验 报 告

报告编号: ZC20190158

共 6 页 第 2 页

标准条款	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
2.1	外观	应为白色疏松块状物或粉末, 无肉眼可见异物。	白色疏松块状物, 无肉眼可见异物。	符合规定
2.2	装量	平均装量不少于标示装量, 每个容器装量不少于标示装量的 93%。	每个容器装量符合要求 平均装量: 285mg	符合规定

本页以下空白

审核:  检验:  

吉林省医疗器械检验所

检 验 报 告

报告编号: ZC20190158

共 6 页 第 3 页

标准条款	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
2.3	含量	钠含量应在 5g/kg ~ 20g/kg 之间。	11g/kg	符合规定
2.4	pH 值	应在 4.0 ~ 7.0 之间。	5.9	符合规定
2.5	重金属总含量	应不大于 10μg/mL。	符合要求	符合规定

本页以下空白

审核: 隋 巍 检验: 范 娜 王 维 鑫

吉林省医疗器械检验所

检 验 报 告

报告编号: ZC20190158

共 6 页 第 4 页

标准条款	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
2.6	无菌	应无菌	无菌	符合规定

本页以下空白

审核: 隋 颖

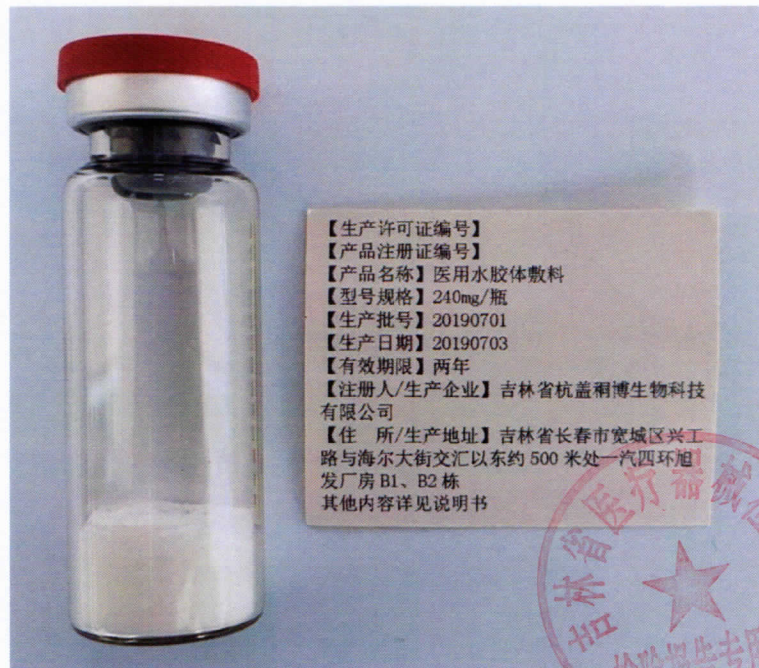
检验: 姜 颖 李 松

检验报告照片页

报告编号: ZC20190158

共 6 页 第 5 页

照片和说明



批号: 20190701

样品描述

被检样品与产品照片上的样品一致。

型号规格或其它说明

型号规格与产品照片上的样品一致。

吉林省医疗器械检验所

产品技术要求预评价意见

报告编号: ZC20190158

共 6 页 第 6 页

一	产品技术要求中性能指标的完整性与适用性。	
	☒ 完整	☐ 不完整 理由:
	☒ 适用	☐ 不适用 理由:
	检验方法是否具有可操作性和可重复性, 是否与检验要求相适应。	
	☒ 可操作	☐ 不可操作 理由:
	☒ 可重复	☐ 不可重复 理由:
	☒ 相适应	☐ 不相适应 理由:
二	依据现行强制性或推荐性国家标准、行业标准检验的, 所用强制性国家标准、行业标准的完整性, 所用标准与产品的适宜性, 所用条款的适用性。	
	强制性或推荐性国家标准	GB/T 14233.1-2008
	强制性或推荐性行业标准	无
	☒ 完整	☐ 不完整 理由:
	☒ 适宜	☐ 不适宜 理由:
	☒ 适用	☐ 不适用 理由:
三	如检验内容涉及引用中国药典的相关内容, 其引用的完整性、适宜性和适用性。	
	中国药典	《中华人民共和国药典》2015 年版四部 0942 最低装量检查法 《中华人民共和国药典》2015 年版四部 0631pH 值测定法 《中华人民共和国药典》2015 年版四部 1101 无菌检查法
	☒ 完整	☐ 不完整 理由:
	☒ 适宜	☐ 不适宜 理由:
	☒ 适用	☐ 不适用 理由:
四	其他需要说明的问题:	
	无	
五	综合评价意见:	
	☒ 经预评价, 对产品技术要求无补充、完善意见。	
	☐ 经预评价, 产品技术要求在以下方面需要进一步补充、完善:	
	性能指标:	
	适用国家标准、行业标准:	
	引用《中华人民共和国药典》内容:	



注 意 事 项

- 一、报告无检验机构检验报告专用章无效。
- 二、报告未经检验机构书面批准不得复制。
- 三、复制报告未重新加盖检验机构检验报告专用章无效。
- 四、报告无批准人签字无效。
- 五、报告涂改无效。
- 六、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面方式向检验单位提出，逾期不予受理。
- 七、报告仅对来样负责。

地 址：长春市崇文路 669 号

电 话：0431-87833065

传 真：0431-87833066

邮政编码：130062

