Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4511
CALIBRATION DATE: 21-May-24

SBE 43F OXYGEN CALIBRATION DATA

COEFFICIENTS:
Soc = 3.0706e-004 (adj)
Foffset = -833.09
Tau20 = 1.38

A = -2.8836e-003
B = 1.1191e-004
C = -2.2337e-006
E nominal = 0.036

NOMINAL DYNAMIC COEFFICIENTS
D1 = 1.92634e-4
D2 = -4.64803e-2
H1 = -3.300000e-2
H2 = 5.00000e+3
H3 = 1.45000e+3

BATH OX (ml/l)	BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT OXYGEN (ml/l)	RESIDUAL (ml/l)
1.13	2.00	0.00	1234.342	1.13	-0.00
1.13	6.00	0.00	1284.351	1.13	-0.00
1.15	12.00	0.00	1365.685	1.15	0.00
1.17	20.00	0.00	1478.934	1.16	-0.00
1.17	26.00	0.00	1566.984	1.17	-0.00
1.18	30.00	0.00	1634.948	1.18	0.00
3.88	2.00	0.00	2211.529	3.88	0.00
3.89	6.00	0.00	2382.211	3.89	0.00
3.91	12.00	0.00	2644.692	3.91	-0.00
3.93	20.00	0.00	3012.068	3.93	0.00
3.95	26.00	0.00	3305.012	3.95	0.00
3.97	30.00	0.00	3528.013	3.98	0.00
6.69	2.00	0.00	3209.520	6.69	-0.00
6.74	6.00	0.00	3514.999	6.74	-0.00
6.75	30.00	0.00	5404.995	6.75	-0.00
6.75	12.00	0.00	3965.398	6.75	-0.00
6.82	20.00	0.00	4615.610	6.82	0.00
6.84	26.00	0.00	5115.303	6.84	-0.00

F = instrument output (Hz); T = temperature (°C); S = salinity (PSU); K = temperature (°K)

Oxsol(T,S) = oxygen saturation (ml/l); P = pressure (dbar)

$$\text{Oxygen (ml/l)} = \text{Soc} * (F + \text{Foffset}) * (1.0 + A * T + B * T^2 + C * T^3) * \text{Oxsol}(T,S) * \exp(E * P / K)$$
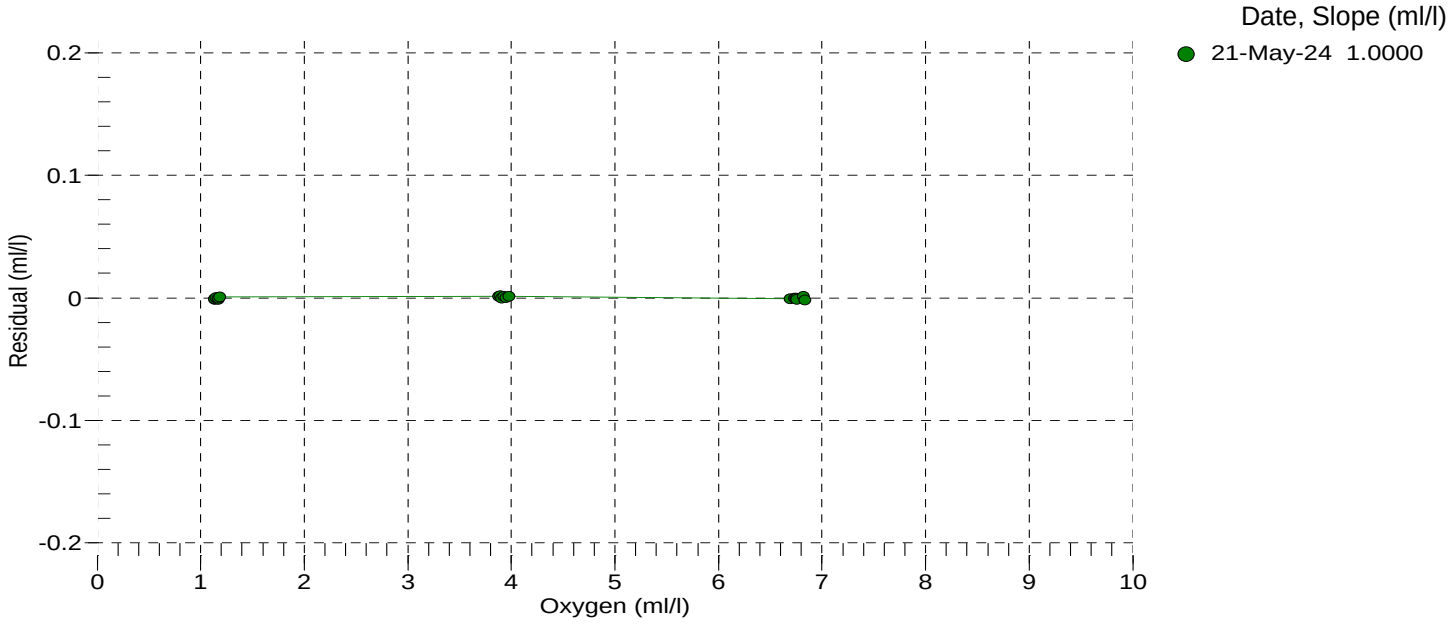
Residual (ml/l) = instrument oxygen - bath oxygen