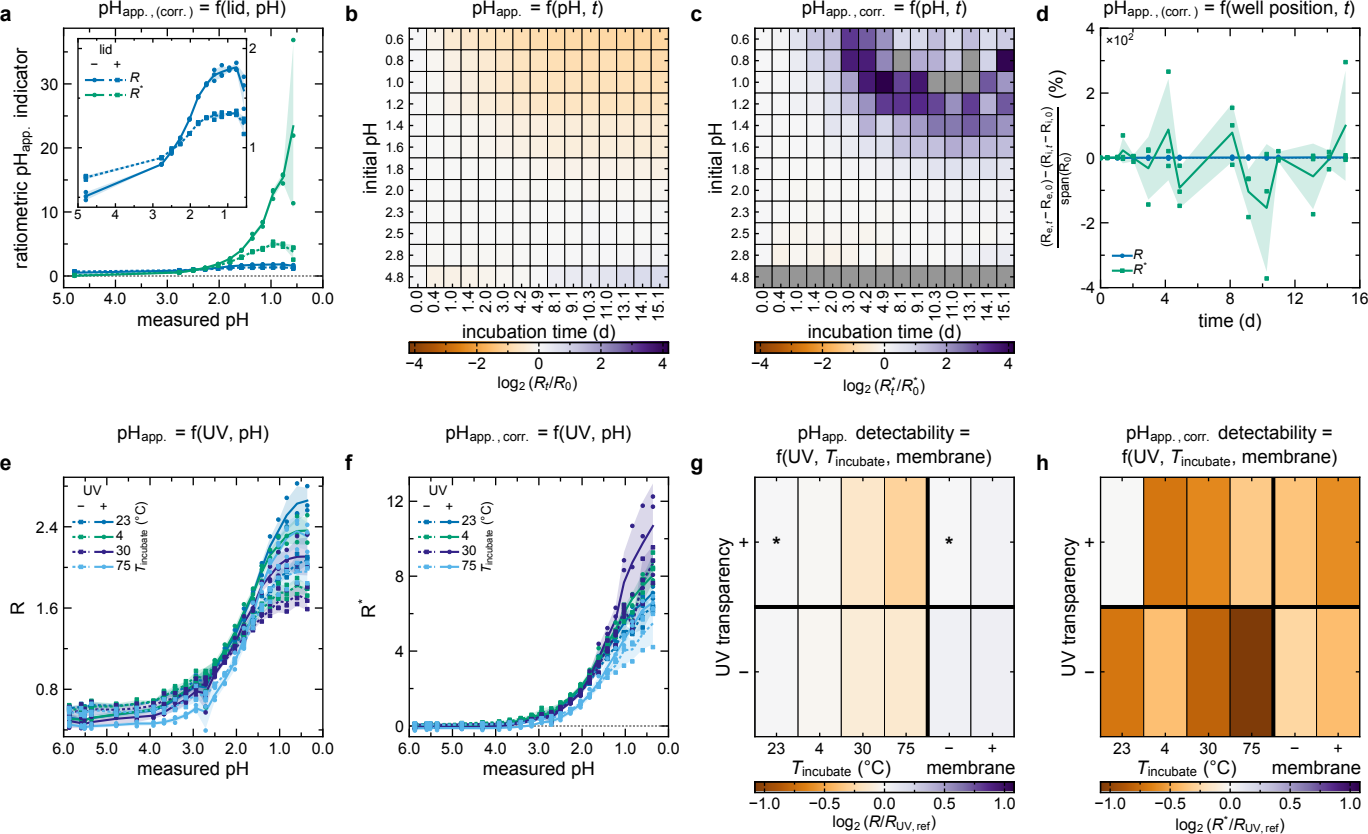

a
pH app., (corr.) = f(lid, pH)
ratiometric pH app. indicator
measured pH
lid
R
R*
b
pH app. = f(pH, t)
initial pH
incubation time (d)
log2 (Rt/R0)
c
pH app., corr. = f(pH, t)
initial pH
incubation time (d)
log2 (R*t/R*0)
d
pH app., (corr.) = f(well position, t)
×10²
(%)
time (d)
e
pH app. = f(UV, pH)
UV
T incubate (°C)
R
measured pH
f
pH app., corr. = f(UV, pH)
R*
measured pH
g
pH app. detectability = f(UV, T incubate, membrane)
UV transparency
T incubate (°C)
membrane
log2 (R/RUV, ref)
h
pH app., corr. detectability = f(UV, T incubate, membrane)
UV transparency
T incubate (°C)
membrane
log2 (R*/RUV, ref)