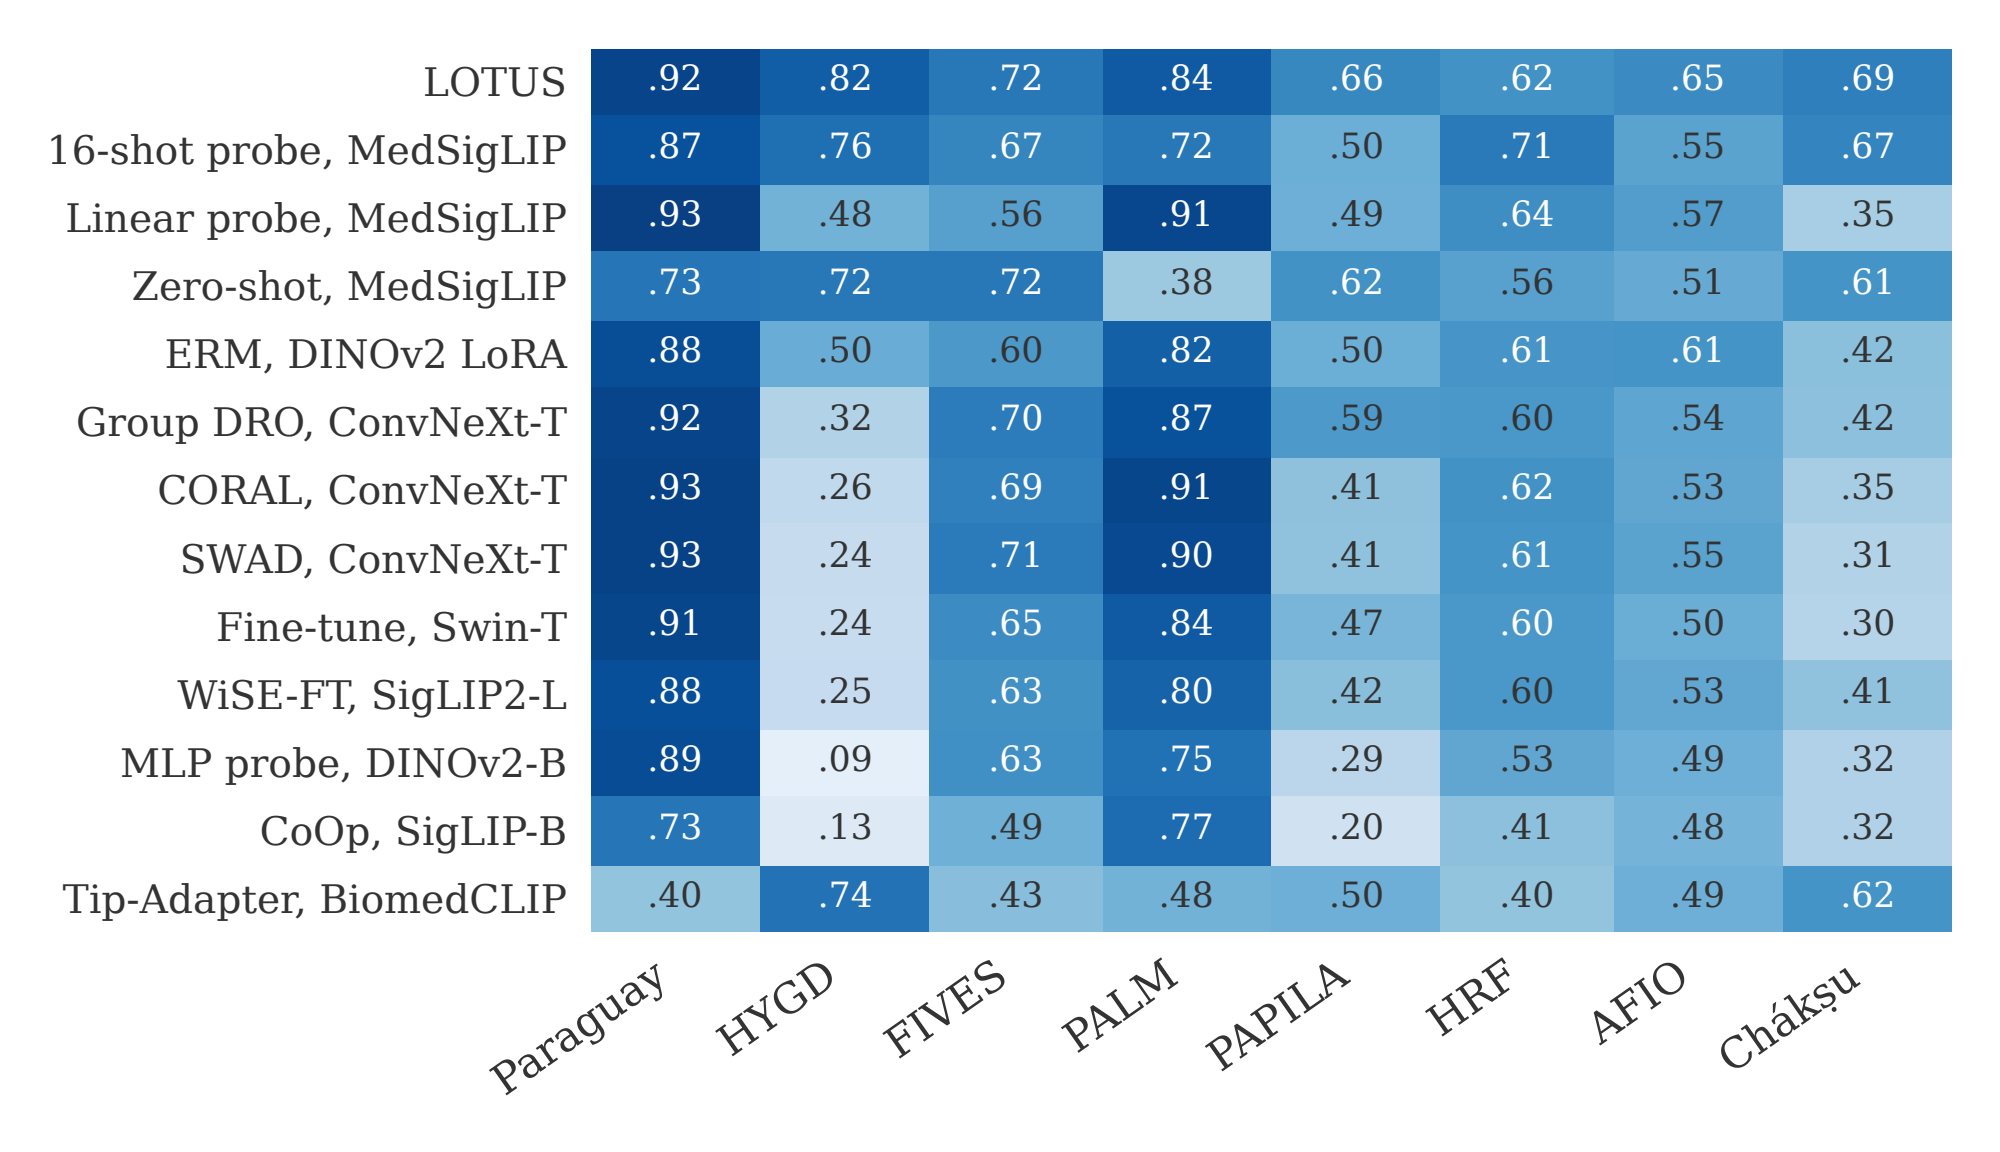
LOTUS .92 .82 .72 .84 .66 .62 .65 .69
16-shot probe, MedSigLIP .87 .76 .67 .72 .50 .71 .55 .67
Linear probe, MedSigLIP .93 .48 .56 .91 .49 .64 .57 .35
Zero-shot, MedSigLIP .73 .72 .72 .38 .62 .56 .51 .61
ERM, DINOv2 LoRA .88 .50 .60 .82 .50 .61 .61 .42
Group DRO, ConvNeXt-T .92 .32 .70 .87 .59 .60 .54 .42
CORAL, ConvNeXt-T .93 .26 .69 .91 .41 .62 .53 .35
SWAD, ConvNeXt-T .93 .24 .71 .90 .41 .61 .55 .31
Fine-tune, Swin-T .91 .24 .65 .84 .47 .60 .50 .30
WiSE-FT, SigLIP2-L .88 .25 .63 .80 .42 .60 .53 .41
MLP probe, DINOv2-B .89 .09 .63 .75 .29 .53 .49 .32
CoOp, SigLIP-B .73 .13 .49 .77 .20 .41 .48 .32
Tip-Adapter, BiomedCLIP .40 .74 .43 .48 .50 .40 .49 .62
Paraguay
HYGD
FIVES
PALM
PAPILA
HRF
AFIO
Chákṣu