CMD-W-04

PENANGANAN KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN ALAT UKUR

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA FERYANTI / QC MSA SPV

Versi Indonesia

PENANGANAN KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN ALAT UKUR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk untuk menangani kerusakan & kehilangan alat ukur. Dimana pengadaan alat ukur tersebut dilakukan oleh QC MSA.

WHEN Petunjuk ini digunakan saat terjadi kerusakan atau kehilangan alat ukur, termasuk identitas yang tertera pada alat ukur yang bersangkutan.


WHERE Instruksi ini diterapkan di semua proses produksi atau proses support produksi yang menggunakan alat ukur.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Dept terkait yang menggunakan alat ukur tersebut dan dibawah pengontrolan QC MSA.

PENANGANAN KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN ALAT UKUR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

II. A.FLOW CHART KERUSAKAN ALAT UKUR (SELAIN STRAIGHT METER)

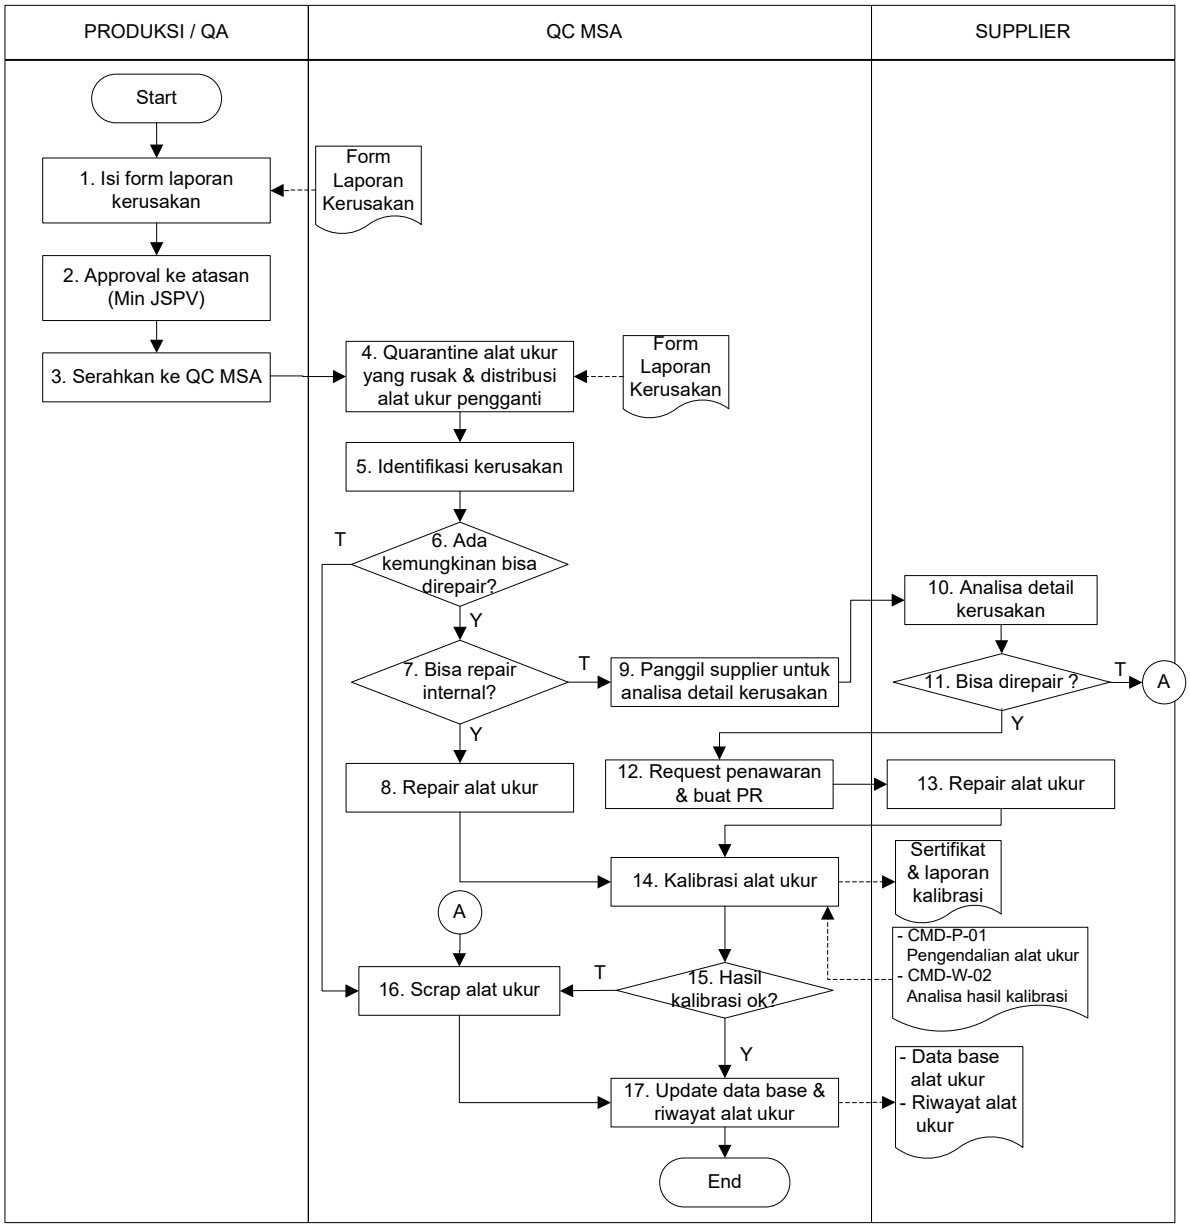

II. B.PENJELASAN FLOW CHART KERUSAKAN ALAT UKUR (SELAIN STRAIGHT METER)

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Input	Output
1	Prod /QA	Isi form laporan kerusakan alat ukur	Pemakai alat ukur dari masing-masing dept.terkait yang merusakkan alat ukur mengisi form laporan kerusakan alat ukur	Form laporan kerusakan kosong	Form laporan kerusakan terisi
2	Prod /QA	Approval ke atasan (min JSPV)	Meminta approval form kerusakkan alat ukur kepada atasannya minimal JSPV.	Form laporan kerusakan	
3	Prod /QA	Serahkan ke QC MSA	Menyerahkan form kerusakan alat ukur beserta alat ukur yang rusak ke QC MSA.		Form laporan kerusakan & alat ukur rusak
4	QC MSA	Quarantine alat ukur yang rusak & distribusi alat ukur pengganti	Quarantine alat ukur yang rusak dengan memberikan identitas pada alat ukur tersebut, serta mendistribusikan alat ukur penggantinya	Form laporan kerusakan & alat ukur rusak	
5	QC MSA	Identifikasi kerusakan	Mengidentifikasi kerusakan pada alat ukur tersebut, apakah ada kemungkinan bisa direpair atau tidak,dan jika bisa direpair apakah repair internal atau menggunakan supplier		
6	QC MSA	Ada kemungkinan bisa direpair?	Jika alat ukur tersebut bisa direpair lanjut ke no.7, jika tidak bisa direpair maka lanjut ke no.16. Alat ukur yang tidak bisa direpair : Straightmeter, Rollmeter, Stell ruller.		
7	QC MSA	Bisa direpair internal ?	Jika bisa dilakukan repair / perbaikan internal lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke no.9		
8	QC MSA	Repair alat ukur	PIC dari QC MSA melakukan repair / perbaikan terhadap alat ukur yang rusak		
9	QC MSA	Panggil supplier untuk analisa detail kerusakan	Staff dari QC MSA berkoordinasi dengan Purchasing untuk mendatangkan supplier, untuk melakukan analisa detail kerusakan alat ukur		
10	Supplier	Analisa detail kerusakan	Supplier melakukan analisa detail kerusakkan, apakah alat tersebut bisa direpair / tidak. Jika bisa direpair, apakah membutuhkan pergantian spare part, berapa lama lead		

PENANGANAN KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN ALAT UKUR


Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Input	Output
			time repair dan juga tempat dilakukannya repair apakah di JAI atau alat tersebut perlu dibawa keluar JAI		
11	Supplier	Bisa direpair ?	Jika alat ukur tersebut bisa direpair maka lanjut ke no. 12, jika tidak bisa direpair lanjut ke no.16		
12	QC MSA	Request penawaran & buat PR	Meminta penawaran alat ukur yang akan direpair dari supplier, untuk dibuatkan form Purchase Request (PR), serta Purchase akan mengirimkan Purchase order (PO) ke suppler yang ditunjuk		
13	Supplier	Repair Alat Ukur	Seletah menerima Purchase Order (PO) dari JAI, Supplier akan melakukan repair alat ukur sesuai dengan detail kerusakkan yang sudah dianalisa sebelumnya.		
14	QC MSA	Kalibrasi	Melakukan kalibrasi terhadap alat ukur yang sudah selesai direpair.	CMD-P-01 Pengendalian alat ukur CMD-W-02 Analisa hasil kalibrasi	Sertifikat & laportaan kalibrasi
15	QC MSA	Hasil analisa kalibrasi OK ?	Jika hasil kalibrasi OK, lanjut ke no.17, jika tidak lanjut ke no.16		
16	QC MSA	Scrap alat ukur	Alat ukur yang sudah tidak bisa direpair maka akan discrap oleh QC MSA sesuai dengan prodesur scrap PT.JAI		
17	QC MSA	Update data base & riwayat alat ukur	Catat kerusakan alat ukur, tindakan yang diambil dan hasil akhir dari tindakan pada form Riwayat Alat Ukur untuk alat ukur tsb. Lampirkan dokumen pendukung, misalnya Laporan Kerusakan Alat Ukur, dll.	- Laporan kerusakan - Sertifikat & laportaan kalibrasi	- Database alat ukur - Riwayat alat ukur

PENANGANAN KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN ALAT UKUR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. A. FLOW CHART KERUSAKAN ALAT UKUR (STRAIGHT METER)

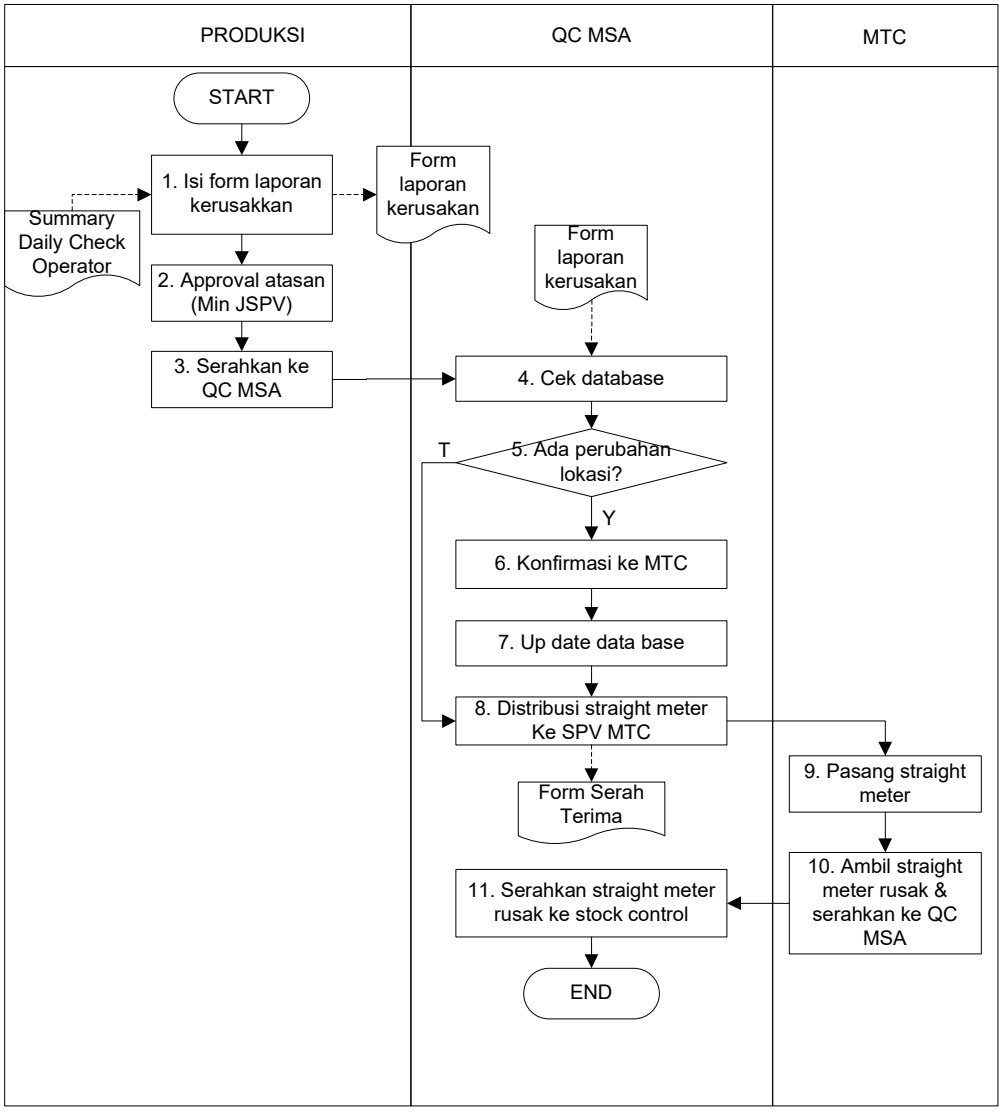


III. B.PENJELASAN FLOW CHART KERUSAKAN ALAT UKUR (STRAIGHT METER)

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Input	Output
1	Produksi	Isi form laporan kerusakan alat ukur	LL Produksi mengisi form laporan kerusakkan alat ukur berdasarkan informasi dari operator	Summary daily check operator	Form Laporan kerusakan
2	Produksi	Approval ke atasan (min JSPV)	Meminta approval form kerusakkan alat ukur kepada atasannya minimal JSPV.		
3	Produksi	Serahkan ke QC MSA	Menyerahkan form kerusakan alat ukur yang sudah diapproval ke QC MSA		
4	QC MSA	Cek database	Melakukan pengecekan lokasi straight meter yang rusak di data base	Form Laporan kerusakan	
5	QC MSA	Ada perubahan lokasi?	Jika lokasi straight meter yang tertera di form kerusakan sesuai dengan di data base lanjut ke no.8, jika tidak sesuai lanjut ke no.6		
6	QC MSA	Konfirmasi ke MTC	Melakukan konfirmasi perubahan lokasi mesin ke MTC		
7	QC MSA	Up date data base	Melakukan up date data base sesuai dengan informasi yang diterima dari MTC		
8	QC MSA	Distribusi straight meter ke SPV MTC	PIC dari QC MSA mendistribusikan straight meter baru yang sudah dikalibrasi ke SPV MTC (SPV back up) disertai form serah terima straight meter. Form serah terima berisi : Identitas mesin/ lokasi, ukuran straight meter, no id straight meter lama, no id straight meter baru		Form Serah Terima straight meter
9	MTC	Pasang straight meter	Teknisi MTC melepas straight meter lama yang rusak dan menggantinya dengan straight meter baru Note : 1. Pastikan saat pemasangan ada cover pelindung straight meter dan kondisi cover tidak buram / rusak 2. Straight meter lama yang rusak dikembalikan ke QC MSA	Straight meter baru	Straight meter rusak
10	MTC	Ambil straight meter rusak & serahkan ke QC MSA	Straight meter lama / yang rusak di simpan untuk serahkan kembali ke QC MSA beserta list status pemasangannya		
11	QC MSA	Serahkan straight meter rusak ke stock control	Straight meter yang lama / rusak diserahkan ke area stock control sebagai bukti adanya pergantian		

PENANGANAN KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN ALAT UKUR

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. A.FLOW CHART KEHILANGAN ALAT UKUR

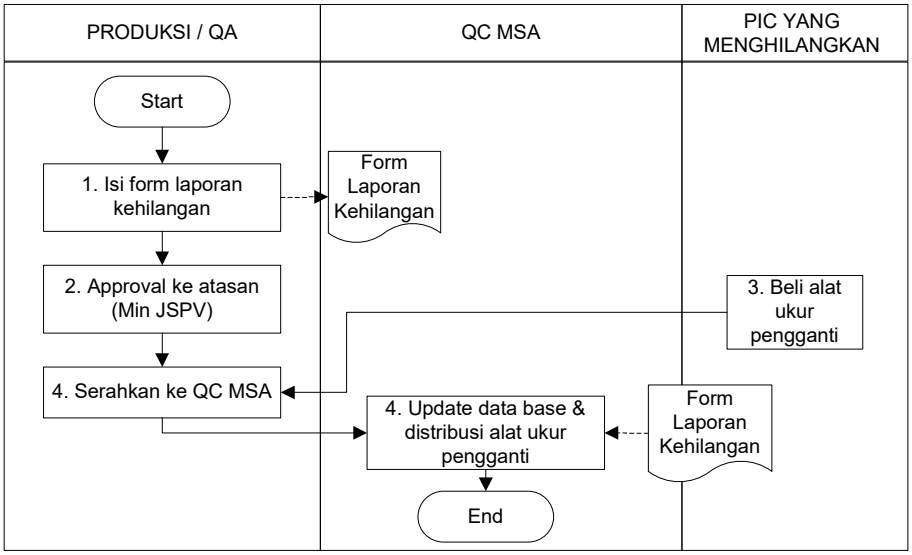

IV. B.PENJELASAN FLOW CHART KEHILANGAN ALAT UKUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Input	Output
1	Prod / QA	Isi form laporan kehilangan alat ukur	Pemakai alat ukur dari masing-masing dept.terkait yang menghilangkan alat ukur mengisi form laporan kehilangan alat ukur (kronologi kejadiannya)		Form laporan kehilangan
2	Dept. Terkait	Approval ke atasan (min JSPV)	Meminta approval form kehilangan alat ukur kepada atasannya minimal JSPV.		
3	PIC Yang Menghi langkan	Beli alat ukur pengganti	PIC / operator yang menghilangkan alat ukur baik sengaja maupun tidak, maka harus menggantikan dengan spec yang sama dan diserahkan ke QC MSA untuk dikalibrasi		
4	Dept. Terkait	Serahkan ke QC MSA	Menyerahkan form kehilangan alat ukur ke QC MSA beserta alat ukur yang baru sebagai pengganti untuk dikalibrasi		
5	QC MSA	Up date data base & distribusi alat ukur pengganti	Melakukan up date data base untuk alat ukur yang hilang dan mendistribusikan alat ukur pengganti yang sudah dikalibrasi	Form laporan kerusakan	

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	13 Okt 2004	QSA
01	1. Mengganti judul prosedur dari Repair dan scrap alat ukur menjadi Penanganan kerusakan atau kehilangan alat ukur 2. Revisi flowchart dengan menambahkan penanganan saat terjadi kehilangan alat ukur 3. Menambah approval untuk Dept. MTC, Eng dan Produksi	10 Jul 2013	QC MSA
02	1. Revisi untuk flowchart dan penjelasannya yaitu dibagi menjadi 3: - Kerusakan alat ukur (selain straight meter) - Kerusakan alat ukur (straight meter) - Kehilangan alat ukur	1 Nov 2024	QC MSA
03	Revisi Approval	27 Okt 2025	QSA