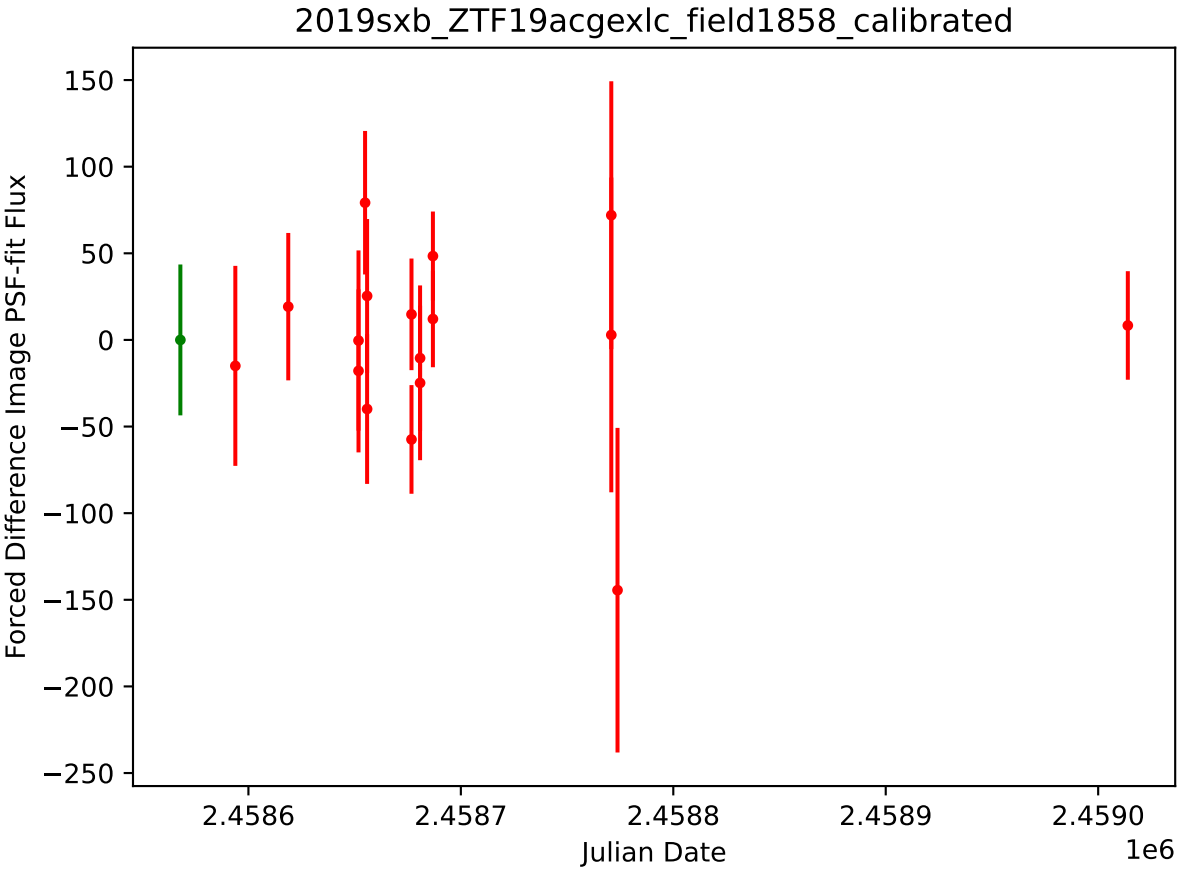
2019sxb_ZTF19acgexlc_field1858_calibrated
Forced Difference Image PSF-fit Flux
150
100
50
0
−50
−100
−150
−200
−250
2.4586
2.4587
2.4588
2.4589
2.4590
1e6
Julian Date