

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий

Работа допущена к защите
директор ВШИСиСТ
_____ В.М. Ицыксон
« _____ » _____ 2022 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА КАЛИБРАТОРА
СУБ-НАНОСЕКУНДНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

по направлению 03.09.01 «Информатика и вычислительная техника»
по образовательной программе
03.09.01_01 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»

Выполнил

студент гр. 3530101/80101 <подпись>

Д.В. Пешков

Руководитель

к.т.н.,

доцент,

<подпись>

А.А. Лавров

Консультант

ассистент

<подпись>

А.А. Антонов

Консультант

по нормоконтролю

<подпись>

А.Г. Новопашенный

Санкт-Петербург
2022

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО**

Институт компьютерных наук и технологий

УТВЕРЖДАЮ

директор ВШИСиСТ

_____ В.М. Ицыксон

« _____ » _____ 2022г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту Пешкову Даниилу Валерьевичу гр. 3530101/80101

1. Тема работы: Разработка управляющего устройства калибратора суб-наносекундной синхронизации.
2. Срок сдачи студентом законченной работы¹: дд.мм.202X.
3. Исходные данные по работе²: статистические данные с сайта [gosstat], а также из репозитория [uci]; основным источником литературы является монография [Book] и статья [Article].
4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):
 - 4.1. Обзор литературы по теме ВКР.
 - 4.2. Исследование программных продуктов.
 - 4.3. Разработка метода/алгоритма/программы.
 - 4.4. Апробация разработанного метода/алгоритма/программы.
5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей):
 - 5.1. Схема работы метода/алгоритма.
 - 5.2. Архитектура разработанной программы/библиотеки.
6. Консультанты по работе³:
 - 6.1. Ассистент, А.А. Антонов.

¹Определяется руководителем ОП, но не позднее последнего числа преддипломной практики и/или не позднее, чем за 20 дней до защиты в силу п. 6.1. «Порядка обеспечения самостоятельности выполнения письменных работ и проверки письменных работ на объем заимствований».

²Текст, который подчеркнут и/или выделен в отдельные элементы нумерационного списка, приведён в качестве примера.

³Подпись консультанта по нормоконтролю пока не требуется. Назначается всем по умолчанию.

6.2. Должность, степень, А.Г. Новопашенный (нормоконтроль).

7. Дата выдачи задания⁴: дд.мм.202Х.

Руководитель ВКР _____ А.А. Лавров

Консультант⁵ _____ А.А. Антонов

Задание принял к исполнению дд.мм.202Х

Студент _____ Д.В. Пешков

⁴Не позднее 3 месяцев до защиты (утверждение тем ВКР по университету) или первого числа преддипломной практики или по решению руководителя ОП или подразделения (открытый вопрос).

⁵В случае, если есть консультант, отличный от консультанта по нормоконтролю.

РЕФЕРАТ

На 31 с., 23 рисунка, 0 таблиц, 1 приложение

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТИЛЕВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА, УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ, PHP, MYSQL, АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ.⁶

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка управляющего устройства калибратора суб-наносекундной синхронизации»⁷.

В данной работе изложена сущность подхода к созданию динамического информационного портала на основе использования открытых технологий Apache, MySQL и PHP. Даны общие понятия и классификация IT-систем такого класса. Проведен анализ систем-прототипов. Изучена технология создания указанного класса информационных систем. Разработана конкретная программная реализация динамического информационного портала на примере портала выбранной тематики...⁸

В данной работе изложена сущность подхода к созданию динамического информационного портала на основе использования открытых технологий Apache, MySQL и PHP. Даны общие понятия и классификация IT-систем такого класса. Проведен анализ систем-прототипов. Изучена технология создания указанного класса информационных систем. Разработана конкретная программная реализация динамического информационного портала на примере портала выбранной тематики...

ABSTRACT

31 pages, 23 figures, 0 tables, 1 appendices

KEYWORDS: STYLE REGISTRATION, CONTENT MANAGEMENT, PHP, MYSQL, SYSTEM ARCHITECTURE.

⁶Всего **слов**: от 3 до 15. Всего **слов и словосочетаний**: от 3 до 5. Оформляются в именительном падеже множественного числа (или в единственном числе, если нет другой формы), оформленных по правилам русского языка. *Внимание! Размещение сноски после точки является примером как запрещено оформлять сноски.*

⁷Реферат **должен содержать**: предмет, тему, цель ВКР; метод или методологию проведения ВКР; результаты ВКР: область применения результатов ВКР; выводы.

⁸ОТ 1000 ДО 1500 печатных знаков (ГОСТ Р 7.0.99-2018 СИБИД) на русский или английский текст. Текст реферата повторён дважды на русском и английском языке для демонстрации подхода к нумерации страниц.

The subject of the graduate qualification work is «Title of the thesis».

In the given work the essence of the approach to creation of a dynamic information portal on the basis of use of open technologies Apache, MySQL and PHP is stated. The general concepts and classification of IT-systems of such class are given. The analysis of systems-prototypes is lead. The technology of creation of the specified class of information systems is investigated. Concrete program realization of a dynamic information portal on an example of a portal of the chosen subjects is developed...

In the given work the essence of the approach to creation of a dynamic information portal on the basis of use of open technologies Apache, MySQL and PHP is stated. The general concepts and classification of IT-systems of such class are given. The analysis of systems-prototypes is lead. The technology of creation of the specified class of information systems is investigated. Concrete program realization of a dynamic information portal on an example of a portal of the chosen subjects is developed...

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
Глава 1. Анализ предметной области	9
1.1. White Rabbit	9
1.2. Калибровка	9
1.3. Актуальность.....	12
1.4. Стробоскопический осциллограф	12
Глава 2. Аппаратная платформа и алгоритм проведения измерений.....	14
2.1. Измерительный канал	15
2.2. Алгоритм проведения измерений.....	16
2.3. Пороговое напряжение сравнения.....	17
2.4. Линия задержки	17
2.5. Компаратор	18
Глава 3. Разработка аппаратного описания управляющего устройства	20
3.1. Описание верхнего уровня	20
3.2. Измерительный модуль	21
3.2.1. Модуль <code>stb_gen</code>	22
3.2.2. Модуль <code>ch_measure_ctl</code>	27
3.2.3. Программный интерфейс.....	29
Список использованных источников.....	30
Приложение 1. Исходные коды измерительного модуля	32

ВВЕДЕНИЕ

Для надёжного функционирования распределённых систем потоковой обработки данных, работающих в режиме реального времени, на исполняемые в них операции накладываются строгие временные ограничения. Многочисленные узлы таких систем могут находиться друг от друга на значительных расстояниях, что приводит к длительным (и не всегда одинаковым) задержкам при передаче сигналов между ними. Возникающие задержки приводят к рассинхронизации работы устройств систем, что влечёт за собой возникновение потенциально некорректных результатов выполнения операций.

С целью согласования всех устройств и обеспечения общего представления времени во всей сети применяются системы синхронизации часов. Такие системы гарантируют, что часы всех устройств сети отсчитывают время с одинаковой скоростью (выдают одинаковые показания в каждый момент времени).

Для передачи информации при синхронизации могут использоваться различные протоколы. Наибольшее распространение получили следующие два: NTP и RTP (Precision Time Protocol). Протокол NTP способен обеспечивать точность синхронизации времени до одной миллисекунды, а протокол RTP – до десяти.

Протоколы NTP и RTP не подходят для случая, когда необходима синхронизация с субнаносекундной точностью. Например, такая высокая точность требуется в распределённых системах, применяемых в экспериментах по физике высоких энергий. Там они используются для потоковой обработки информации, поступающей с детекторов и ускорителей частиц.

Системы субнаносекундной синхронизации применяются в Большом Адронном Коллайдере, расположенном в ЦЕРН, в Швейцарии. Они также планируются к применению в строящемся комплексе «NICA» Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Другим приложением субнаносекундной синхронизации являются системы радиочастотного позиционирования, использующие технологию сверхширокополосной связи (UWB) и алгоритм позиционирования TDoA (Time Difference of Arrival).

Цель работы: разработка управляющего устройства для устройства, выполняющего калибровку систем суб-наносекундной синхронизации.

Решаемые в данной работе задачи: портирование и интеграция существующих открытых модулей в систему на кристалле, реализация модулей для проведения измерений по принципу стробоскопического осциллографа, написание

драйверов для используемой периферии, написания управляющей программы для процессорного ядра, реализация протокола для управления проведением измерений с персонального компьютера, тестирование и отладка, калибровка полученного устройства.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. White Rabbit

White Rabbit – система синхронизации часов. Разработана при сотрудничестве множества институтов и компаний. Изначально проект был начат для улучшения текущей системы синхронизации в Церне. Предполагалось использование для физических экспериментов, однако в процессе было создано обобщенное решение, которое нашло своё применение в различных сферах.

Характеристики:

- Суб-наносекундная точность
- Большое количество синхронизируемых узлов
- Расстояния в десятки километров
- Канал передачи между двумя узлами — 1 Gbps
- Открытый исходный код

Достоинствами White Rabbit являются полностью открытый исходный код и аппаратура, а также использование существующих стандартов (Ethernet, PTP и т. д.).

1.2. Калибровка

Синхронизация в сети White Rabbit выполняется по протоколу WR PTP — модифицированному протоколу PTP. (IEEE 1588). Однако для достижения суб-наносекундной точности необходима дополнительная калибровка.

Обмен данными между двумя устройствами происходит по одной линии оптоволокну, работающей в полнодуплексном режиме. Для передачи в одну и другую сторону используется свет с разной длиной волны, поэтому возникает асимметричность в задержках распространения сигнала. Из-за этого устройство не может само определить задержки, отправив эхо запрос другому устройству — время распространения сигнала в одну и другую сторону не равны.

Определение коэффициента асимметричности оптоволокну позволит протоколу White Rabbit PTP обеспечить требуемую точность синхронизации устройств сети.

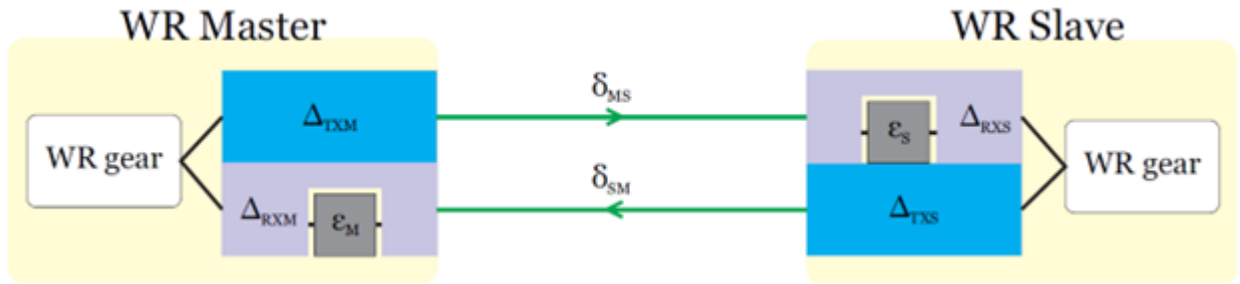


Рис.1.1. Модель соединения между двумя устройствами

На рис.1.1 изображены возникающие задержки, требующие калибровки. Внутри каждого устройства возникают задержки на приёме и отправке ($\Delta_{TXM}, \Delta_{RXM}, \Delta_{TXS}, \Delta_{RXS}, \epsilon_M, \epsilon_S$), которые являются результатом задержек в SFP (Small Form-factor Pluggable) модуле, в электрических цепях и электронных компонентах. Эти задержки калибруются отдельно на каждом устройстве и не являются предметом рассмотрения в данной работе.

Суммарная задержка распространения сигнала от ведущего устройства к ведомому устройству и обратно считается по формуле:

$$delay_{MM} = \Delta_{TXM} + \Delta_{RXS} + \epsilon_S + \Delta_{TXS} + \Delta_{RXM} + \epsilon_M + \delta_{MS} + \delta_{SM} \quad (1.1)$$

В данной работе рассматривается калибровка задержек δ_{MS} и δ_{SM} – задержек распространения сигнала по оптоволокну.

Когда оптоволокну ещё не установлено, измерить задержки и вычислить коэффициент асимметричности можно без особых усилий. Коэффициент асимметричности определяется, как:

$$\alpha = \frac{\delta_{MS} - \delta_{SM}}{\delta_{SM}} \quad (1.2)$$

Измеряется коэффициент при помощи дополнительного короткого оптоволоконного кабеля, с известной задержкой.

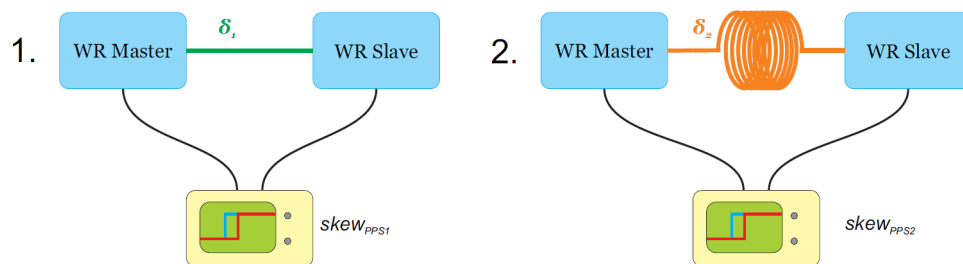


Рис.1.2. Измерение асимметричности про помощи дополнительного оптоволоконного кабеля

Два устройства подключаются калибруемым оптоволоком (δ_2) и дополнительным (δ_1) отдельно, далее два устройства синхронизируются. После этого измеряется разность фаз синхросигналов 1-PPS (Pulse Per Second), генерируемых ведущим и ведомым устройством.

$$skew_{PPS} = t_{PPS_S} - t_{PPS_M} \quad (1.3)$$

По измеренным значениям можно определить коэффициент асимметричности, как:

$$\alpha = \frac{2 (skew_{PPS2} - skew_{PPS1})}{\frac{1}{2}\delta_2 - (skew_{PPS2} - skew_{PPS1})} \quad (1.4)$$

Однако существуют так же уже установленные линии, нуждающиеся в калибровке. В таких случаях описанный выше метод не подходит.

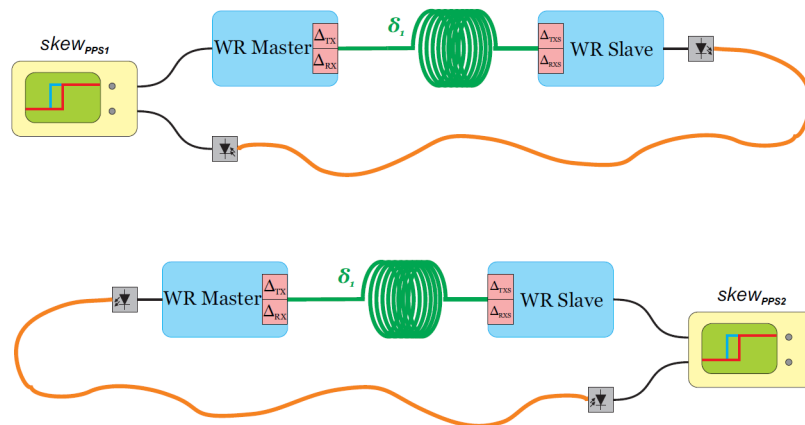


Рис.1.3. Измерение асимметричности про помощи дополнительного оптоволокну

В таких случаях применяется немного изменённый метод с подключением петли от выхода 1-PPS одного устройства к другому (рис.1.3). После синхронизации так же измеряются расхождения фронтов синхросигналов и усредняются.

$$skew_{PPS} = \frac{1}{2} (skew_{PPS1} + skew_{PPS2}) \quad (1.5)$$

Далее это значение может быть использовано для вычисления коэффициента по формуле 1.4.

Разрабатываемое устройство служит для автоматизированного измерения разности фаз и выполнения калибровки.

1.3. Актуальность

Для процесса калибровки предполагается использовать устройство, способное измерять отрезки времени меньше, чем 1 нс, чтобы обеспечить суб-наносекундную точность, т.е. иметь частоту дискретизации 1 GSa. Если применить правило «пятикратного превышения частоты дискретизации», то используемый осциллограф должен иметь частоту дискретизации выше 5 GSa.

Цена осциллографов с такими характеристиками крайне высока. Актуальность данной работы заключается в том, что предлагается разработать относительно бюджетное устройство, работающее по принципу стробоскопического осциллографа.

Сигналы PPS от калибруемых устройств являются периодическими. Это позволяет применить для их обнаружения, захвата и анализа устройство, работающее по принципу стробоскопического осциллографа.

1.4. Стробоскопический осциллограф

Стробоскопические осциллографы предназначены для обнаружения, захвата и анализа периодических сигналов. Принцип работы стробоскопического осциллографа проиллюстрирован на рис.1.4.

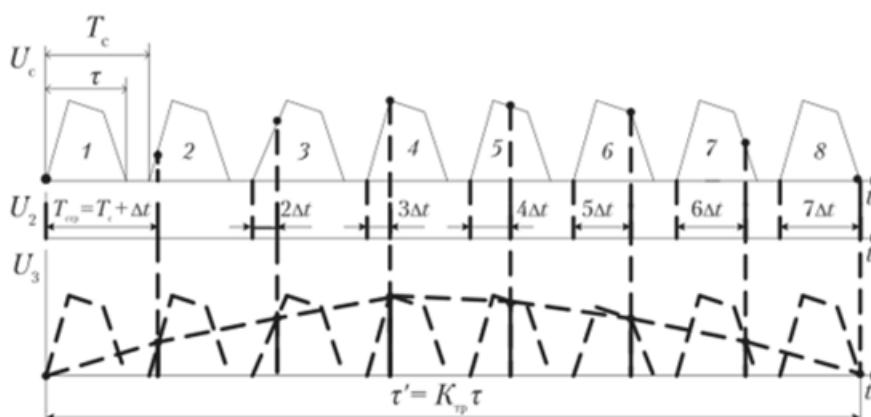


Рис.1.4. Измерение асимметрии про помощи дополнительного оптоволоконна

Условные обозначения:

U_c – исследуемый периодический сигнал

T_c – период исследуемого сигнала

τ – длительность импульса исследуемого сигнала

Δt – шаг считывания исследуемого сигнала

U_2 – стробы осциллографа

U_3 – снятая осциллограмма сигнала

Таким образом, для снятия очередной точки изменяется смещение Δt . Частота дискретизации определяется минимальным смещением, которое может задать осциллограф.

ГЛАВА 2. АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА И АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Управляющее устройство реализовано на базе ПЛИС, так как есть необходимость разрабатывать специфические аппаратные модули.

В качестве аппаратной платформы УУ (управляющее устройство) выступает ПЛИС серии LittleVee китайского производителя Gowin Semiconductor – GW1N-UV9QN88C6/I5.

Данная ПЛИС имеет следующие характеристики:

- количество логических блоков LUT4 – 8640 шт.
- количество триггеров – 6480 шт.
- объём FLASH – 408 Кбит
- количество блоков BSRAM – 26 шт.
- объём блоков SRAM – 468 Кбит
- количество блоков PLL (ФАПЧ) – 2 шт.
- напряжение питания ядра – 1.8–3.3 В
- количество доступных для пользователя выходов I/O – 77
- среди них дифференциальных пар – 19

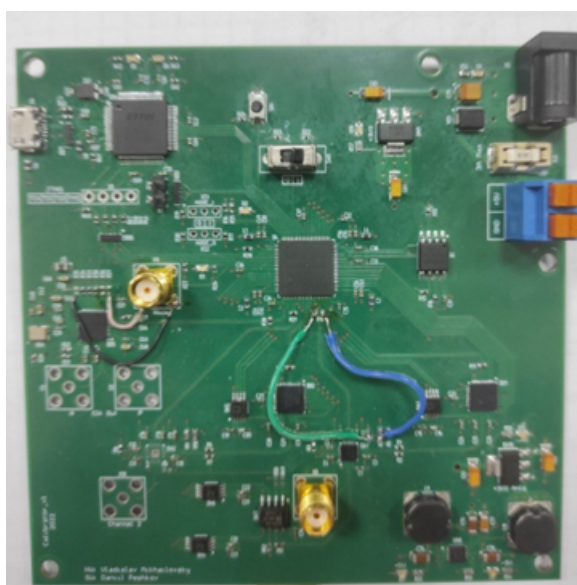


Рис.2.1. Печатная плата устройства

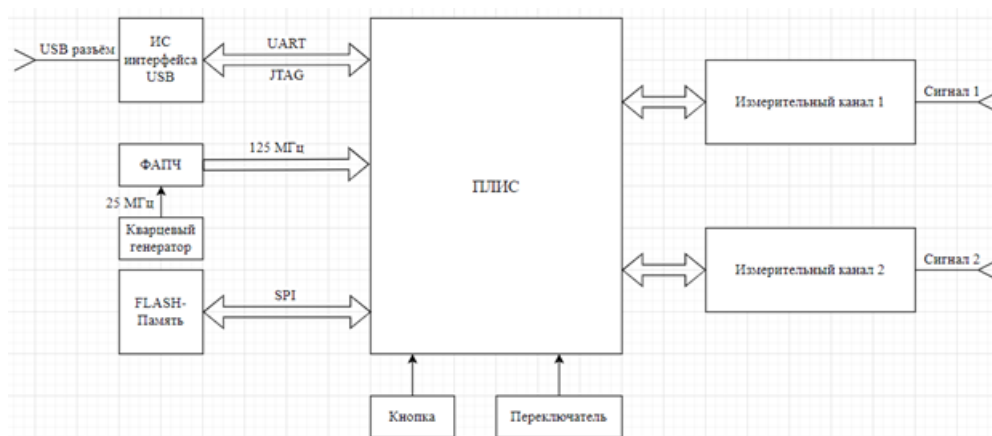


Рис.2.2. Структурная схема устройства

На рис.2.2 изображена структурная схема устройства. К УУ подключаются два измерительных канала, которыми необходимо управлять для проведения измерений. ПЛИС тактируется высокостабильным тактовым сигналом с частотой 125 МГц. Связь с устройством верхнего уровня осуществляется через FTDI чип FT2232H.

Перед разработкой УУ необходимо определить ОУ (объект управления), которым предстоит управлять.

2.1. Измерительный канал

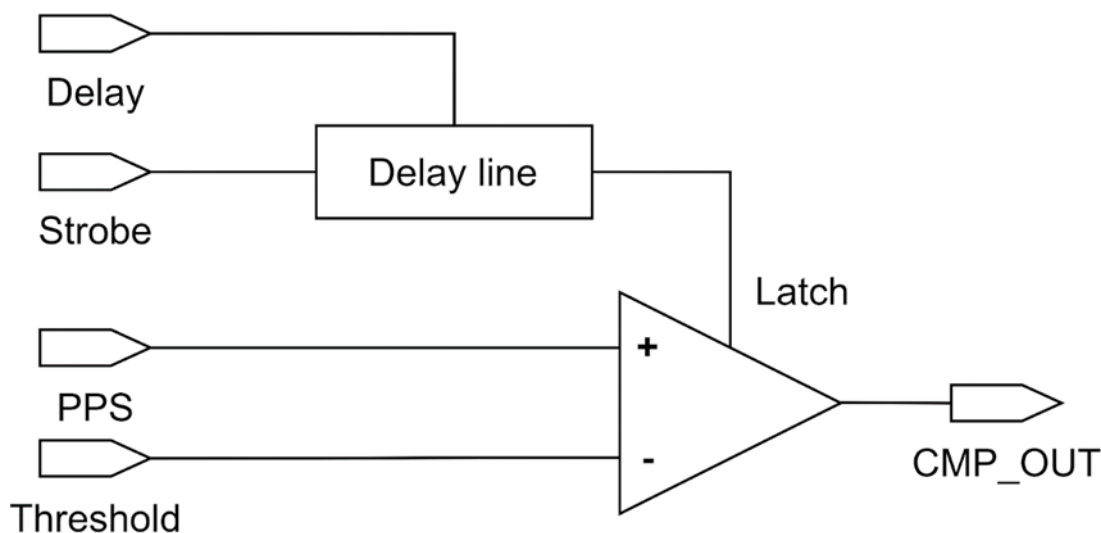


Рис.2.3. Функциональная схема измерительного канала

На рис.2.3 приведена функциональная схема одного из измерительных каналов.

Threshold – пороговое напряжение сравнения на компараторе

Delay – настройка задержки сигнала на линии задержки (Delay line)

Strobe – стробы, выдаваемые УУ и защёлкивающее текущий результат сравнения компаратора.

PPS – измеряемый сигнал 1-PPS (В общем случае, может быть любой частоты, кратной либо 125 МГц, либо частоте внешнего тактового сигнала, подаваемого с SMA разъёма)

2.2. Алгоритм проведения измерений

Перед началом проведения измерения необходимо определить частоты измеряемого сигнала и найти его фронт.

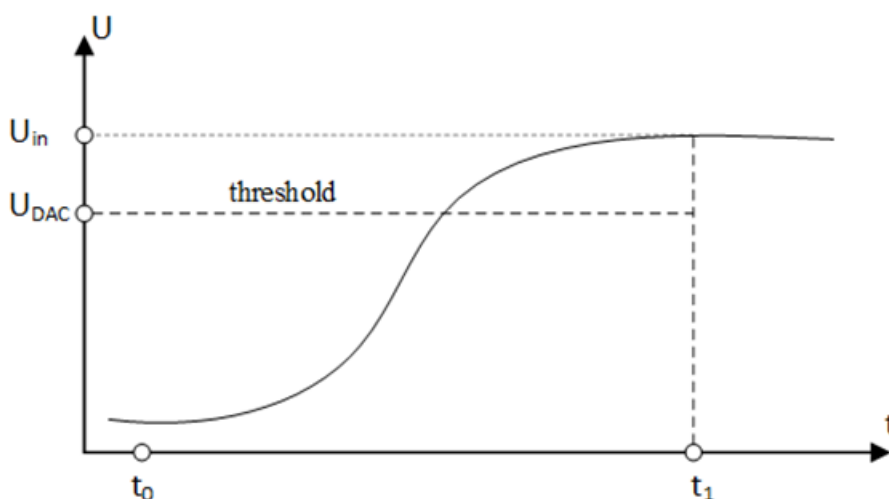


Рис.2.4. Измерение сигнала

Далее необходимо начать генерировать стробы с частотой измеряемого сигнала. Стробы блокируют текущий выход компаратора, и на его выходе остаётся результат сравнения в момент прихода стробы. При помощи изменения задержки можно сдвигать измеряемую точку по оси ОХ. Для поиска значения напряжения в измеряемой точке необходимо изменять пороговое напряжение сравнения на компараторе.

На рис.2.4 приведён пример измерения. t_0 – точка от которой измеряется сигнал (момент прихода стробы), t_1 – измеряемая точка (момент прихода задержанной стробы на компаратор). Временной отрезок $[t_0, t_1]$ задаётся линией задержки. Если в момент защёлкивания на выходе компаратора логическая единица, значит измеряемое напряжение выше, чем пороговое. Перед приходом следующей стробы пороговое напряжение повышается. Так продолжается до тех

пор, пока на выходе компаратора не будет логического нуля. В таком случае мы считаем, что измеряемая точка имеет значения напряжение равное пороговому. Задержка увеличивается, и измеряется следующая точка. Таким образом снимается осциллограмма входного сигнала.

2.3. Пороговое напряжение сравнения

Для задания порогового напряжения используется DAC (Digital to analog converter) AD5662 от Analog Devices. AD5662 – 16-битный DAC с гарантированной точностью 12 бит.

С опорным напряжением 3.3 В, шаг изменения напряжения – $\frac{3.3}{2^{16}} \approx 50$ мкВ. Для задания напряжения используется интерфейс SPI (рис.2.5).

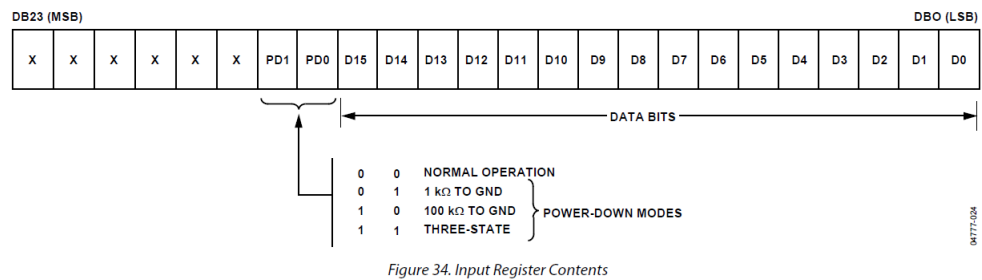


Figure 34. Input Register Contents

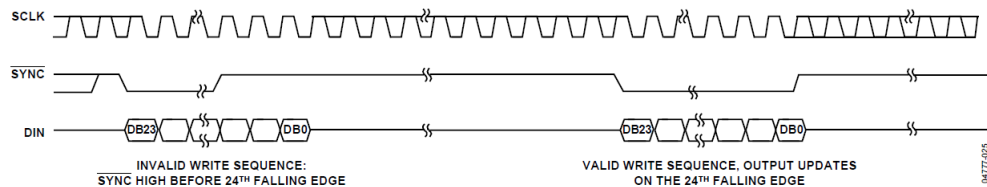


Рис.2.5. Интерфейс взаимодействия с AD5662

При напряжении питания 3.3 В максимальная частота сигнала SCLK – 20 МГц. Максимальное время установки выходного напряжения – 10 мкс (обычно 8 мкс).

2.4. Линия задержки

Для сдвига задержки строга используется микросхема SY100EP196V от Microchip. Задержка задаётся 10-битным цифровым кодом с шагом ≈ 10 пс (рис.2.6). Так же есть аналоговый вход FTUNE, которым можно точнее подстраивать задержку (рис.2.7) (на данный момент не используется).

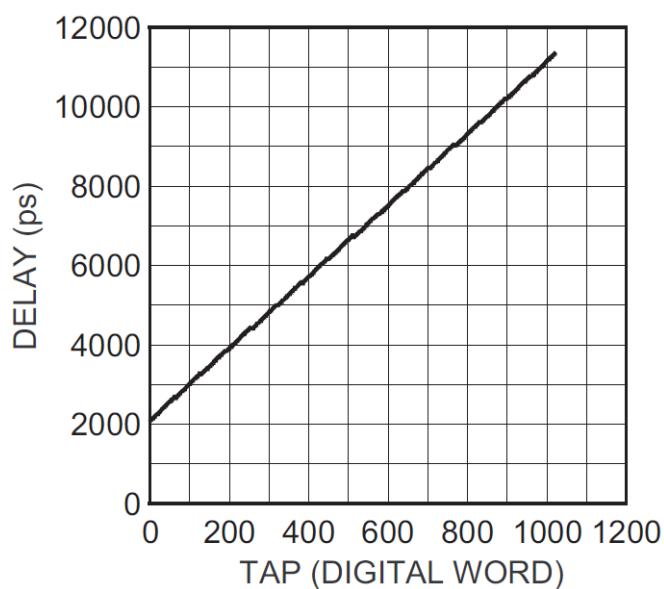


Рис.2.6. Задержка, задаваемая цифровым входом

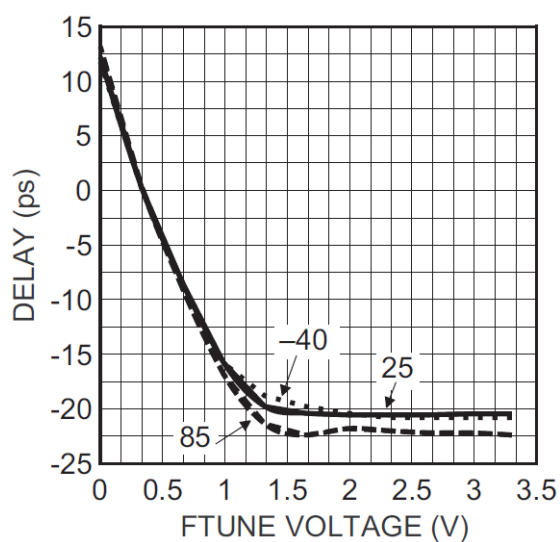


Рис.2.7. Подстройка задержки через аналоговый вход FTUNE

2.5. Компаратор

Для сравнения используется компаратор ADCMP582 от Analog Devices. Основным параметром, который необходимо учесть является t_{PL} (рис.2.8).

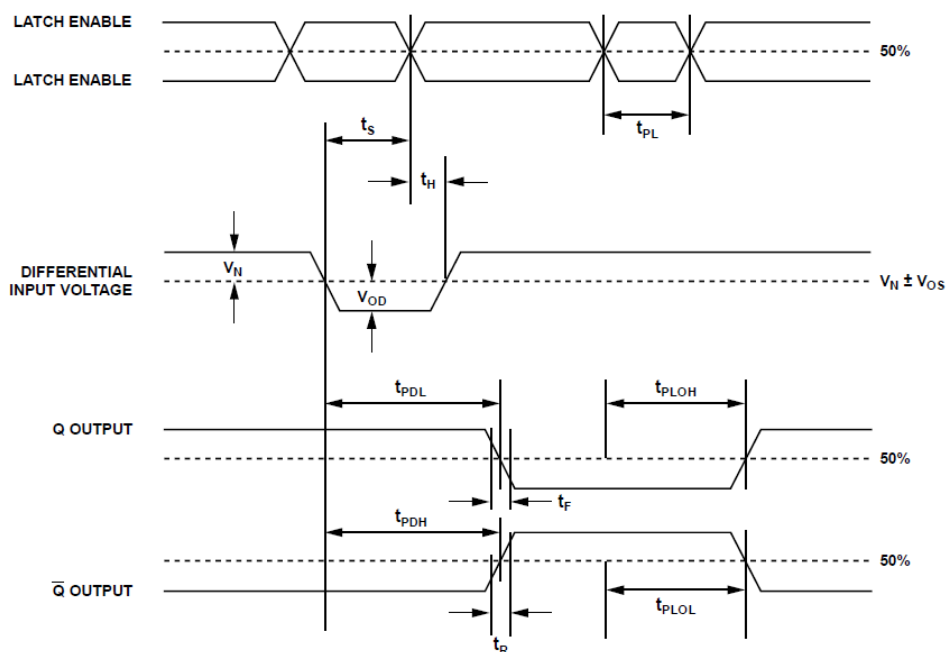


Рис.2.8. Временная диаграмма ADCMP582

t_{PL} – минимальное время, в течение которого сигнал защёлки (Latch Enable) должен быть высоким, чтобы получить результат сравнения попал на выход компаратора.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО ОПИСАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Все исходные коды аппаратных описаний находятся в директории */rtl/*.

3.1. Описание верхнего уровня

Описание верхнего уровня находится в файле */rtl/calsoc_top.sv*.

Управляющее устройство реализовано в виде СнК (Система на кристалле) (рис.3.1) на базе открытого процессорного ядра *PicoRV32*, основанного на открытой архитектуре RISC-V.

Все периферийные модули подключаются к ядру через шину *Wishbone*. Арбитраж на шине выполняет открытый модуль *wbxbbar*.

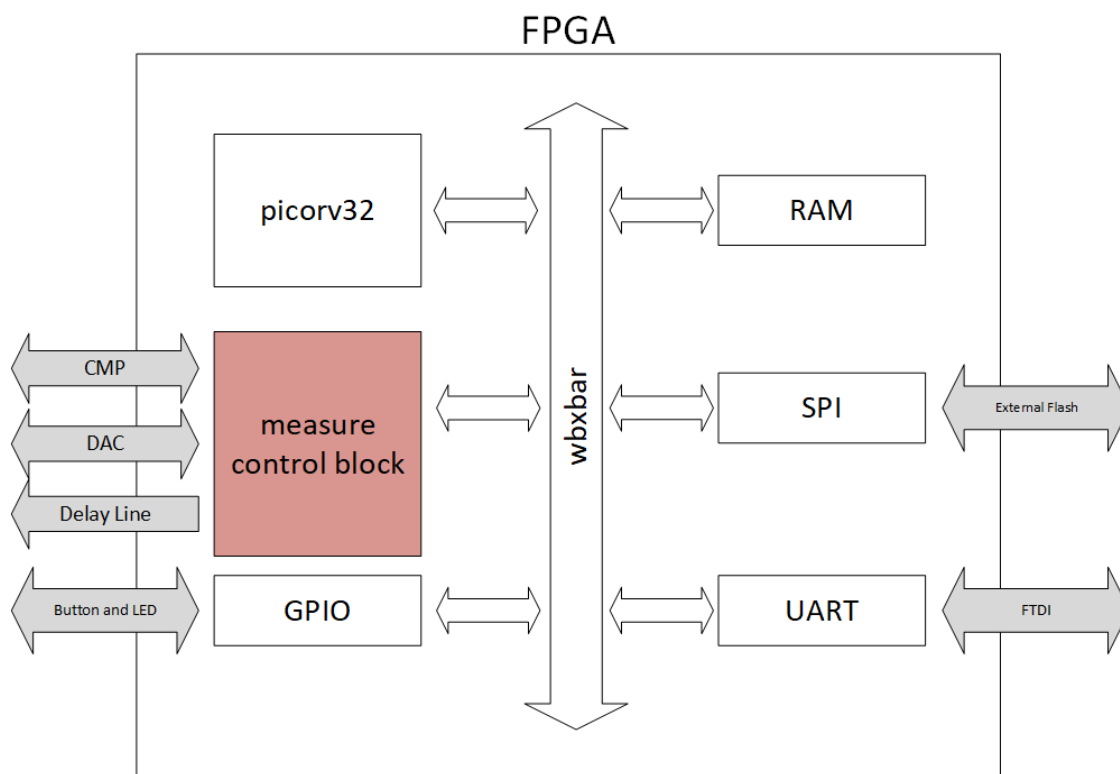


Рис.3.1. Структурная схема СнК

Все периферийные устройства разделяют между собой общее адресное пространство.

0x00000000 – 0x00FFFFFF – RAM

0x01000000 – 0x01FFFFFF – ROM загрузчика

0x02000000 – 0x02FFFFFF – GPIO

0x03000000 – 0x03FFFFFF – UART1

0x04000000 – 0x04FFFFFF – память программы

0x05000000 – 0x05FFFFFF – измерительный модуль

3.2. Измерительный модуль

Измерительный модуль выдаёт все необходимые управляющие сигналы для проведения измерений и логически разделён на несколько компонентов (рис.3.2):

- *stb_gen* – модуль, измеряющий частоту сигнала и генерирующий стробы
- *ch_measure_ctl* – модуль, непосредственно управляющий измерением одного канала
- *spi_master* – модуль, реализующий взаимодействие с AD5662
- *sc_fifo* – FIFO, накапливающее измеренные значения

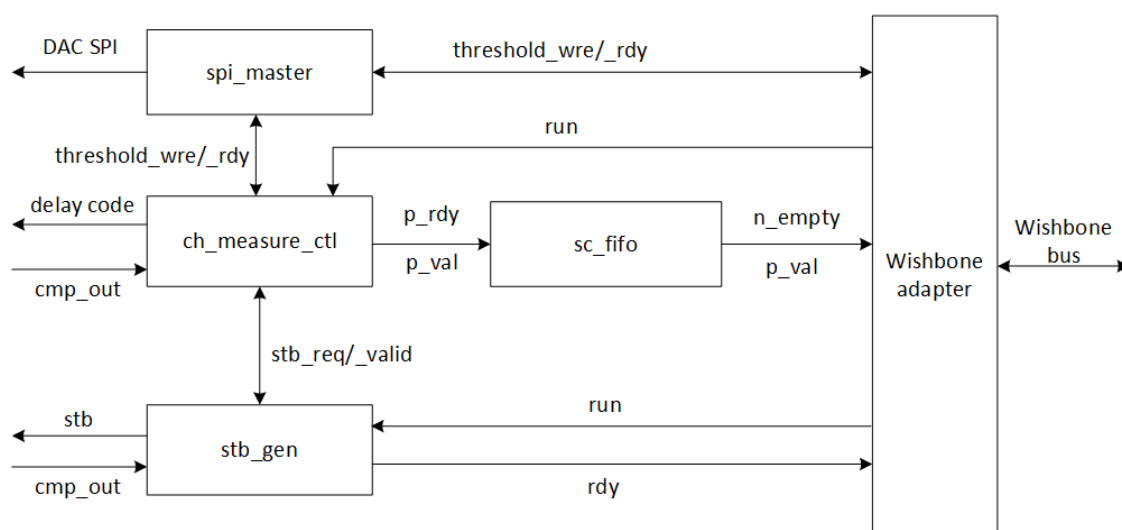


Рис.3.2. Структурная схема измерительного модуля (для одного канала)

Все описанные ранее модули подключены в модуле верхнего уровня *measure_unit*. В нём же реализована вся логика управления проведением измерений через шину Wishbone.

Далее будет отдельно рассмотрен каждый модуль.

3.2.1. Модуль *stb_gen*

Для определения частоты измеряемого сигнала необходимо измерить время между двумя фронтами. Для измерения используется 32-разрядный счётчик, один отсчёт которого равняется 8 нс (125 МГц).

Реализация «в лоб» не может работать стабильно на целевой ПЛИС из-за задержек на цепочке переносов в 32-разрядном сумматоре. Для корректной работы на такой частоте необходимо конвейеризировать счётчик (рис.3.3).

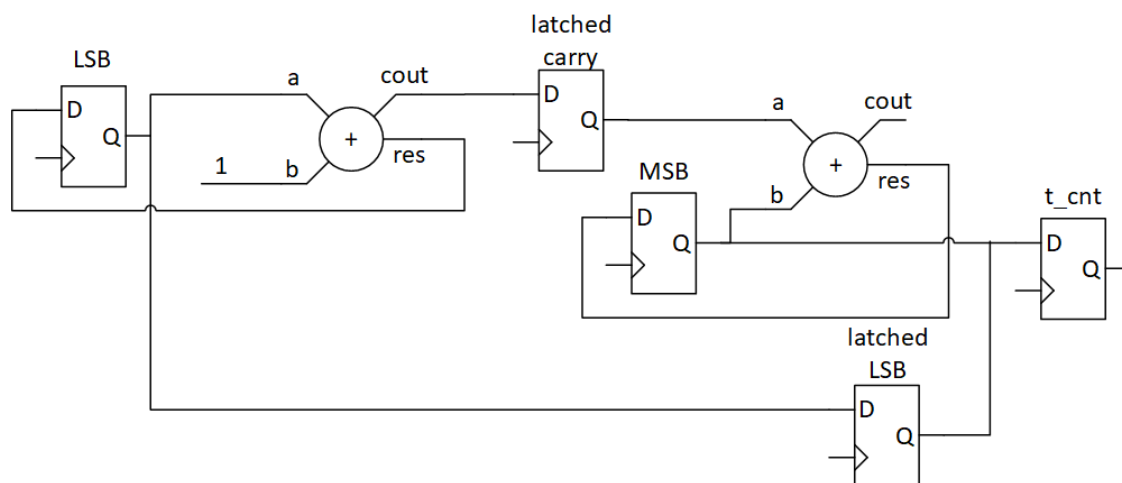


Рис.3.3. Конвейерный 32-х разрядный счётчик

К младшим байтам (регистр *LSB*) каждый такт прибавляется 1, текущее значение младших байт защёлкивается в регистре *latched LSB*. При переполнении, перенос защёлкивается в регистре *latched carry*. К старшим байтам (регистр *MSB*) прибавляется сохранённый перенос из-за младших байт. Выход счётчика – комбинация значений регистров *MSB* и *latched LSB*.

Листинг 3.1. Реализация на языке System Verilog

```

2 // pipelined counter
3
4 logic [T_CNT_WIDTH/2-1 : 0] high_bytes = 0;
5 logic [T_CNT_WIDTH/2-1 : 0] latched_low_bytes = 0;
6 logic [T_CNT_WIDTH/2-1 : 0] low_bytes = 0;
7 logic [T_CNT_WIDTH/2-1 : 0] low_bytes_plus_1;
8 logic carry;
9
10 assign {carry, low_bytes_plus_1} = low_bytes + 1;
11
12 //incrementing low bytes

```

```

13 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i)
14     if (~arst_i) low_bytes = 0;
15     else low_bytes <= low_bytes_plus_1;
16
17 //latching low bytes for 1 cycle
18 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i)
19     if (~arst_i) latched_low_bytes = 0;
20     else latched_low_bytes <= low_bytes;
21
22 logic latched_carry = 0;
23
24 //latching carry
25 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i)
26     if (~arst_i) latched_carry = 0;
27     else latched_carry <= carry;
28
29 //adding latched carry to high bytes
30 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i)
31     if (~arst_i) high_bytes = 0;
32     else high_bytes <= high_bytes + latched_carry;
33
34 //seting t_cnt
35 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i)
36     if (~arst_i) t_cnt = 0;
37     else t_cnt <= {high_bytes, latched_low_bytes};

```

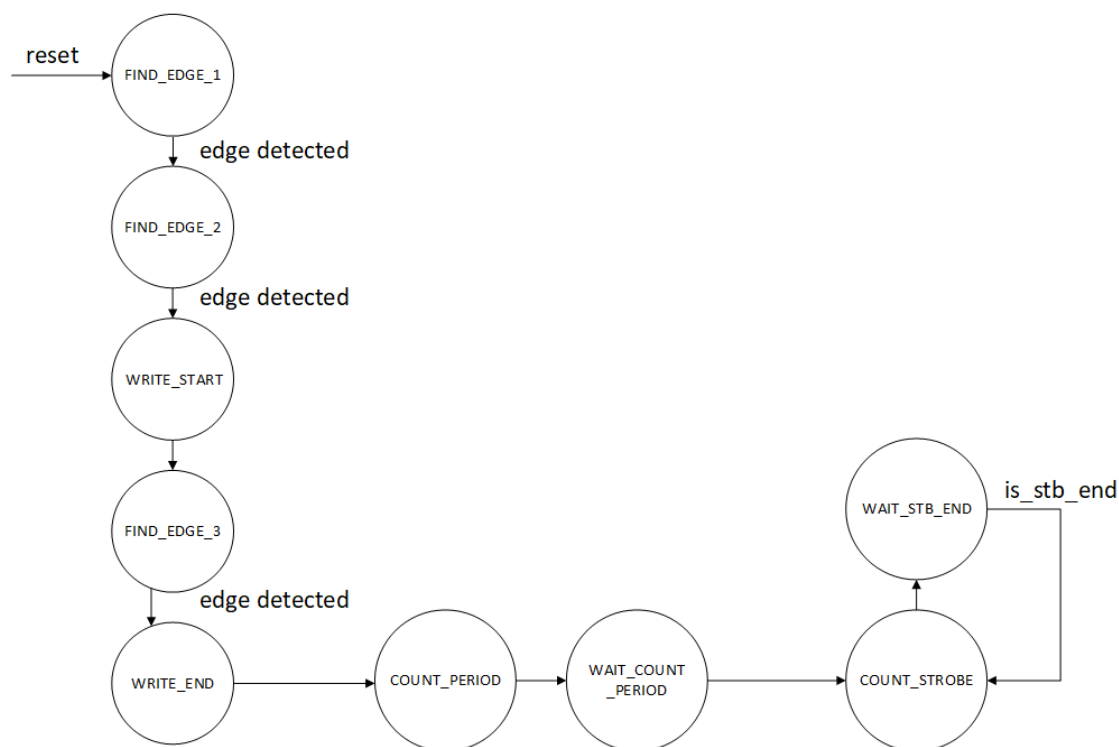


Рис.3.4. Конечный автомат модуля *stb_gen*

На рис.3.4 представлен конечный автомат модуля *stb_gen*. Вся логика максимально упрощена, так как, если на одной регистровой передаче будет много комбинаторной логики, при синтезе под целевую ПЛИС не получится выдержать требуемые t_{setup} и t_{hold} .

FIND_EDGE_1 – состояние после сброса, ожидание первого фронта на входе *sig_i*

FIND_EDGE_2 – ожидание второго фронта на входе *sig_i*

WRITE_START – запись текущего значения t_{cnt} в t_{start}

FIND_EDGE_3 – ожидание третьего фронта на входе *sig_i*

WRITE_END – запись текущего значения t_{cnt} в t_{end}

COUNT_PERIOD – вычисление периода сигнала ($t_{end} - t_{start}$)

WAIT_COUNT_PERIOD – задержка на 1 такт

COUNT_STROBE – начало расчёта времени начала и конца отрицательного импульса на выходе стробы

WAIT_STB_END – ожидание конца стробы и переход к расчёту новой

Таким образом, модуль определяет частоту входного сигнала и начинает бесконечно выдавать стробы.

Помимо 32-х разрядного счётчика, конвейеризация была необходима для всех операций с 32-х битными числами. В модуле *two_cycle_32_adder* реализован двухтактный сумматор, однако использованный подход идентичен тому, что используется в счётчике.

Отдельного упоминания стоит оптимизация операции проверки на равенство двух чисел. Для этого необходимо сравнить попарно все биты чисел, что выполняется параллельно и не должно увеличивать максимальный путь, однако при синтезе получалась цепочка с последовательным сравнением всех разрядов (рис.3.5).

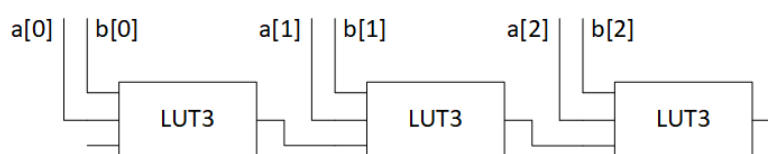


Рис.3.5. Реализация сравнения при синтезе

Для исправления этого пришлось явно заменить операцию сравнения на исключающее ИЛИ и свёртку по ИЛИ-НЕ.

Листинг 3.2. Реализация сравнения

```

2 | always_ff @(posedge clk_i) is_zero_hold_start_lo <= ~(t_cnt
   | [15:0] ^ latched_zero_hold_res[15:0]); //t_cnt ==
   | latched_zero_hold_res;
3 | always_ff @(posedge clk_i) is_zero_hold_start_hi <= ~(
   | t_cnt[31:16] ^ latched_zero_hold_res[31:16]); //t_cnt ==
   | latched_zero_hold_res;
4 | always_ff @(posedge clk_i) is_zero_hold_start <=
   | is_zero_hold_start_lo & is_zero_hold_start_hi;

```

При работе модуль не выдаёт стробы, а держит компаратор в защёлкнутом состоянии. Для запроса стробы используется пара сигналов *stb_req_i* и *stb_valid_o*. При выдаче стробы, с компаратора снимается защёлка на короткое время, после чего устанавливается обратно.

Для тестирования модуля были написаны тестбенчи *tb_stb_gen.sv* и *tb2_stb_gen.sv*. На рис.3.6 и рис.3.7 представлены результаты моделирования.

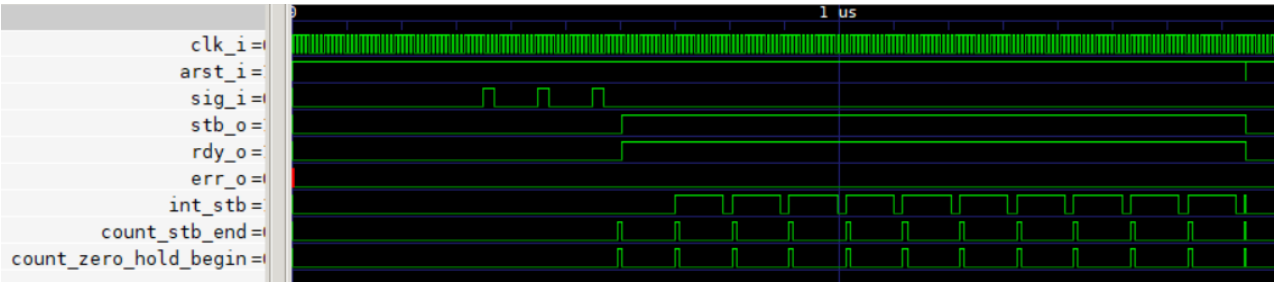


Рис.3.6. Пример определения частоты входного сигнала

```
iverilog -o test_stb_gen.vvp -g2005-sv tb_stb_gen.sv
./stb_gen.sv:108: vvp.tgt sorry: Case unique/unique0 qualities are ignored.
vvp -n test_stb_gen.vvp
VCD info: dumpfile dump.vcd opened for output.
measured signal T=      100 ns
generated strobe T=     104 ns
err=      4 ns      clk T=   8 ns
counted period=      104

measured signal T=     20000 ns
generated strobe T=     20000 ns
err=      0 ns      clk T=   8 ns
counted period=     20000

measured signal T=     200000 ns
generated strobe T=     200000 ns
err=      0 ns      clk T=   8 ns
counted period=     200000

measured signal T=     1333333 ns
generated strobe T=     1333336 ns
err=      3 ns      clk T=   8 ns
counted period=     1333336

OK!
tb_stb_gen.sv:69: $finish called at 20196276 (1ns)
```

Рис.3.7. Вывод в консоль при симуляции

Видно, что сигналы с периодом, кратным 8 нс измеряются корректно, при измерении других – ошибка меньше 8 нс.

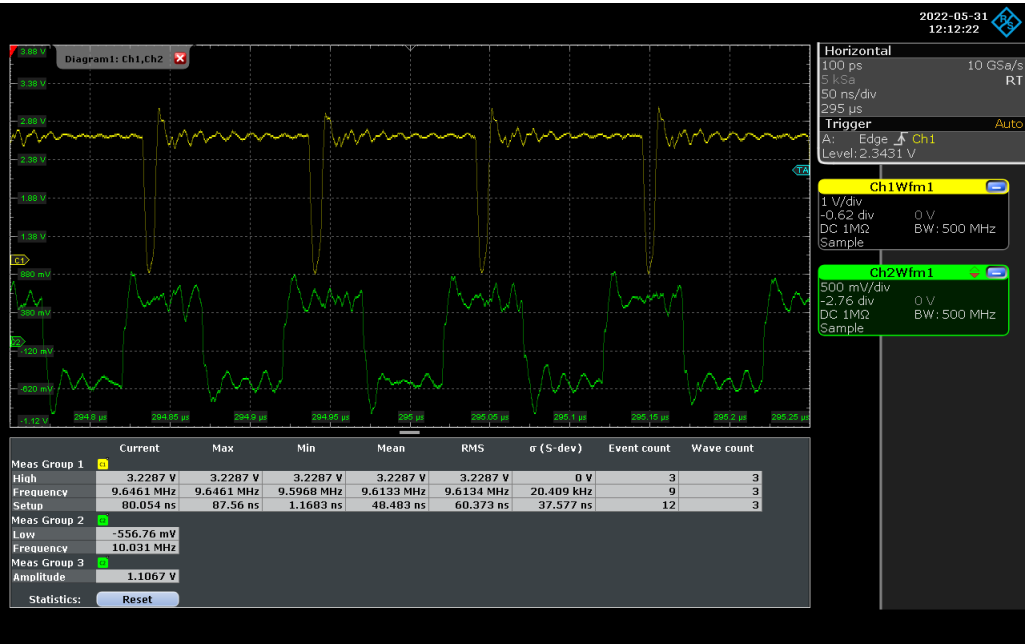


Рис.3.8. Генерация строб для 10 МГц

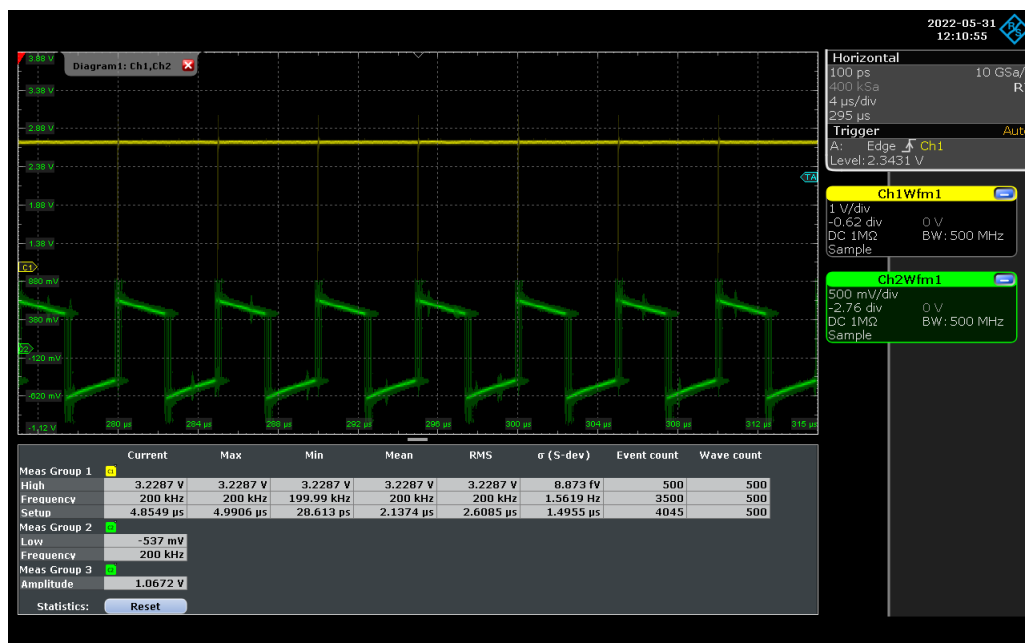


Рис.3.9. Генерация строб для 200 кГц

На рис.3.8 и рис.3.9 приведены осциллограммы генерации строб для 10 МГц и 200 кГц. Видно, что точно определить не кратную частоту невозможно – при генерации получается стробы с частотой 9.6 МГц, а не 10 МГц.

3.2.2. Модуль ch_measure_ctl

Данный модуль управляет измерением одного из каналов – выставляет необходимое пороговое напряжение и задержку, а затем выставляет запрос на стробу. После прохода стробы, в зависимости от текущего и предыдущего выхода компаратора, принимается решение о следующем значении задержки и порогового напряжения.

Для ускорения снятия осциллограммы применяется предсказание направления изменения сигнала. Для этого, после нахождения очередной точки, изменяется только задержка, после чего на основании выхода компаратора принимается решение – измеряемый сигнал нарастает или уменьшается.

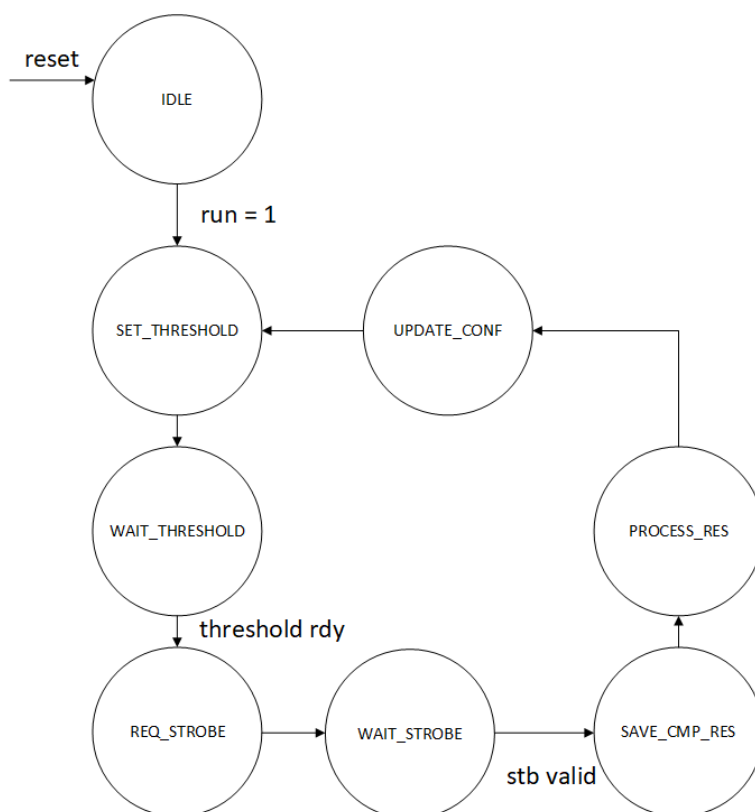


Рис.3.10. Конечный автомат модуля *ch_measure_ctl*

На рис.3.10 представлен конечный автомат описываемого модуля.

IDLE – состояние покоя

SET_THRESHOLD – отправление запроса на установку порогового напряжения (*threshold_wre_o = 1*)

WAIT_THRESHOLD – ожидание установки порогового напряжения (*threshold_rdy_i == 1*)

REQ_STROBE – установка запроса на стробу (*stb_req_o = 1*)

WAIT_STROBE – ожидание прохода стробы (*stb_valid_i == 1*)

SAVE_CMP_RES – обновление текущего и предыдущего выхода компаратора

PROCESS_RES – принятие решения о статусе поиска точки (определение направления поиска или поиск точки) и о выборе направления поиска

UPDATE_CONF – обновление регистров с текущей задержкой и пороговым напряжением на основании принятого ранее решения

В состоянии PROCESS_RES, в зависимости от выхода компаратора переключаются два других конечных автомата, отвечающих за статус поиска точки и направления поиска.

На рис.3.11 приведён пример снятия осциллограммы сигнала.

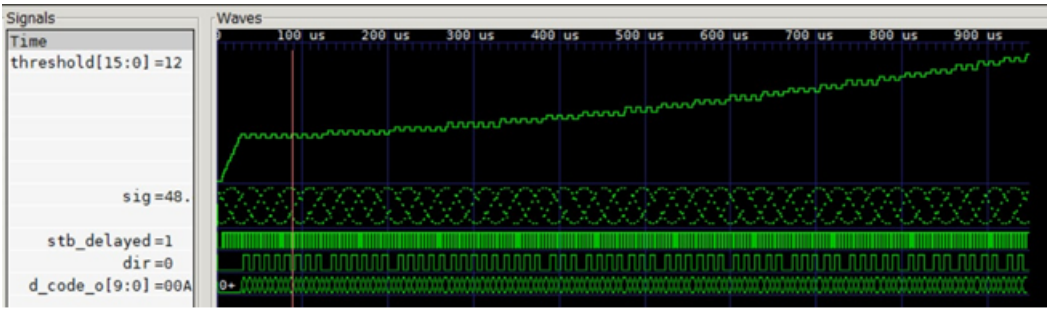


Рис.3.11. Пример снятия осциллограммы с угадыванием направления изменения сигнала

3.2.3. Программный интерфейс

Управление измерительным модулем осуществляется через memory-mapped регистры.

Register 3.1: STB_GEN_CTL (0x1)

			clk_sel mux run				
31				3	2	1	0
reserved				1/0	1/0	1/0	(w)

			clk_sel mux rdy				
31				3	2	1	0
reserved				1/0	1/0	1/0	(r)

Register 3.2: STB_GEN_PERIOD (0x3)

		period	
31			0
read only			(w)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Пешков Д.В., Михайловский В.С. Калибрующее устройство для средств высокоточной синхронизации распределённых систем потоковой обработки данных // Экономика и Индустрия 5.0 в условиях новой реальности (ИНПРОМ-2022): сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с зарубежным участием 28-30 апреля 2022. - СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2022. - С. 680-684.
2. AD5662BRMZ Datasheet [Электронный ресурс] // Analog Devices URL: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad5662.pdf> (дата обращения: 16.06.2022).
3. ADCMP582BCPZ Datasheet [Электронный ресурс] // Analog Devices URL: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adcmp580_581_582.pdf (дата обращения: 16.06.2022).
4. FT2232HL Datasheet [Электронный ресурс] // FTDI Chip URL: https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT2232H.pdf (дата обращения: 16.06.2022).
5. Grzegorz Daniluk. White Rabbit calibration procedure [Электронный ресурс] // CERN BE-CO-HT URL: https://www.ohwr.org/project/white-rabbit/uploads/76cdbdbadccc9d6c54d5caf246550fbf/WR_Calibration-v1.1-20151109.pdf (дата обращения: 16.06.2022).
6. GW1N series of FPGA Products Data Sheet DS100-2.7.1E [Электронный ресурс] // GOWIN Semiconductor Corp. URL: https://gowinsemi.com/upload/database_doc/1752/document/6296db1b68af5.pdf (дата обращения: 16.06.2022).
7. GowinSynthesis User Guide [Электронный ресурс] // GOWIN Semiconductor Corp. URL: <http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG550E.pdf> (дата обращения: 16.06.2022).
8. Gowin FPGA Primitive User Guide [Электронный ресурс] // GOWIN Semiconductor Corp. URL: https://www.gowinsemi.com/upload/database_doc/39/document/5bfcff2ce0b72.pdf (дата обращения: 16.06.2022).
9. SY100EP196V Datasheet [Электронный ресурс] // Microchip URL: <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/TCG/ProductDocuments/DataSheets/SY100EP196V-3.3V-5V-2.5GHz-Programmable-Delay-Chip-with-Fine-Tune-C.pdf> (дата обращения: 16.06.2022).
10. PicoRV32 - A Size-Optimized RISC-V CPU [Электронный ресурс] // Github URL: <https://github.com/YosysHQ/picorv32> (дата обращения: 16.06.2022).
11. Another Wishbone (or even AXI-lite) Controlled UART [Электронный ресурс] //

Github URL: <https://github.com/ZipCPU/wbuart32> (дата обращения: 16.06.2022).

12. WB2AXIP: Bus interconnects, bridges, and other components [Электронный ресурс] // Github URL: <https://github.com/ZipCPU/wb2axip> (дата обращения: 16.06.2022).

13. OpenCores Free and Open Source gateway IP cores [Электронный ресурс] // OpenCores URL: <https://opencores.org/> (дата обращения: 16.06.2022).

14. WISHBONE System-on-Chip (SoC) Interconnection Architecture for Portable IP Cores [Электронный ресурс] // OpenCores URL: https://cdn.opencores.org/downloads/wbspec_b4.pdf (дата обращения: 16.06.2022).

Приложение 1

Исходные коды измерительного модуля

Листинг П1.1. *stb_gen.sv*

```

2 module stb_gen #(
3     parameter OFFSET = 20,
4     parameter T_CNT_WIDTH = 32
5 ) (
6     input wire clk_i,
7     input wire arst_i,
8
9     input wire sig_i,
10
11     output logic err_o,
12     output logic rdy_o,
13     output logic stb_o,
14     output logic [T_CNT_WIDTH-1:0] stb_period_o,
15
16     input logic stb_req_i,
17     output logic stb_valid_o,
18     output logic debug_stb_o
19 );
20 // localparam T_CNT_WIDTH          = 32;
21 localparam ZERO_HOLD_CYCLES      = 2;
22
23 logic int_stb = 0;
24 assign debug_stb_o = int_stb;
25
26 logic sig_synced;
27
28 //stb req interface
29
30 logic stb_oe; // stb_oe == 1 blocks strobe generation
31
32 assign stb_o = (rdy_o ? int_stb | stb_oe : int_stb);
33
34 assign stb_valid_o = stb_oe & rdy_o;
35
36 logic prev_stb_req;
37
38 always_ff @(posedge clk_i) prev_stb_req <= stb_req_i;
39

```



```

40 logic req_posedge;
41 assign req_posedge = ~prev_stb_req & stb_req_i;
42
43 logic is_zero_hold_start;
44 logic is_stb_end;
45
46 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i) begin
47     if (~arst_i) begin
48         stb_oe = 0;
49     end else begin
50         casex ({req_posedge, is_stb_end})
51             2'bx1: stb_oe <= 1;
52             2'b1x: stb_oe <= 0;
53         endcase
54     end
55 end
56
57 sync_ff #(
58     .WIDTH (1),
59     .STAGES(2)
60 ) sig_i_sync_ff_inst (
61     .clk_i (clk_i),
62     .data_i(sig_i),
63     .data_o(sig_synced)
64 );
65
66 logic prev_sig; //edge detect
67
68 always_ff @(posedge clk_i) begin
69     prev_sig <= sig_synced;
70 end
71
72 logic sig_posedge;
73 assign sig_posedge = sig_synced & ~prev_sig;
74
75 typedef enum logic[8:0] {
76     FIND_EDGE_1      = 9'b000000001,
77     FIND_EDGE_2      = 9'b000000010,
78     WRITE_START      = 9'b000000100,
79     FIND_EDGE_3      = 9'b000001000,
80     WRITE_END        = 9'b000010000,
81     COUNT_PERIOD     = 9'b000100000,
82     WAIT_COUNT_PERIOD = 9'b001000000,
83     COUNT_STROBE     = 9'b010000000,
84     WAIT_STB_END     = 9'b100000000

```

```

85     } stb_gen_state;
86
87     stb_gen_state state = FIND_EDGE_1;
88
89     logic [T_CNT_WIDTH-1 : 0] t_cnt /* synthesis syn_keep=1
        syn_preserve=1 syn_ramstyle="registers" */;
90     logic [T_CNT_WIDTH-1 : 0] t_start;
91     logic [T_CNT_WIDTH-1 : 0] t_end;
92     stb_gen_state next_state;
93
94
95     logic count_zero_hold_begin, zero_hold_begin_valid;
96     logic count_stb_end, stb_end_valid;
97
98     assign count_zero_hold_begin = (state == COUNT_STROBE ? 1 :
        0);
99     assign count_stb_end = (state == COUNT_STROBE ? 1 : 0);
100
101     always_comb begin
102         unique case (state) /* sythesis parallel_case*/
103             FIND_EDGE_1:      if (sig_posedge) next_state =
                FIND_EDGE_2;
104                             else next_state = state;
105             FIND_EDGE_2:      if (sig_posedge) next_state =
                WRITE_START;
106                             else next_state = state;
107             WRITE_START:      next_state = FIND_EDGE_3;
108             FIND_EDGE_3:      if (sig_posedge) next_state =
                WRITE_END;
109                             else next_state = state;
110             WRITE_END:        next_state = COUNT_PERIOD;
111             COUNT_PERIOD:     next_state = WAIT_COUNT_PERIOD;
112             WAIT_COUNT_PERIOD: next_state = COUNT_STROBE;
113             COUNT_STROBE:     next_state = WAIT_STB_END;
114             WAIT_STB_END:     if (is_stb_end) next_state =
                COUNT_STROBE;
115                             else next_state = state;
116             default:          next_state = state;
117         endcase
118     end
119
120     always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i) begin
121         if (~arst_i) begin
122             state = FIND_EDGE_1;
123         end else begin

```

```

124         state <= next_state;
125     end
126 end
127
128 logic [T_CNT_WIDTH-1:0] adder_zero_hold_res;
129 logic [T_CNT_WIDTH-1:0] adder_stb_end_res;
130
131 always_ff @(posedge clk_i) begin
132     stb_period_o <= (state == COUNT_PERIOD ? t_end - t_start :
133                     stb_period_o);
134 end
135
136 localparam MAGIC_CONST = 3;
137
138 logic [T_CNT_WIDTH-1:0] period_minus_zero_hold;
139 always_ff @(posedge clk_i) period_minus_zero_hold <=
140     stb_period_o - (ZERO_HOLD_CYCLES+MAGIC_CONST); //magic
141     constat due to computation pipeline
142
143 two_cycle_32_adder adder_zero_hold_begin (
144     .clk_i   (clk_i),
145     .a_i     (t_cnt),
146     .b_i     (period_minus_zero_hold),
147     .valid_i (count_zero_hold_begin),
148     .valid_o (zero_hold_begin_valid),
149     .res_o   (adder_zero_hold_res)
150 );
151
152 two_cycle_32_adder adder_stb_end (
153     .clk_i   (clk_i),
154     .a_i     (t_cnt),
155     .b_i     (stb_period_o - MAGIC_CONST), //magic constat due to
156     computation pipeline
157     .valid_i (count_stb_end),
158     .valid_o (stb_end_valid),
159     .res_o   (adder_stb_end_res)
160 );
161
162 logic [T_CNT_WIDTH-1:0] latched_zero_hold_res;
163 logic [T_CNT_WIDTH-1:0] latched_stb_end_res;
164
165 always_ff @(posedge clk_i) latched_zero_hold_res <= (
166     zero_hold_begin_valid ? adder_zero_hold_res :
167     latched_zero_hold_res);

```

```

162 always_ff @(posedge clk_i) latched_stb_end_res <= (
      stb_end_valid ? adder_stb_end_res : latched_stb_end_res);
163
164
165 logic is_zero_hold_start_lo;
166 logic is_zero_hold_start_hi;
167 logic is_stb_end_lo;
168 logic is_stb_end_hi;
169
170 always_ff @(posedge clk_i) is_zero_hold_start_lo <= ~(
      t_cnt[15:0] ^ latched_zero_hold_res[15:0]); //t_cnt ==
      latched_zero_hold_res;
171 always_ff @(posedge clk_i) is_zero_hold_start_hi <= ~(
      t_cnt[31:16] ^ latched_zero_hold_res[31:16]); //t_cnt ==
      latched_zero_hold_res;
172 always_ff @(posedge clk_i) is_zero_hold_start <=
      is_zero_hold_start_lo & is_zero_hold_start_hi;
173
174 always_ff @(posedge clk_i) is_stb_end_lo <= ~(t_cnt[15:0]
      ^ latched_stb_end_res[15:0]); //t_cnt ==
      latched_zero_hold_res;
175 always_ff @(posedge clk_i) is_stb_end_hi <= ~(t_cnt[31:16]
      ^ latched_stb_end_res[31:16]); //t_cnt ==
      latched_zero_hold_res;
176 always_ff @(posedge clk_i) is_stb_end <= is_stb_end_hi &
      is_stb_end_lo;
177
178 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i) begin
179     if (~arst_i) begin
180         int_stb = 0;
181     end else begin
182         case (1)
183             is_zero_hold_start: int_stb <= 0;
184             is_stb_end:         int_stb <= 1;
185             default:            int_stb <= int_stb;
186         endcase
187     end
188 end
189
190 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i) begin
191     if (~arst_i) rdy_o = 0;
192     else rdy_o <= (state == COUNT_STROBE ? 1 : rdy_o);
193 end
194
195 always_ff @(posedge clk_i) begin

```

```

196     err_o <= (state == FIND_EDGE_1 ? 0 : err_o);
197 end
198
199 always_ff @(posedge clk_i) t_end <= (state == WRITE_END ?
    t_cnt : t_end);
200
201 always_ff @(posedge clk_i) t_start <= (state == WRITE_START
    ? t_cnt : t_start);
202
203 // pipelined counter
204
205 logic [T_CNT_WIDTH/2-1 : 0] high_bytes = 0      /* synthesis
    syn_keep=1 syn_preserve=1 syn_ramstyle="registers" */;
206 logic [T_CNT_WIDTH/2-1 : 0] latched_low_bytes = 0 /*
    synthesis syn_keep=1 syn_preserve=1 syn_ramstyle="
    registers" */;
207 logic [T_CNT_WIDTH/2-1 : 0] low_bytes = 0      /* synthesis
    syn_keep=1 syn_preserve=1 syn_ramstyle="registers" */;
208 logic [T_CNT_WIDTH/2-1 : 0] low_bytes_plus_1;
209 logic carry;
210
211 assign {carry, low_bytes_plus_1} = low_bytes + 1;
212
213 //incrementing low bytes
214 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i)
215     if (~arst_i) low_bytes = 0;
216     else low_bytes <= low_bytes_plus_1;
217
218 //latching low bytes for 1 cycle
219 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i)
220     if (~arst_i) latched_low_bytes = 0;
221     else latched_low_bytes <= low_bytes;
222
223 logic latched_carry = 0;
224
225 //latching carry
226 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i)
227     if (~arst_i) latched_carry = 0;
228     else latched_carry <= carry;
229
230 //adding latched carry to high bytes
231 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i)
232     if (~arst_i) high_bytes = 0;
233     else high_bytes <= high_bytes + latched_carry;
234

```

```

235 //setting t_cnt
236 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i)
237     if (~arst_i) t_cnt = 0;
238     else t_cnt <= {high_bytes, latched_low_bytes};
239
240 endmodule

```

Листинг П1.2. *two_cycle_32_adder.sv*

```

2 module two_cycle_32_adder (
3     input logic clk_i,
4     input logic [31:0] a_i,
5     input logic [31:0] b_i,
6     input logic valid_i,
7
8     output logic valid_o,
9     output logic [31:0] res_o
10 );
11
12     logic [31:0] a, b;
13
14     always_ff @(posedge clk_i) begin
15         a <= (valid_i ? a_i : a);
16         b <= (valid_i ? b_i : b);
17     end
18
19     enum logic[2:0] {
20         IDLE = 3'b001,
21         FIRST_STAGE = 3'b010,
22         SECOND_STAGE = 3'b100
23     } state = IDLE, next_state;
24
25     always_ff @(posedge clk_i) state <= next_state;
26
27     logic [1:0] valid;
28     integer i;
29     always_ff @(posedge clk_i) begin
30         valid[0] <= valid_i;
31         for (i = 1; i <= 1; i = i + 1 ) valid[i] <= valid[i-1];
32         valid_o <= valid[1];
33     end
34
35
36     always_comb begin

```

```

37     next_state = state;
38     case (state)
39         IDLE: if (valid_i) next_state = FIRST_STAGE;
40         FIRST_STAGE: next_state = SECOND_STAGE;
41         SECOND_STAGE: next_state = IDLE;
42     endcase
43 end
44
45 logic carry;
46
47 always_ff @(posedge clk_i) begin
48     case (state)
49         FIRST_STAGE: {carry, res_o[15:0]} <= a[15:0] + b
50             [15:0];
51         default: {carry, res_o[15:0]} <= {carry, res_o
52             [15:0]};
53     endcase
54     case (state)
55         SECOND_STAGE: res_o[31:16] <= a[31:16] + b[31:16]
56             + carry;
57         default: res_o[31:16] <= res_o[31:16];
58     endcase
59 end
60 endmodule

```

Листинг П1.3. *sc_fifo.sv*

```

2 module sc_fifo #(
3     parameter LGFLEN = 10,
4     parameter WIDTH = 32
5 ) (
6     input logic      clk_i,
7     input logic      arstn_i,
8
9     input logic [WIDTH-1:0] data_i,
10    input logic      wre_i,
11
12    output logic [WIDTH-1:0] data_o,
13    input logic      re_i,
14    output logic      n_empty_o
15 );
16
17    logic [WIDTH-1:0] cyc_buf [int'($pow(2, LGFLEN)-1):0];

```

```

18
19     logic  [LGFLLEN-1:0]  r_addr, w_addr;
20
21     assign n_empty_o = (r_addr != w_addr);
22     assign data_o = cyc_buf[r_addr];
23
24     always_ff @(posedge clk_i/*, negedge arstn_i*/) begin :
25         w_addr_ff
26         if (~arstn_i) begin
27             w_addr = 0;
28         end else begin
29             if (wre_i) begin
30                 w_addr <= w_addr + 1;
31             end
32         end
33     end
34
35     always_ff @(posedge clk_i/*, negedge arstn_i*/) begin :
36         r_addr_ff
37         if (~arstn_i) begin
38             r_addr = 0;
39         end else begin
40             if (re_i & n_empty_o) begin
41                 r_addr <= r_addr + 1;
42             end
43         end
44     end
45
46     always_ff @(posedge clk_i) begin
47         if (wre_i) begin
48             cyc_buf[w_addr] <= data_i;
49         end
50     end
51 endmodule

```

Листинг П1.4. *ch_measure_ctl.sv*

```

2 module ch_measure_ctl #(
3     parameter DEFAULT_THRESHOLD_DELTA = 1,
4     parameter DEFAULT_D_CODE_DELTA = 1
5 ) (
6     input logic clk_i,
7     input logic arst_i,

```



```

8
9 //stb request interface
10 output logic stb_req_o,
11 input logic stb_valid_i,
12
13 //CMP input
14 input logic cmp_out_i,
15
16 //control threshold and delay delta
17 input logic [15:0] threshold_delta_i,
18 input logic [9:0] d_code_delta_i,
19
20 //dac (threshold) output
21 output logic [15:0] threshold_o,
22 output logic threshold_wre_o,
23 input logic threshold_rdy_i,
24
25 //delay line
26 output logic [9:0] d_code_o,
27
28 //ctl
29 input logic run_i,
30
31 //TODO output measured value
32 output logic point_rdy_o
33 );
34
35 enum logic [7:0] {
36     IDLE = 8'b00000001,
37     SET_THRESHOLD = 8'b00000010,
38     WAIT_THRESHOLD = 8'b00000100,
39     REQ_STROBE = 8'b00001000,
40     WAIT_STROBE = 8'b00010000,
41     SAVE_CMP_RES = 8'b00100000,
42     PROCESS_RES = 8'b01000000,
43     UPDATE_CONF = 8'b10000000
44 } ctl_state, next_ctl_state;
45
46 enum logic [1:0] {
47     DIR_UP = 2'b01,
48     DIR_DOWN = 2'b10
49 } threshold_dir;
50
51 enum logic [1:0] {
52     FIND_DIR = 2'b01,

```

```

53     FIND_POINT = 2'b10
54 } point_state, next_point_state;
55
56 logic cur_cmp_out, prev_cmp_out;
57
58 always_comb begin : next_ctl_state_comb
59     if (~run_i) begin
60         next_ctl_state = IDLE;
61     end else begin
62         case (ctl_state)
63             IDLE: next_ctl_state = SET_THRESHOLD;
64             SET_THRESHOLD: next_ctl_state = WAIT_THRESHOLD;
65             WAIT_THRESHOLD: if (threshold_rdy_i) next_ctl_state
66                             = REQ_STROBE;
67                             else next_ctl_state = ctl_state;
68             REQ_STROBE: next_ctl_state = WAIT_STROBE;
69             WAIT_STROBE: if (stb_valid_i) next_ctl_state =
70                         SAVE_CMP_RES;
71                         else next_ctl_state = ctl_state;
72             SAVE_CMP_RES: next_ctl_state = PROCESS_RES;
73             PROCESS_RES: next_ctl_state = UPDATE_CONF;
74             UPDATE_CONF: next_ctl_state = SET_THRESHOLD;
75         endcase
76     end
77 end
78
79 always_comb begin : next_point_state_comb
80     if (ctl_state == PROCESS_RES) begin
81         case (point_state) /* synthesis full_case */
82             FIND_POINT: if (cur_cmp_out != prev_cmp_out)
83                         next_point_state = FIND_DIR;
84                         else next_point_state = point_state;
85             FIND_DIR: next_point_state = FIND_POINT;
86         endcase
87     end else begin
88         next_point_state = point_state;
89     end
90 end
91
92 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i) begin
93     if (~arst_i) begin
94         cur_cmp_out = 1;
95     end else if (ctl_state == SAVE_CMP_RES) begin

```

```

95     cur_cmp_out <= cmp_out_i;
96     prev_cmp_out <= cur_cmp_out;
97 end
98 end
99
100 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i) begin :
101     ctl_state_ff
102     if (~arst_i) begin
103         ctl_state = IDLE;
104     end else begin
105         ctl_state <= next_ctl_state;
106     end
107 end
108
109 logic [15:0] next_threshold;
110 logic [9:0] next_d_code;
111
112 always_comb begin : next_threshold_comb
113     case (ctl_state)
114     IDLE: next_threshold = 0;
115     UPDATE_CONF: if (point_state == FIND_POINT) begin
116         case (threshold_dir) /* synthesis full_case */
117         DIR_UP: next_threshold = threshold_o +
118             threshold_delta_i;
119         DIR_DOWN: next_threshold = threshold_o -
120             threshold_delta_i;
121         endcase
122     end else begin
123         next_threshold = threshold_o;
124     end
125     default: next_threshold = threshold_o;
126 endcase
127 end
128
129 always_comb begin : next_d_code_comb
130     case (ctl_state)
131     IDLE: next_d_code = 0;
132     UPDATE_CONF: if (point_state == FIND_DIR) begin
133         next_d_code = d_code_o + d_code_delta_i;
134     end else begin
135         next_d_code = d_code_o;
136     end
137     default: next_d_code = d_code_o;
138 endcase
139 end

```



```

176         default: threshold_dir <= (threshold_dir ==
177             DIR_DOWN ? DIR_UP : DIR_DOWN);
178     endcase
179 end
180 end
181
182 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i) begin :
183     point_state_ff
184     if (~arst_i) begin
185         point_state = FIND_POINT;
186     end else begin
187         point_state <= next_point_state;
188     end
189 end
190
191 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i) begin : d_code_ff
192     if (~arst_i) begin
193         d_code_o = 0;
194     end else begin
195         d_code_o <= next_d_code;
196     end
197 end
198
199 always_ff @(posedge clk_i, negedge arst_i) begin :
200     point_rdy_ff
201     if (~arst_i) begin
202         point_rdy_o = 0;
203     end else begin
204         if (ctl_state == PROCESS_RES & cur_cmp_out !=
205             prev_cmp_out) point_rdy_o <= 1;
206         else point_rdy_o <= 0;
207     end
208 end
209 end
210 endmodule

```

