

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X		Página 1 de 16
			No. RA 61/2019
			Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019

CONTENIDO






1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE	2
3. DEFINICIONES	2
4. DOCUMENTOS REFERENCIALES	2
5. RESPONSABILIDADES	3
6. DESARROLLO	4
6.1. LINEAMIENTOS GENERALES	4
6.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	5
7. REGISTROS RELACIONADOS	10
8. INDICADORES.....	10
9. APROBACIÓN.....	10
10. ANEXOS	11

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ACÁPITE	DESCRIPCIÓN
1	30-10-2019	----	Nuevo

ÁREA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ELABORADO POR:  Lic. Carla Maritza Hidalgo Lara ENCARGADO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS FECHA:	REVISADO POR:  Ing. Gabriela Ines Castillo Villos PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS FECHA:	REVISADO POR:  Ing. Juan Miguel Viqueval Valle DIRECTOR DE OPERACIONES AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS FECHA:
ELABORADO POR:  Geny M. Olivares Canahui ENCARGADO DE BIENES DE USO, CONSUMO Y SERVICIOS GENERALES AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS FECHA:	REVISADO POR:  Lic. Rodrigo Salvatierra Flores DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS FECHA:	APROBADO POR:  Ing. Iván B. C. Paredes Montano DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS FECHA:

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X	Página 2 de 16 No. RA 61/2019 Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EMISIÓN: 30/10/2019

1. OBJETIVO

Describir sistemática y ordenadamente las actividades necesarias para garantizar un correcto y seguro uso de los equipos escáner de rayos X, su protección, mantenimiento y reparación.

2. ALCANCE

El presente documento describe la etapa operativa en la cual son utilizados los escáneres de rayos X, los responsables de su manipulación y los conductos para las gestiones de mantenimiento y/o reparación.

Aplica a los funcionarios del área operativa y de servicios generales de la Agencia Boliviana de Correos.

3. DEFINICIONES

- **AGBC:** Agencia Boliviana de Correos.
- **IBTEN:** Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear
- **Escáner:** Aparato de rayos X que permite analizar el interior de un objeto o de un cuerpo mediante el procesamiento informático de las imágenes obtenidas.
- **FELCN:** Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico
- **OIEA:** Organismo Internacional de Energía Atómica.
- **Rayos X:** Radiación electromagnética tipo ionizante no visible para el ojo humano, que es capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir imágenes. El daño que causa en los órganos y tejidos humanos, depende de la dosis recibida o absorbida; siendo que los niños, adolescentes y bebés en gestación son más sensibles a la radiación que los adultos.

4. DOCUMENTOS REFERENCIALES

ORIGEN	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	CÓDIGO
Externo	Ley	Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional	D.L. 16998 (02/08/1979)
Externo	Decreto Ley	Ley de Seguridad y Protección Radiológica	D.L. 19172 (29/09/1982)
Externo	Decreto Supremo	Reglamento de Ley 19172 – Protección Radiológica	D.S. 24483
Externo	Normas	Normas de Seguridad Radiológica de las Instalaciones de Irradiación de rayos Gamma, Electrones y Rayos X / Guía de Seguridad Específica - OIEA	Guía No. SSG-8
Externo	Normas	Seguridad Radiológica en la Radiografía Industrial – Guía de seguridad específica - OIEA	Guía No. SSG-11
Interno	Reglamento Especifico	Sistema de Administración de Bienes y Servicios	s/c
Interno	Reglamento	Reglamento Interno de Personal R.I.P.	AGBC.SAP.GRH.RE.001

Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X			Página 3 de 16
				No. RA 61/2019
				Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019	

5. RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades identificadas son:

Direcciones

- ✓ Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente documento.

Administración Financiera (Recursos Humanos) ✓

- ✓ Asegurar que el personal que opera los equipos de rayos X cuente con los conocimientos y la capacitación adecuada.
- ✓ Informar a la autoridad competente sobre el personal asignado a tareas expuestas a radiación.
- ✓ Garantizar que mujeres embarazadas no sean asignadas al manejo de los escáneres.
- ✓ Velar por el cumplimiento de las revisiones médicas periódicas al personal a cargo del uso de los equipos de rayos X
- ✓ Supervisar la entrega y devolución de los dosímetros personales
- ✓ Realizar, mantener actualizado y custodiar el registro individual de los trabajadores expuesto a radiación.


Administración Financiera (Servicios Generales)

- ✓ Velar por las condiciones físicas de protección y uso de los equipos de rayos X
- ✓ Asegurar que el proveedor certifique el cumplimiento de los escáneres con normas de seguridad radiológicas vigentes tanto de fabricación como de instalación; así como de la optimización de los controles de exposición propios de los equipos.
- ✓ Observar que se cumplan los mantenimientos preventivos programados y se extienda el certificado técnico correspondiente.
- ✓ Gestionar oportunamente toda necesidad de reparación de los escáneres y que se extienda el certificado técnico correspondiente.
- ✓ Organizar y gestionar mantenimiento periódico de los detectores de radiación con énfasis en pruebas de calibración.
- ✓ Investigar las causales de todos los incidentes o cuasi accidentes que se produzcan en relación a los escáneres.
- ✓ Constituirse en el enlace con los contratistas o suministradores.

Operaciones

- ✓ Precautelar las condiciones físicas y de seguridad de los equipos de rayos X.
- ✓ Proporcionar al operario de escáner, las normas de seguridad relacionadas vigentes y el manual de uso del escáner a su cargo y asegurar que tenga acceso irrestricto y ágil al mismo.
- ✓ Precautelar las condiciones de seguridad ocupacional de los funcionarios que operan los equipos de rayos X.
- ✓ Asegurar la información a los trabajadores, sobre el acceso a las zonas controladas.
- ✓ Supervisar la correcta utilización de los equipos y las condiciones de entorno.

Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia

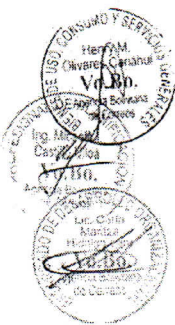

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X			Página 4 de 16
				No. RA 61/2019
				Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019	

- ✓ Controlar los niveles de radiación y contaminación ambiental.
- ✓ Informar oportunamente a la unidad competente toda irregularidad física, lógica, de ambiente, o cualquier otra que afecte el normal uso de los equipos de rayos X
- ✓ Gestionar oportunamente la solicitud de reparación de los escáneres de rayos X


Operario Designado

- ✓ Hacer un uso correcto de los escáneres en el marco de la normativa relacionada y en sujeción estricta al manual de uso.
- ✓ Realizar las inspecciones básicas rutinarias determinadas en el presente documento.
- ✓ Informar oportunamente cualquier incidente físico o lógico observado en el o los escáneres.
- ✓ Hacer uso continuo y permanente del dosímetro asignado.
- ✓ Cumplir con los controles médicos periódicos.

6. DESARROLLO

6.1. LINEAMIENTOS GENERALES

- a. Con el fin de brindar las condiciones de seguridad en cuanto al traslado de sustancias controladas u objetos restringidos y/o prohibidos en el marco de la normativa postal internacional, la FELCN y Aduana; y como parte de la prestación del servicio postal, la AGBC determina la instalación de equipos escáner de rayos X en ambientes aeroportuarios propios, que permiten inspecciones no intrusivas a los envíos postales.
- b. En cumplimiento al D.L. 19172, y el D.S. 24483, la AGBC ha registrado todos los escáneres de que dispone en el IBTEN; por consiguiente, cuenta con licencia de uso y se somete a las inspecciones dispuestas normativamente.
- c. Las condiciones de seguridad en las instalaciones para el funcionamiento de los escáneres de rayos X, la protección de los operarios y de terceras personas, tienen como base las Normas de Seguridad Radiológica de la OIEA; y el D.L. 19172.
- d. Los espacios físicos alcanzados por la radiación de los escáneres y los equipos mismos, son identificados con la leyenda "Precaución – rayos X" visualizable desde todas las direcciones, con el símbolo  y la leyenda "Acceso Únicamente a Personal Autorizado" y se cuenta con control de cámaras de seguridad.
- e. Se cuenta con el certificado emitido por el proveedor e instalador de los equipos; que asegura que el equipamiento satisface todas las normas de seguridad vigentes.
- f. Los escáneres son utilizados para inspeccionar el contenido de envíos postales, principalmente aquellos con origen y destino internacional; y deben estar encendidos exclusivamente el tiempo durante el cual son efectivamente utilizados.

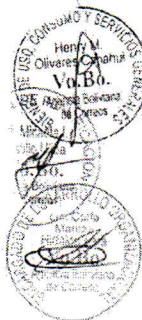

Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X			Página 5 de 16
				No. RA 61/2019
				Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019	

- g. El personal designado a la manipulación de los escáneres de rayos X, cuenta con el dispositivo de dosimetría personal, cuenta con examen médico pre-ocupacional y se le realizan los controles médicos periódicos a través del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO)
- h. Se determina restricción total de exposición a los escáneres, a funcionarias en estado de gestación.
- i. El incumplimiento u omisión a lo establecido en el presente documento, será sujeto a sanciones disciplinarias en el marco del Reglamento Interno de Personal.

6.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.2.1. Control Diario de Uso

- El manual de usuario de los escáneres de rayos X, se encuentra en lugar accesible y de conocimiento de los funcionarios a cargo.
- Ningún funcionario está autorizado a realizar modificaciones en el hardware o en el software de los escáneres de rayos X; esta actividad está restringida al servicio especializado para mantenimientos y reparaciones.

Actividad			Responsable	Tiempo / Plazo	Registros / Constancias
No.	Nombre	Descripción			
1	Realizar inspección visual externa	Al iniciar la jornada realiza inspección visual externa de las condiciones de ambiente del escáner y los niveles de radiación ambiental (Anexo 1) Apunta la acción en el registro de control de uso (del día) y toda observación que haya identificado; y lo firma.	Operaciones (Supervisor designado)	Diario al inicio de la jornada	Registro de Control de Uso de escáner (Anexo 2)
2	Realizar inspección inicial para el uso	Antes de encender el escáner realiza la misma inspección visual externa que realizó el supervisor. Constatado lo anterior, enciende el equipo y verifica todas las condiciones de seguridad que muestra la pantalla del controlador (Anexo 1).	Operaciones (Operario designado)	Al momento de iniciar actividad	
3	Registrar acceso y uso	Al momento de iniciar las operaciones, apunta en el registro de control de uso la fecha, la hora de encendido, alguna observación identificada, su nombre y firma.			
4	Apagar y registrar datos	Luego de haber concluido con el trabajo de escaneo, apaga el equipo, realiza una nueva verificación en los niveles de radiación ambiental y complementa el registro de control de uso, con información de la cantidad de sacas o envíos escaneados, y la hora de conclusión y apagado.			


Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X		Página 6 de 16
			No. RA 61/2019
			Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019

Actividad		Responsable	Tiempo / Plazo	Registros / Constancias
No.	Nombre Descripción			
5	Realizar inspección de cierre de jornada Al finalizar la jornada, verifica: • Condiciones de ambiente y físicas del escáner. • Niveles de radiación en el ambiente • El registro de control de uso del escáner apuntado por el operario; corroborando la cantidad de sacas y envíos recibidos y despachados en el día con respecto a los registrados como escaneados. Registra su inspección y toda observación que identifique. Evalúa todas las observaciones registradas (por ambos actores) según correspondan a aspectos propios del equipo, a aspectos de ambiente, de personal o de otro tipo para direccionar la solución a la unidad o instancia competente.	Operaciones (Supervisor designado)	Diario al final de la jornada	Registro de Control de Uso de escáner (Anexo 2)

6.2.2. Gestiones de Mantenimiento y Reparación

- La contratación de empresas para el mantenimiento y reparación de escáneres considera la experiencia institucional y la certificación de contar con personal competente y capacitado; y el requisito explícito de una certificación de mantenimiento y/o reparación en cada intervención técnica; debiendo ser extendido en el plazo de 24 hrs de realizada la acción.
- Toda observación de ambiente que pueda afectar la seguridad del equipo, del operario o de terceros en relación al uso del escáner, y aquellas registradas en el uso cotidiano deben ser oportunamente informadas a la Unidad Administrativa Financiera para que se tomen las previsiones del caso.
- El mantenimiento rutinario de los equipos debe contar con una programación y coordinación previa a fin de precautelar la continuidad de las operaciones y preferentemente ser realizada en horarios de la tarde cuando no se utilicen los equipos.
- En función a la programación adoptada, la contratación del servicio técnico deberá ajustarse a las modalidades vigentes y habilitadas a nivel institucional en el marco del presupuesto aprobado.

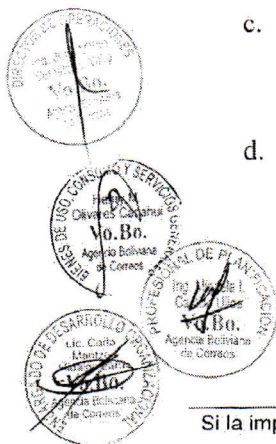

Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X		Página 7 de 16
			No. RA 61/2019
			Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019


Actividad			Responsable	Tiempo / Plazo	Registros / Constancias
No.	Nombre	Descripción			
NOTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE OBSERVACIONES					
1	Sistematizar observaciones y notificarlas	Producto de la revisión del Registro de Control de Uso de escáner, en caso de haberse apuntado observaciones, realiza una breve sistematización de las mismas: • Código del escáner • Ubicación • Descripción de la observación • Fecha de la observación y a través de correo electrónico lo remite a la Unidad Administrativa Financiera (Profesional de Servicios Generales) con copia al Director Administrativo Financiero, para su conocimiento. Notas: 1.No se refiere a observaciones que impiden el funcionamiento del escáner, si no aquellas podrían significar un potencial daño o problema futuro. 2.En lo posible, las observaciones físicas y de ambiente deben ser acompañadas con fotografías digitales del lugar.	Operaciones (Supervisor designado)	Diario al inicio de la siguiente jornada	Correo electrónico Registro de Control de Uso de escáner
2	Evaluar y re agrupar las observaciones	Recibe el detalle de observaciones y las separa según correspondan a: • Observaciones al equipo (hardware / software) • Observaciones a condiciones de ambiente Remite por correo electrónico al servicio técnico contratado, el listado de las observaciones al equipo, solicitando su evaluación (con copia al Director Administrativo Financiero) Remite al Director Administrativo Financiero el listado de observaciones físicas y de ambiente, solicitando instrucciones.	Administración Financiera (Servicios Generales)	Diario, antes del medio día de la jornada en que recibe las observaciones	Correo electrónico
3	Hacer seguimiento y ejecutar instrucción	Enviadas las observaciones a los actores correspondientes, hace seguimiento a sus respuestas o instrucción de acciones según corresponda. Nota. En caso de no recibir respuesta en el transcurso de la jornada, al finalizar ésta debe enviar una reiteración solicitando atención.		Al final de la jornada	Correo electrónico

Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X		Página 8 de 16
			No. RA 61/2019
			Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019

Actividad			Responsable	Tiempo / Plazo	Registros / Constancias
No.	Nombre	Descripción			
MANTENIMIENTO					
1	Coordinar servicio	Previamente concretada la contratación del servicio técnico a través de la modalidad más adecuada y en cumplimiento a procedimientos internos; de acuerdo a la programación previa de mantenimiento preventivo, se contacta (puede ser telefónicamente o por correo electrónico) con el contratista de mantenimiento y coordina la fecha y hora del mantenimiento. Inmediatamente notifica a través de correo electrónico a Operaciones Regional la fecha y hora del mantenimiento, solicitando la disponibilidad del supervisor correspondiente.	Administración Financiera (Servicios Generales)	Periódico según programación	Correo electrónico
2	Supervisar la ejecución del servicio	En el día y hora fijados acompaña el trabajo de mantenimiento de principio a fin; debiendo revisar la ficha técnica de la empresa contratista antes de firmarla en conformidad.	Operaciones (Supervisor designado)	Según programación	Informe + hoja de ruta
3	Elaborar informe	Elabora informe de supervisión a la actividad de mantenimiento y con hoja de ruta lo remite vía el Responsable Postal Regional, a la Dirección de Operaciones.		1 día	
4	Recibir certificación y gestionar proceso de pago	En el plazo definido contractualmente y de acuerdo al inciso a del presente acápite, recibe la certificación correspondiente, que debe estar acompañada de la ficha técnica firmada por el supervisor de escáneres. Al no tener observaciones, y según la temporalidad que corresponda contractualmente, aplica el procedimiento correspondiente para gestionar el pago por los servicios prestados.	Operaciones Nacional	24 horas luego de realizado el mantenimiento	Certificación de mantenimiento

Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación. Verifique con el área competente su vigencia

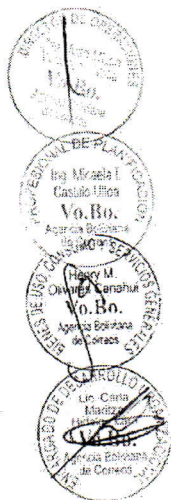

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X		Página 9 de 16
			No. RA 61/2019
			Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019

Actividad		Responsable	Tiempo / Plazo	Registros / Constancias	
No.	Nombre Descripción				
REPARACIÓN					
1	Solicitar servicio de reparación	Verifica el incidente o falla manifestada por el operador y llena el Formulario de Solicitud de Reparación de Escáner; lo firma y lo entrega al Responsable de Operaciones Postales Regional.	Operaciones (Supervisor escáner)	Inmediatamente detectada la falla	Formulario de Solicitud de Reparación de escáner (Anexo 3)
		De considerarlo necesario, constata en sitio la falla o problema reportado en el formulario y al no tener mayores observaciones, sella y firma su VoBo y con nota interna y hoja de ruta lo remite a la Dirección de Operaciones solicitando las gestiones para el servicio de reparación.	Operaciones Regional (Responsable Postal Regional)	30 min	Hoja de ruta
		Revisa la solicitud y en caso de no tener observaciones, sella y firma su aprobación en el formulario y deriva la documentación a la Dirección Administrativa Financiera solicitando dar curso.	Director de Operaciones	En el día de recibida la nota	Hoja de ruta
2	Instruir acciones	Verifica la solicitud y a fin de precautelar la continuidad de las operaciones, autoriza el formulario y deriva la solicitud al profesional de Servicios Generales instruyendo la coordinación del servicio.	Director Administrativo Financiero	En el día de recibida la nota	Hoja de ruta
3	Gestionar proceso de Contratación (Aplica si no se cuenta con un servicio previamente contratado)	En caso de no contar con un servicio técnico previamente contratado, se aplican los procedimientos internos de contratación bajo la modalidad más adecuada, precautelando la celeridad en la atención del requerimiento.	Administración Financiera (Servicios Generales)	Dentro de los plazos establecidos según modalidad de contratación elegida	Respaldos propios del proceso
4	Coordinar servicio	Se contacta (puede ser telefónicamente o por correo electrónico) con el contratista y coordina la fecha y hora del servicio. Inmediatamente notifica a través de correo electrónico a Operaciones Regional la fecha y hora del servicio, solicitando la disponibilidad del supervisor correspondiente.	Administración Financiera (Servicios Generales)	1 hora desde que recibe la autorización	Correo electrónico
5	Supervisara la ejecución del servicio	En el día y hora fijados acompaña el trabajo de principio a fin; debiendo ese momento verificar en la práctica el correcto funcionamiento del equipo, y el llenado de la ficha técnica de la empresa contratista antes de firmarla en conformidad.	Operaciones (Supervisor designado)	Según programación	Informe + hoja de ruta

Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X			Página 10 de 16
				No. RA 61/2019
				Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019	

No.	Nombre	Actividad	Responsable	Tiempo / Plazo	Registros / Constancias
		Descripción			
6	Elaborar informe	Elabora informe de supervisión a la actividad de mantenimiento y con hoja de ruta lo remite vía el Responsable Postal Regional, a la Dirección de Operaciones.	Operaciones (Supervisor designado)	1 día	
7	Recibir certificación y gestionar proceso de pago	En el plazo definido contractualmente y de acuerdo al inciso a del presente acápite, recibe la certificación correspondiente, que debe estar acompañada de la ficha técnica firmada por el supervisor de escáneres. Al no tener observaciones, y según la temporalidad que corresponda contractualmente, aplica el procedimiento correspondiente para gestionar el pago.	Operaciones Nacional	24 horas luego de realizado el servicio	Certificación de reparación

7. REGISTROS RELACIONADOS

Identificación		Almacenamiento				Tiempo de Resguardo	Disposición final
Nombre	Código	Formato	Método	Lugar	Responsable		
Registro de Control de Uso de Escáner	n/a	Impreso	Cronológico	Cuaderno específico	Operaciones	3 años	Archivo intermedio
Formulario de Solicitud de Reparación de Escáner	AGBC.F.OPR.006	Impreso	Cronológico	Carpeta específica	Servicios Generales	3 años	Archivo intermedio

8. INDICADORES

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	META	RESPONSABLE DE MEDICIÓN	PERIODICIDAD
Cantidad de observaciones	Cantidad de observaciones por tipo de observación	0%	Operaciones	Mensual
Tasa de reparaciones	Cantidad de reparaciones no programadas	0%	Servicios Generales	Semestral
Tasa de superación de niveles de radiación ambiental aceptables	Cantidad de oportunidades en que el nivel de radiación en el ambiente superó los límites aceptables de seguridad / Cantidad de mediciones realizadas	0%	Operaciones	Semanal

9. APROBACIÓN

El presente documento es propiedad intelectual de la Agencia Boliviana de Correos, ha sido aprobado por el nivel correspondiente, significando de estricto cumplimiento para todo el personal de la Agencia.

Se encuentra disponible para los trabajadores de la AGBC en la Unidad de Planificación

Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X			Página 11 de 16
				No. RA 61/2019
				Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019	

10. ANEXOS

Anexo No. 1 – Listado de revisiones básicas de uso cotidiano (Check List)

Anexo No. 2 – Formato de Contenido del Registro de Control de Uso de Escáner

Anexo No. 3 – Formulario de Solicitud de Reparación de Escáner

Anexo No. 4 – Cuadro referencial de exposición a radiación en el ambiente

Anexo No. 5 – Flujogramas del proceso



Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia

[Handwritten signature]

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X			Página 12 de 16
				No. RA <i>61/2019</i>
				Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: <i>30-10-2019</i>	

ANEXO No. 1

GUÍA DE REVISIONES BÁSICAS COTIDIANAS

La/s persona/s a cargo de la manipulación, uso y/o supervisión de los escáneres de rayos X, están autorizados, y deben realizar las siguientes comprobaciones rutinarias al equipo:

1. INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA – PRE ENCENDIDO:

- Realice la medición de radiación ambiental con el dispositivo destinado para tal fin.
- Verifique que el tomacorriente de energía posee tensión compatible con la alimentación del escáner;
- Verifique si el cable de alimentación está conectado correctamente;
- Verifique si el punto de energía posee pin de conexión a la tierra;
- Verifique si el lugar de instalación permite fácil acceso al botón de emergencia;
- Verifique que los botones de emergencia están en buen estado de conservación;
- Verifique si las cortinas de plomo en la entrada y salida del túnel no poseen daños;
¡Atención! En caso que sea verificado algún daño en las cortinas de plomo, el equipo no debe ser energizado y el hecho debe ser comunicado al servicio técnico
- Verifique que la correa transportadora esté correctamente alineada y en buen estado;
¡Atención! En caso que sea verificado algún daño o desalineamiento en la correa, entre en contacto con el servicio técnico
- Verifique que el túnel esté vacío
- Verifique que los paneles exteriores y las puertas están correctamente ajustados
- Verifique que las cabezas de los tornillos están a nivel o ligeramente por debajo de la superficie del panel.

NOTA DE ADVERTENCIA: El funcionario debe evitar introducir las manos en el túnel de radiación.

2. INSPECCIÓN INICIAL DE FUNCIONAMIENTO ENCENDIDO

Gire la llave enciende/apaga del teclado para la posición "I" y verifique:


- Que se encienda la luz de indicación de alimentación en el teclado y el indicador de encendido del panel de control;
- Que el sistema pasa el auto test:
- Que el sensor de paquetes y el indicador de "Rayos X encendido" se encienden


Con el sistema en marcha, coloca un paquete de prueba en la entrada de la cinta conteniendo objetos orgánicos e inorgánicos, representativos de los tipos de envoltorios que se van a inspeccionar normalmente y:

- Verifica que, la cinta se mueve hacia adelante y hacia atrás
- Verificar que, al presionar el botón de ALTO, la cinta se detiene
- Verificar que las imágenes que aparecen en el monito son claras, no vibran ni tiemblan.
- Verificar que las sustancias orgánicas e inorgánicas aparecen en los colores que corresponden.
- Verificar que el zoom funciona correctamente presionando secuencialmente las teclas
- Comprobar el bloqueo de seguridad de puertas y paneles intentando abrirlas mientras el equipo está en marcha; comprobando que la cinta se detiene y el indicador de "rayos X encendido" se apaga.

(Fuente: Manual de Operación Spectrum)

Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia



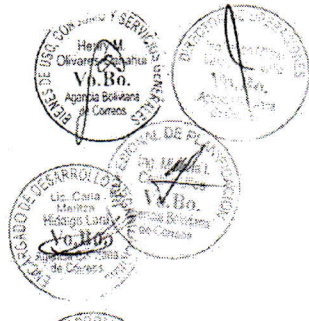

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCANER DE RAYOS X		Página 13 de 16
			No. RA 61/2019
			Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019

ANEXO No. 2
FORMATO DE CONTENIDO
REGISTRO DE CONTROL DE USO DE ESCANER DE RAYOS X

Cod. Escáner:
Ubicación:
Responsable de Uso:
Supervisor:

1		2				3			
Fecha		Verificación Supervisor		Verificación visual externa		Verificación Operador		Verificación visual externa	
		Hora de verificación	Ok / NOK / Observación	Firma supervisor		Hora de verificación	Ok / NOK / Observación	Hora de verificación / encendido	Ok / NOK / Observación


4		5				6			
Cantidad de envíos escaneados		Control de Uso		Apagado		Verificación final (Supervisor)		Verificación visual externa	
		Cantidad de sacas escaneadas	Hora de apagado	Observación	Firma Operador	Hora de verificación	Ok / NOK / Observación	Firma supervisor	

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X		Página 14 de 16
			No. RA 61/2019
			Versión: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: 30-10-2019


ANEXO No. 3
FORMULARIO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN DE ESCÁNER

			
SOLICITUD DE REPARACIÓN DE ESCÁNER DE RAYOS X			
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE			
OFICINA POSTAL:			OPERARIO RESPONSABLE:
SUPERVISOR:			
RESPONSABLE REGIONAL:			
II. INFORMACIÓN DEL ESCANER			
No. de Serie:			Antecedentes de observaciones registradas:
Marca:		Modelo:	
Ubicación:			
Fecha de detección de la falla:			
Descripción del problema:			
SELO / FIRMA OPERARIO RESPONSABLE		SELO / FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO	
Fecha:		Fecha:	
SELO / FIRMA RESPONSABLE REGIONAL			
III. AUTORIZACIONES			
SELO / FIRMA APROBACIÓN DIRECTOR DE OPERACIONES		SELO / FIRMA AUTORIZACIÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
Fecha:		Fecha:	

AGBC.F.OPR.008 V.1

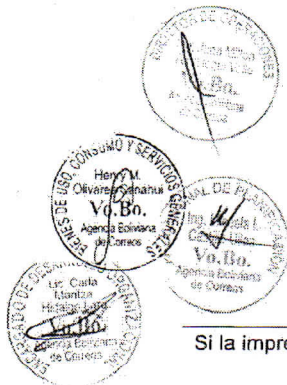



Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia





	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Página 15 de 16
	PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X		No. RA <i>61/2019</i>
			Version: 1
AGBC.SOP.GBS.PR.001	SISTEMA DE OPERACIONES	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMISIÓN: <i>30-10-2019</i>

ANEXO No. 4
FLUJOGRAMA DEL PROCESO

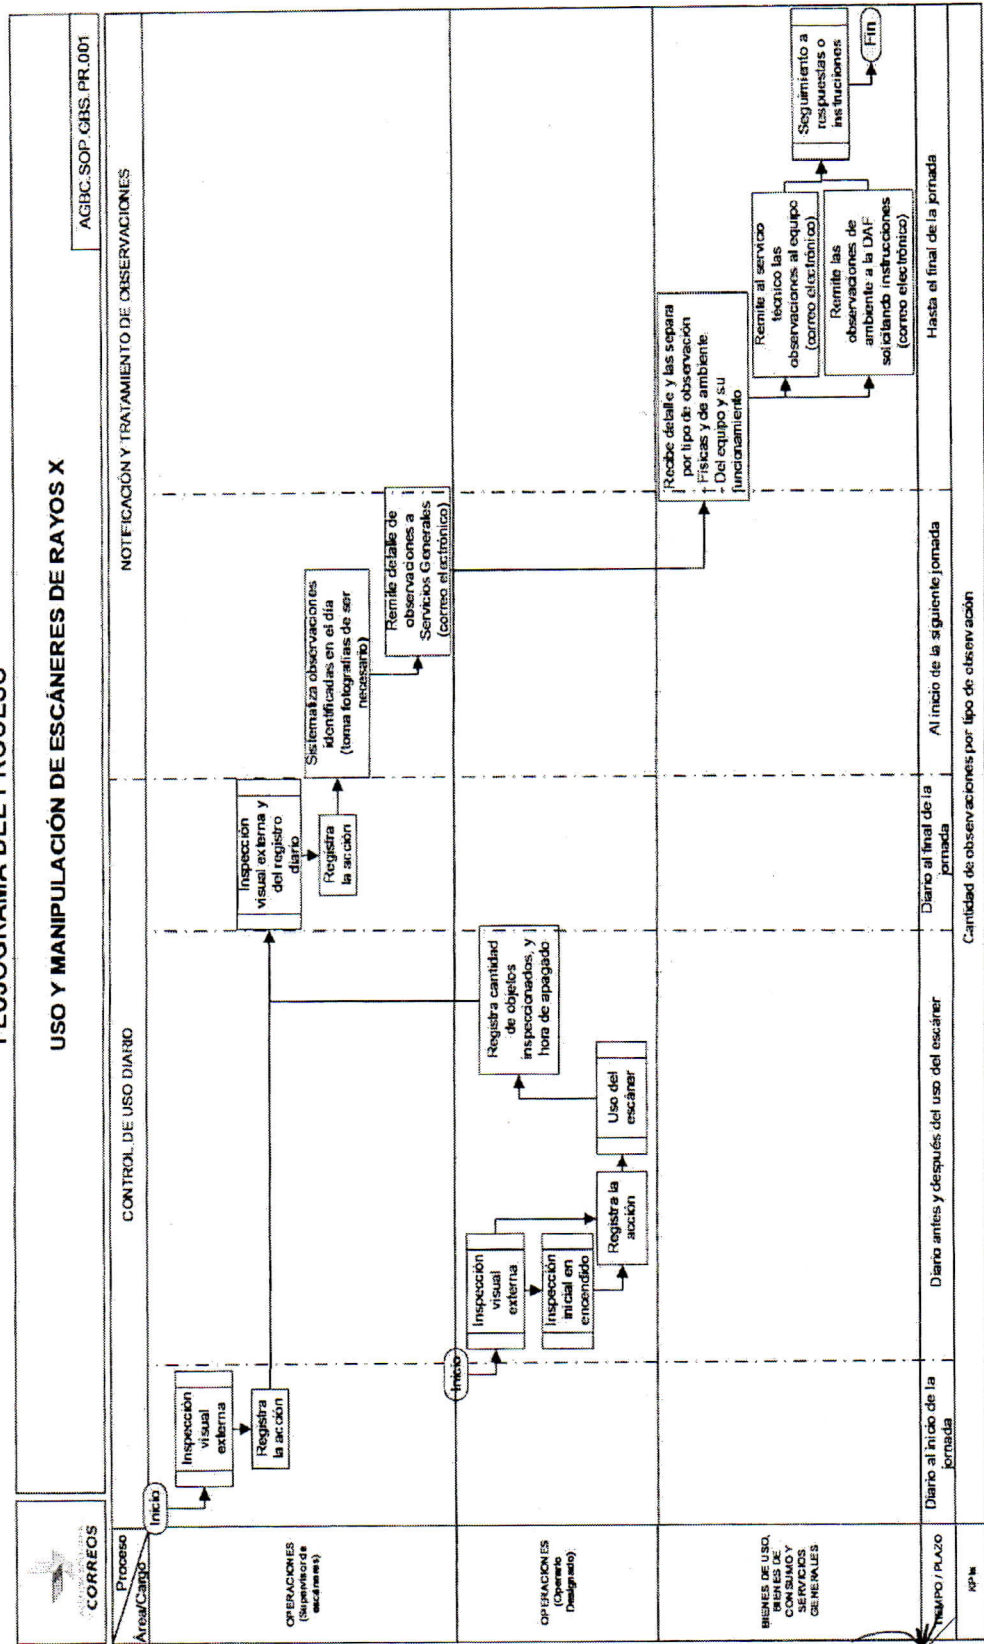



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Página 16 de 16
	PROCEDIMIENTO PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCÁNER DE RAYOS X		No. RA 61/2019
	AGBC.SOP.GBS.PR.001		EMISIÓN: 30-10-2019
SISTEMA DE OPERACIONES		GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 1

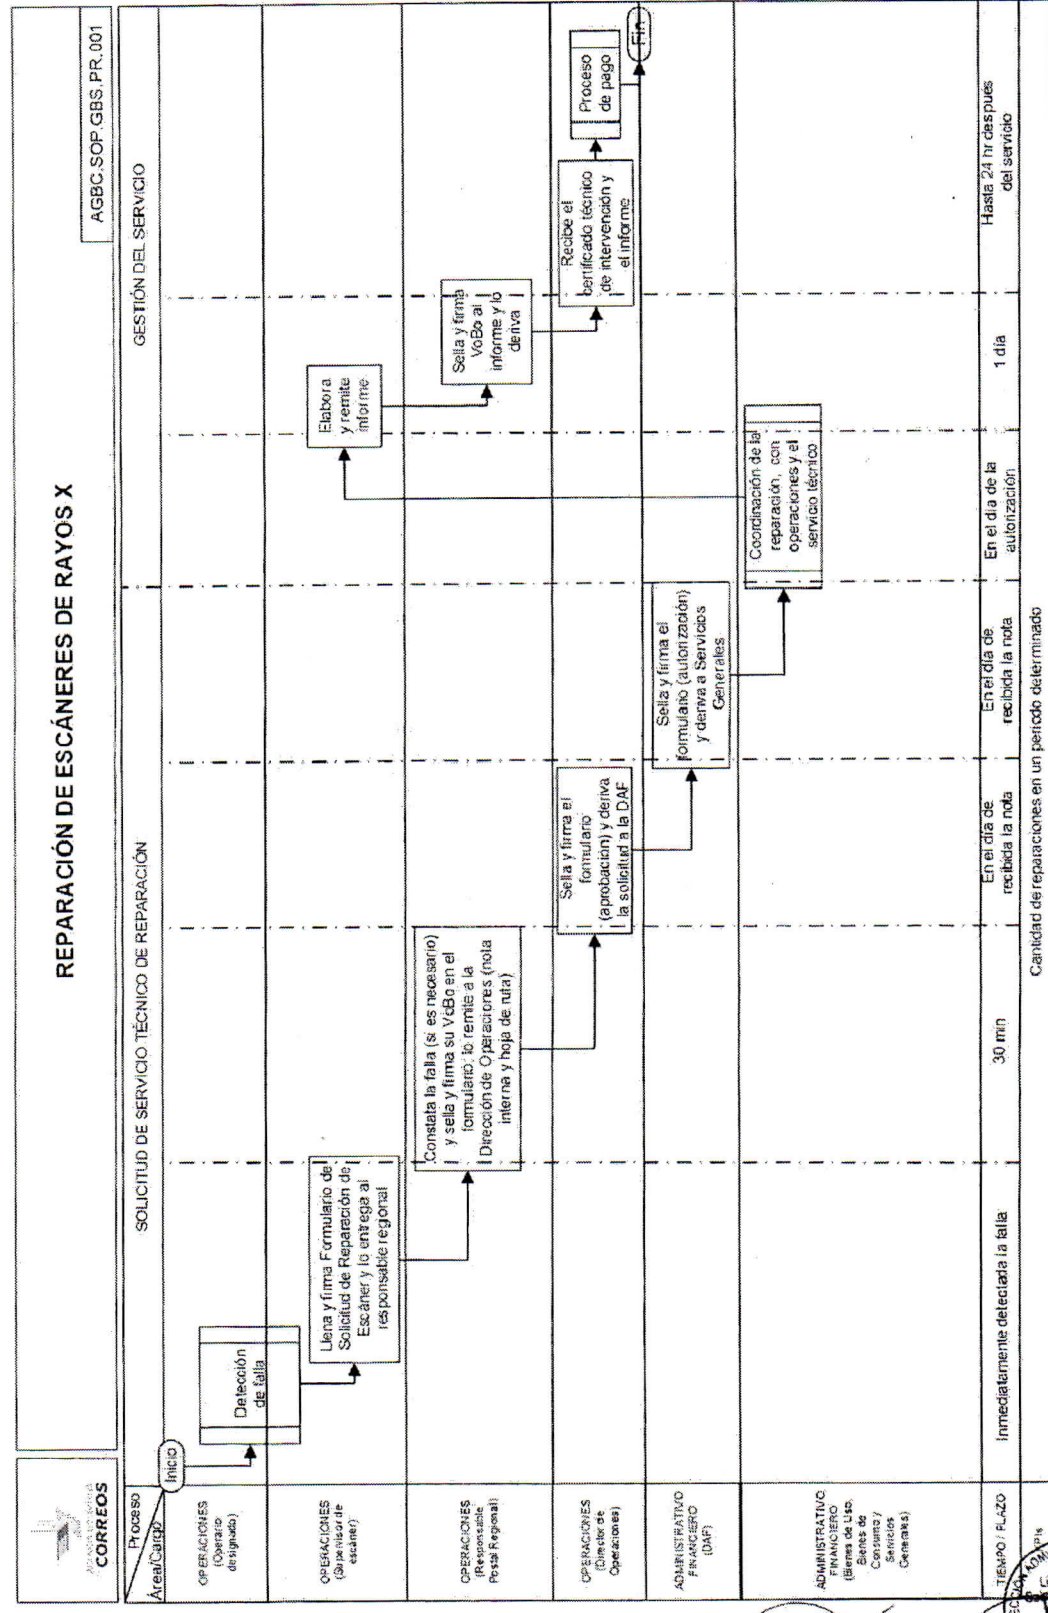

La impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación. Verifique con



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 061
La Paz, 30 de octubre de 2019

CONSIDERANDO:

Que los parágrafos I y II del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, determinan que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones y que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

Que el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado señala que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que los numerales 1 y 2 del Artículo 235 de la referida norma suprema del Estado señalan que son obligaciones de las servidoras y servidores públicos cumplir y hacer cumplir las leyes, así como cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública.

Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 3495 de 28 de febrero de 2018, establece lo siguiente: "Se crea la Agencia Boliviana de Correos denominada "Correos de Bolivia", como una institución pública descentralizada de derecho público con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda".

Que el Artículo 5 del referido Decreto Supremo establece que las funciones de la Agencia Boliviana de Correos son las siguientes: a) Planificar, prestar, mejorar, y desarrollar en todo el territorio nacional los servicios postales básicos y no básicos, nacionales o internacionales, financieros, postales, conexos y accesorios establecidos en las disposiciones legales sobre Correos, en los convenios y Acuerdos Postales Internacionales suscritos por el Estado y en sus respectivos reglamentos y b) Prestar y promover el desarrollo del Servicio Postal Universal.


Que el inciso d) del Artículo 6 del Decreto Supremo N° 3495 determina que es atribución del Director General Ejecutivo, aprobar reglamentos internos, manuales y toda normativa necesaria para el cumplimiento de las finalidades de la Agencia Boliviana de Correos.

Que mediante Nota Interna NI/AGBC/DESP/PLA N° 0036/2019 de 28 de octubre de 2019, la Encargada de Desarrollo Organizacional, remite el proyecto de Manual de Procesos y Procedimientos – Procedimiento para el Uso, Mantenimiento y Reparación de los Equipos Escáner de Rayos X de la Agencia Boliviana de Correos, para su aprobación mediante Resolución Administrativa.



www.correos.gob.bo

Av. Mariscal Santa Cruz, esq. Calle Oruro No. 1240
Edif. Centro de Comunicaciones La Paz - Mezzanine
Teléfono: (591-2) 2152423





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



POR TANTO:

El Director General Ejecutivo de la Agencia Boliviana de Correos, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE y en ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente:

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Manual de Procesos y Procedimientos – Procedimiento para el Uso, Mantenimiento y Reparación de los Equipos Escáner de Rayos X de la Agencia Boliviana de Correos que forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución Administrativa.

SEGUNDO.- La Dirección de Operaciones y la Dirección Administrativa Financiera, quedan encargadas de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución.

TERCERO.- La Unidad de Planificación queda encargada de la difusión de la presente resolución al interior de la entidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Ing. Iván B. Cepedez Muñoz
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



www.correos.gob.bo

Av. Mariscal Santa Cruz, esq. Calle Oruro No. 1240
Edif. Centro de Comunicaciones La Paz - Mezzanine
Teléfono: (591-2) 2152423

