

Protokoll Analytik

Versuch 2.2

Nachweis und Bestimmung von Blei in Trinkwasser (Polarographie)

Gruppe 2.4 (BCUC4)

Teilnehmer:

Willy Messerschmidt Roman-Luca Zank

Protokollführer: NAME

Datum der Versuchsdurchführung: 18.05.2020

Abgabedatum: 01.06.2020

Merseburg den 30. Mai 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung			
2	Theorie 2.1 Voltammetrie	2 2 3	
3	Geräte und Chemikalien	5	
4	 Durchführung 4.1 Versuchsteil 1: Aufnahme und Glättung des Polarogramms 4.2 Versuchsteil 2: Identifikation und Quantifizierung des Analyten Blei der Wasserprobe	5 5	
5	Ergebnisse 5.1 Versuchteil 1:	7 7 9	
6	Diskussion	18	
7	Fehlerbetrachtung	18	
Ar	nhang	19	
Lit	teraturverzeichnis	20	

1 Einleitung

Als Teil der Voltammetrie bezeichnet die Polarographie ein Analyseverfahren, bei dem eine tropfende Quecksilberelektrode als polarisierbare Elektrode genutzt wird (siehe Abb. 1). Die im Praktikum aufgenommenen Daten beinhalten die Stromstärke I als Messgröße über die angelegte Gleichspannung U als variierende Größe. Das Verfahren beruht dabei auf der elektrolytischen Abscheidung, in diesem Fall Reduktion, von Stoffen aus der Probenlösung.[1]




Abb. 1: Schematische Darstellung eines Polarographen [1]

Im Versuch wurde mittels des Analyseverfahrens der Polarographie, der Bleigehalt in einer unbekannten Wasserprobe bestimmt.

2 Theorie

Grundlagen der Voltammetrie un der Elektrochemischen Spannungsreihe!

2.1 Voltammetrie

Voltammetrie ist eine Sammelbezeichnung für einige elektrochemische Analysemethoden, bei denen die Spannung (das Potential) und der fließende Strom zwischen mindestens zwei Elektroden betrachtet werden, um daraus Aussagen zur Zusammensetzung einer Probe abzuleiten.

Die Voltammetrie ist nicht mit der Voltametrie zu verwechseln. Bei letzterer wird lediglich die Spannung gemessen.

2.2 Die Elektrochemische Spannungsreihe

Grundlage für die Analyse der enthaltenen Metall-Ionen ist die aufgenommene Strom-Spannungs-Kurve des Polarographen. Aufgrund der spezifischen Halbstufenpotentiale von Metall-Ionen ändert sich bei unterschiedlichen Arbeitspotentialen die gemessene Stromstärke. Dieser Strom an der Arbeitselektrode tritt als Folge der Reduktionsreaktion der Metall-Ionen auf und ist direkt proportional zur Konzentration des umgesetzten Stoffes. Der Strom im Zusammenhang mit diesem Massentransport der Ionen wird als Faradayscher Strom bezeichnet. Um eine ausreichende Leitfähigkeit und somit einen entsprechenden Ladungstransport der Lösung garantieren zu können, werden den untersuchten Proben oft Grundelektrolyten in Form von Salzen, Säuren oder Basen zugegeben. Aufgrund der spezifischen Halbstufenpotentiale lassen sich qualitative Ergebnisse dieses Verfahrens auswerten. Betrachtet man jedoch auch den Zusammenhang des Stromflusses bei einem bestimmten Arbeitspotential mit der Konzentration des umgesetzten Stoffes, so lassen sich ebenfalls quantitative Bewertungen äußern. Für diese Betrachtung ist jedoch eine Form der Kalibrierung notwendig, um die gemessenen Signale quantitativ auswerten zu können. Dies ist zum einen über einen externen oder internen Standard möglich, jedoch wurde sich aufgrund der geringen zu bestimmenden Konzentrationen in diesem Versuch für die Aufstockmethode, auch Standardadditionsmethode genannt, entschieden. Möchte man einen internen oder externen Standard nutzen so sind in diesem Fall ebenfalls Kalibrierkurven mit linearem Zusammenhang mittels bekannter Referenz aufzustellen. Bei dieser Methode wird in diesem Versuch nach der polarographischen Analyse der unbehandelten Probe, eine definierte Menge eines bekannten Standards zugegeben. Dieser Standard enthält dabei den zu bestimmenden Stoff in einer exakt bekannten Konzentration. Aus den gemessenen Datenpunkten lässt sich nun eine Geradengleichung bestimmen (siehe Abb. 2 und Gl. 1).

$$Y = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot X + yA \tag{1}$$

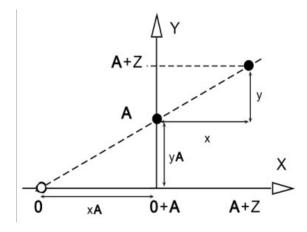


Abb. 2: Darstellung der Standardadditionsmethode

Aus der ermittelten Geradengleichung, lässt sich nun, aufgrund der geometrischen Beziehung der Strahlensätze, die Konzentration der Probe über den Wert xA in Abb. 2 bestimmen. Eine Herleitung dazu ist unter Gl. 2 und Gl. 3 zu finden. Die Bedeutungen der Variablen sind nachfolgend in der Tabelle 1 aufgeführt.

$$Y = \frac{y}{x} \cdot X + yA$$

$$X = \frac{Y - yA}{\frac{y}{x}}$$
(2)

 $F\ddot{u}r Y = 0 \ hei \beta t \ das:$

$$X = xA = \frac{0 - yA}{\frac{y}{x}} = \frac{-yA}{\frac{y}{x}}$$

$$xA = -c$$

$$c = \frac{yA}{\frac{y}{x}}$$
(3)

Tab. 1: Variablen und ihre Bedeutung

Variable	Bedeutung
A	Analyt
Z	Zugabe
Y	Signalwert
yA	Signalwert der Testlösung - nur Analyt
Δy	Signaländerungnach Zugabe der Standardlösung
X	Anylytwert
xA	Analytkonzentration in der Testlösung
Δx	Konzentrationsändeung durch Standard-Zugabe

3 Geräte und Chemikalien

Geräte:

- VA Computrace System 757 (FA. METROHM, SCHWEIZ)
- Druckbehälter mit Stickstoff
- Eppendorfpipetten und Spitzen (10 μL bis 1000 μL)
- Vollpipetten und Pipettierhilfe (10 mL, 25 mL)

Proben/Chemikalien:

- zu untersuchende Wasserprobe
- HNO₃, ultrarein, zur Konservierung von Wasserproben, evtl. auch zur Herstellung von Standardlösungen
- Stickstoff als Spülgas zur Entlüftung (Beseitigung von Sauerstoff)
- Leitelektrolyt: Acetatpuffer, pH= 4,64 $\left(1\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right)$
- Triton-X (als Netzmittel)
- \bullet Multielementcocktail mit Zn-,Cd-,Pb-,Cu-Konzentrationen von je 250 $\frac{mg}{L}$
- Blei-Standardlösung mit $\beta(\mathrm{Pb}^{2+}) = 1\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{L}}$

4 Durchführung

4.1 Versuchsteil 1: Aufnahme und Glättung des Polarogramms

Nach Starten des Computersystems mit der Software 757 VA COMPUTRACE werden die entsprechenden Voreinstellungen des Systems nach der Versuchsanleitung getroffen. Während dessen werden $10\,\mathrm{mL}$ des Acetat-Puffer mit $1\,\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{L}}$ mit deionisierten Wasser auf $100\,\mathrm{mL}$ zu $0.1\,\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{L}}$ aufgefüllt (vgl. mit Gl. 4).

$$n_{\text{vorher}}(\text{Acetatpuffer}) = n_{\text{nachher}}(\text{Acetatpuffer})$$

$$c_{\text{vorher}}(\text{Acetatpuffer}) \cdot V_{\text{vorher}}(\text{Acetatpuffer}) = c_{\text{nachher}}(\text{Acetatpuffer}) \cdot V_{\text{nachher}}(\text{Acetatpuffer})$$

$$c_{\text{nachher}}(\text{Acetatpuffer}) = \frac{V_{\text{vorher}}(\text{Acetatpuffer})}{V_{\text{nachher}}(\text{Acetatpuffer})} \cdot c_{\text{vorher}}(\text{Acetatpuffer})$$

$$= \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \cdot 1 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

$$= 0.1 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

In Folge der Verdünnung des Acetat-Puffers werden davon $25\,\mathrm{mL}$ in das Messgefäß pipettiert, sowie weitere $10\,\mu\mathrm{L}$ Triton-X, um die Oberflächenspannung der Lösung zu reduzieren. Die Messung durch das Messgerät wird mittels Mausklick gestartet und gibt ein Polarogramm aus.

Als nächster Schritt im Versuch wird versucht mittels fünfminütigen Spülens mit Stickstoff den gelösten Sauerstoff zu beseitigen. Ziel ist es dabei das zuvor ausgegebene Polarogramm zu glätten.

Zuletzt werden in diesem Versuchsteil $1000\,\mu\text{L}$ des Multielementcocktails mit je $25\,\frac{\text{g}}{\text{L}}$ zugesetzt und ebenfalls ein Polarogramm davon aufgenommen.

Ein Vergleich und eine Auswertung der ausgegebenen Polarogramme erfolgt unter Abschnitt 5.

4.2 Versuchsteil 2: Identifikation und Quantifizierung des Analyten Blei der Wasserprobe

Die im Polarogramm gezeichneten Peaks entsprechen voraussichtlich den verschiedenen, enthaltenen Metall-Ionen im Messgefäß. Für die eindeutige Bestimmung des Peaks für Blei wird eine $250\,\mu\text{L}$ Blei-Standardlösung zugegeben. Die Peaks der restlichen Ionen bleiben gleich, während der Peak der für die Blei-Ionen steht, steigen wird. Die Peaks der jeweiligen Programme werden zum einen manuell und automatisch vom System bestimmt. Für nachfolgende Bestimmungen werden die Potentiale E_{Start} und E_{Ende} anhand des Peaks von Blei $\pm 0.2\,\text{V}$ festgelegt.

Die Konzentration des Analyten Blei wird im Folgenden mittels Standardadditionsmethode (beschrieben unter Abschnitt 2) durch zweimaliges Aufstocken bestimmt. Dazu wird das Messgefäß gereinigt und der Maßkolben mit der Wasserprobe mit 10 mL unverdünnter Pufferlösung $\left(1\,\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right)$ versetzt und mit destilliertem Wasser aufgefüllt. 25 mL dieser Analysenprobe werden in das gereinigte Messgefäß mit 10 µL Triton-X gegeben. Es werden nun die entsprechenden Parameter im Computerprogramm nach Praktikumsanleitung für zweimaliges Aufstocken mit 200 µL Blei-Standard eingegeben. Die Messung startet ebenfalls per Mausklick und je nach Messfortschritt und Aufforderung des Programms wird der entsprechende Standard manuell zugegeben. Zum Schluss gibt das Programm die quantitativen, gemessenen Daten zusammengefasst in Graphen, Kalibriergeradengleichungen und Konzentration des Analyten aus.

5 Ergebnisse

5.1 Versuchteil 1:

• Interpretation mit Reaktionsgleichung Sauerstoff

$$O_2 + 2e^- + 2H_2O \longrightarrow H_2O_2 + 2OH^-$$
 (5)

$$H_2O_2 + 2e^- \longrightarrow 2OH^-$$
 (6)

- Vergleich Polarogramm geglättet und ungeglättet
 Das ungeglättete Polarogramm (vgl. Abb.3 in gelb) zeigt den Stomstärkeverlauf in Anwesenheit von Sauerstoff. Es treten Peaks auf, wenn die
 Reduktionsreaktionen (5) bei etwa 0 V und (6) bei etwa -1 V ablaufen. Nach
 erfolgter Spülung mit Stickstoff ist der Sauertoff aus der Lösung verschwunden.
 Er kann nicht mehr reduziert werden und stört darum auch nicht mehr das
 Polarogramm (vgl. Abb.3 in schwarz) welches damit als geglättet anzusehen
 ist. Es besitzt nun einen quasi horizontalen Verlauf.
- Zuordnung Begründen

Die Peaks können den enthaltenen Elementen aufgrund ihrer Stellung in der elektrochemischen Spannungsreihe zugeordnet werden. Je edler ein Metall ist, umso höher ist auch das entsprechende Standardelektrodenpotential und umso eher wird es reduziert.

Dder zweite Peak kann besonders sicher dem Blei zugeordnet werden, da durch wissentliche Erhöhung der Bleikonzentration ein größerer Ausschlag erkennbar ist.

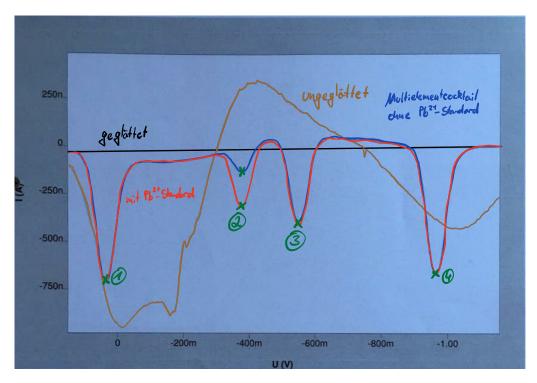


Abb. 3: Strom-Spannungskurven (Polarogramme) des Versuchsteils 1

Tab. 2: Zuordnung der Peaks den Elementen des Multielementencocktails

Element	Kupfer	Blei	Cadmium	Zink
	Cu	Pb	Cd	Zn
Peak	1	2	3	4
StdElektrodenpotential [V]	+0,52	-0,13	-0,40	-0,76

5.2 Versuchsteil 2:

- Polarogramm Probe mit Aufstockungen?
- Quantitative Auswertung des Programms

Berechnung der Blei-Standard-Zugaben-Konzentration:

$$V_{\text{Standard-Zugabe}} \cdot c_{\text{Standard-Zugabe}} = V_{\text{L\"osung}} \cdot c_{\text{L\"osung}}$$

$$c_{\text{L\"osung}} = \frac{V_{\text{Standard-Zugabe}}}{V_{\text{L\"osung}}} \cdot c_{\text{Standard-Zugabe}}$$
 (7)

$$c_{\text{L\"osung},1} = \frac{200 \cdot 10^{-6} \,\text{L}}{25 \cdot 10^{-3} \,\text{L}} \cdot 1000 \,\frac{\text{mg}}{\text{L}}$$
$$= 8 \,\frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$c_{\text{L\"{o}sung},2} = \frac{400 \cdot 10^{-6} \,\text{L}}{25 \cdot 10^{-3} \,\text{L}} \cdot 1000 \,\frac{\text{mg}}{\text{L}}$$
$$= 16 \,\frac{\text{mg}}{\text{L}}$$
(8)

Tab. 3: Messwerte der Messreihe 1

Konzentration der Bleizugabe in $\frac{\frac{mg}{L}}{L}$	Spannung in V	Stromstärke in nA
0	-0,376	-113,0
0	-0,376	-112,5
8	-0,376	-268,2
8	-0,376	-266,6
16	-0,376	-422,8
16	-0,382	-416,0

Tab. 4: Messwerte der Messreihe 2

Konzentration der Bleizugabe in $\frac{mg}{L}$	Spannung in V	Stromstärke in nA
0	-0,382	-129,3
0	-0,382	-139,2
8	-0,382	-286,2
8	-0,382	-282,2
16	-0,382	-425,1
16	-0,382	-424,0

Aufstellen der Kalibriergeraden:

Die Kalibriergerade wird manuell erstellt in dem die die gemessenen Stromstärken der Peaks über dem Konzentrationszuschuss durch die Zugabe der Blei Standardlösung aufgetragen werden. Die Stromstärken für die Y-Achse werden aus den gewonnenen Polarogrammen abgelesen. Hier treten Ablesefehler von etwa \pm 10 nA auf. Die Konzentrationsänderung bei Addition von Standardlösung wird entsprechend der Gleichungen 7 und (8) berechnet. Mittels des Tabellenkalkulationsprogramms LibreOffice Calc wurde eine lineare Regression zur Bestimmung der Kalibriergeradengleichung durchgeführt. Es ergaben sich folgende Funktionsgleichungen:

$$f_1(x) = y = -19,166 \cdot x - 113,19$$

$$f_2(x) = y = -18,144 \cdot x - 135,85$$

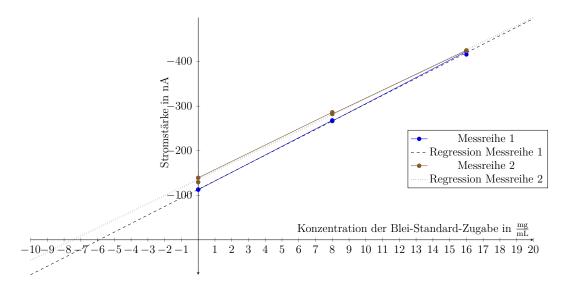


Abb. 4: Berechnete Leitungen in Abhängigkeit von der Konzentration der Blei-Standardzugabe (siehe Tab. 3 und Tab. 4)

Die Nullstellen der Kalibriergeraden liegen bei -5,906 und -7,487. Der Betrag dieser Werte entspricht der Ausgangskonzentration von 5,906 $\frac{mg}{L}$ und 7,487 $\frac{mg}{L}$. Die manuell ermittelten Konzentrationen entsprechen beinahe den computerberechneten Werten.

-> Stark unterschiedliche Messwerte, Neue Betrachtung nötig

Ausreißertests der zusammengefassten Messreihen 1 und 2:

Berechnung des Mittelwertes:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{n=1}^{N} x_n}{N} \tag{9}$$

$$\bar{x} = \frac{-139, 2 - 129, 2 - 113, 0 - 112, 5}{4} = \underline{-123, 5}$$
 (10)

Berechnung der Standardabweichung:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{N} (x_n - \bar{x})^2}{N - 1}}$$
 (11)

$$s = \sqrt{\frac{(-139, 2 + 123, 5)^2 + (-129, 3 + 123, 5)^2 + (-113, 0 + 123, 5)^2 + (-112, 5 + 123, 5)^2}{3}}$$

$$= \underline{11, 3}$$
(12)

Berechnung des Q-Wertes:

$$Q_{\rm emp} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_n - x_1} \tag{13}$$

$$\begin{split} Q_{\text{emp}} &= \frac{-129, 3 - (-139, 2)}{-112, 5 - (-139, 2)} \\ &= 0, 371 \end{split}$$

$$Q_{\rm tab} > Q_{\rm emp} \to {\rm Kein~Ausreißer}$$

 $0,829 > 0,371 \to {\rm Kein~Ausreißer:wahr}$ (14)

Berechnung des G-Wertes:

$$G_{\rm emp} = \frac{|x_{\rm Test} - \bar{x}|}{s} \tag{15}$$

$$G_{\text{emp}} = \frac{|-139, 2 - (-123, 5)|}{11, 3}$$
$$= \underline{1,389}$$

$$G_{\rm tab} > G_{\rm emp} \to {\rm Kein \ Ausreißer}$$

 $1,463 > 1,389 \to {\rm Kein \ Ausreißer : wahr}$ (16)

Tab. 5: Zusammengefasste, aufsteigend sortierte Messwerte mit Mittelwerten und Standardabweichungen

Blei-Standard-Zugabe in $\frac{mg}{L}$	Messwert in nA	Mittelwert	Standardabweichung
0	-139,2		
0	-129,3	-123,5	11,3
0	-113,0		
0	-112,5		
8	-286,2		
8	-282,2	-275,8	8,5
8	-268,2		
8	-266,6		
16	-425,1		
16	-424,0	-422,0	3,5
16	-422,8		
16	-416,0		

Tab. 6: Zusammengefasste, aufsteigend sortierte Messwerte und empirische Q- und G-Werte zur Ausreißerbewertung

Blei-Standard-Zugabe	Messwert in	Q-Wert	Q-Ausreißer	G-Wert	G-Ausreißer?
$\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{L}}$	nA	(Tab=0,829)	?	(Tab=1,463)	
0	-139,2	0,371	Nein	1,389	Nein
0	-129,3	-	Nein	0,513	Nein
0	-113,0	-	Nein	0,929	Nein
0	-112,5	0,019	Nein	0,9723	Nein
8	-286,2	0,204	Nein	1,218	Nein
8	-282,2	-	Nein	0,750	Nein
8	-268,2	-	Nein	0,890	Nein
8	-266,6	0,082	Nein	1,078	Nein
16	-425,1	0,121	Nein	0,882	Nein
16	-424,0	-	Nein	0,571	Nein
16	-422,8	-	Nein	0,233	Nein
16	-416,0	0,747	Nein	1,686	Ja

Neue Kalibrierkurve

Tab. 7: Vergleich der ermittelten Konzentrationen aus manueller und Computergestützter Berechnung

	Computer	Manuell einzeln	Manuell
Messung 1	$5,757 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$	$5,906 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$	
Messung 2	$7,186 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$	$7,487 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$	

Tabelle mit Massen aus Computer Manuell einzeln und Manuell + Mittelwert + Standardabweichung + Vertrauensbereich

• Aliquotierfaktor

Der Aliquotierfaktor dient zur Hochrechnung auf das gesamte Probenvolumen. Die Bleihaltige Probe wurde zuvor auf 100 mL aufgefüllt, wovon jeweils 25 mL in das Messgerät gegeben wurden. Das Ergibt nach Gl.17 einen Aliquotierfaktor von 4.

$$f_A = \frac{100 \,\mathrm{mL}}{25 \,\mathrm{mL}} = 4 \tag{17}$$

EMBERGER TERMINE METROHM 757 VA COMPUTRACE (5.757.0020) Determ. : 05181634_sample.dth Sample ID : sample Creator : Date: 2020-05-18 Time: 16:34:30 Time: Modified by : ---Time: User : Date: 2020-05-18 Time: 16:46:04 ______ Cell volume: 25.000 mL Sample amount: 25.000 mL Method : polarographie_praktikum.mth Title : Polarographic Method Pb-determination Remark1 : 25 ml sample (incl. 2,5 ml acetate buffer (1 mol/1) Remark2 : ______ Substance : Pb Mass conc.: 5.757 mg/L MC.dev. : 0.053 mg/L (0.92%) Comments : 143.937 ug Add.mass : 200.000 ug VR V nA I.mean I.mean Std.Dev. I.delta Comments 1-1 -0.376 -113.0 -112.8 0.373 1-2 -0.376 -112.5 2-1 -0.376 -268.2 -267.4 1.115 -154.6 2-2 -0.376 -266.6 3-1 -0.376 -422.8 -419.4 4.769 -152.0 3-2 -0.382 -416.0 Substance Calibr. Y.reg/offset Slope Std.Dev. ----------Pb std.add. -1.128e-007 -1.959e-005 3.726e-010 Solutions

No. Content Vol. (mL) Predose (mL)

Final results +/- Res. dev. % Comments

Pb:
Blei = 0.006 g/L 0.000 0.924


METROHM 757 VA COMPUTRACE (5.757.0020)


Determ. : 05181634_sample.dth
Sample ID : sample
Creator : ECO_DEFAULT I Date : 2020-05-18 Time: 16:34:30 Time:

Modified by : ---Date :

Date : 2020-05-18 Time: 16:46:04

Polarographic Method Pb-determination

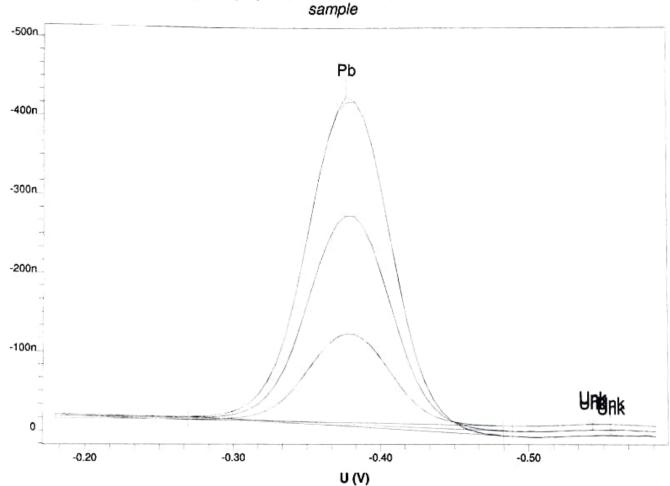

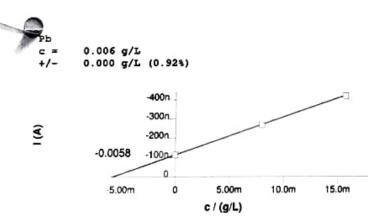

Determ. : 05181653_sample.dth Sample ID : sample Creator Date: 2020-05-18 Time: 16:53:50 Modified by : ---Date : User : Time: Date : 2020-05-18 Time: 17:04:13

Cell volume: 25.000 mL Sample amount: 25.000 mL

Method : polarographie_praktikum.mth

Title : Polarographic Method Pb-determination

Remark1 : 25 ml sample (incl. 2,5 ml acetate buffer (1 mol/1)

Remark2:

Substance : Pb Comments

(4.36%)

Mass conc.: 7.186 mg/L MC.dev.: 0.313 mg/L Mass: 179.646 ug Add.mass: 200.000 ug

VR V nA I.mean Std.Dev. I.delta Comments 1-1 -0.382 -129.3 -134.2 7.030 1-2 -0.382 -139.2 2-1 -0.382 -286.2 -284.2 2.793 -150.0 2-2 -0.382 -282.2 3-1 -0.382 -425.1 -424.5 0.790 -140.3 3-2 -0.382 -424.0

Substance Calibr. Y.reg/offset Slope Std.Dev. ----------Pb std.add. -1.345e-007 -1.871e-005 3.873e-009

Solutions

No. Content Vol. (mL) Predose (mL)

Final results +/- Res. dev. % Comments _____

Pb: = 0.007 g/L 0.000 4.357 Blei

METROHM 757 VA COMPUTRACE (5.757.0020)

Determ. : 05181653_sample.dth


Sample ID : sample


: ECO_DEFAULT Creator Date : 2020-05-18 Time: 16:53:50

Modified by : ---

Date : Time: Date : 2020-05-18 Time: 17:04:13

Polarographic Method Pb-determination sample

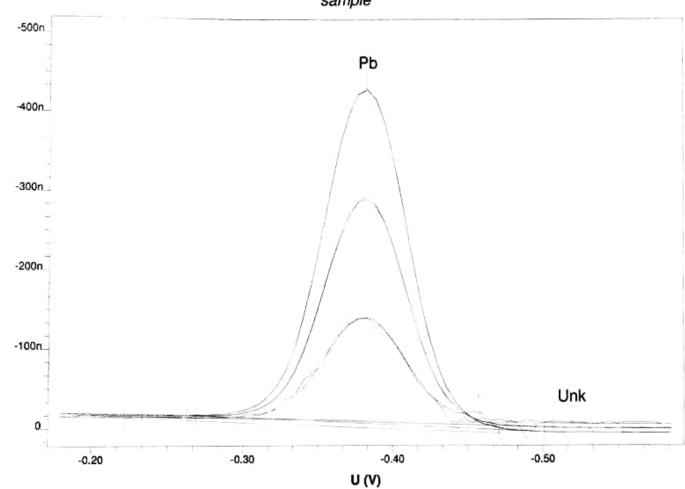

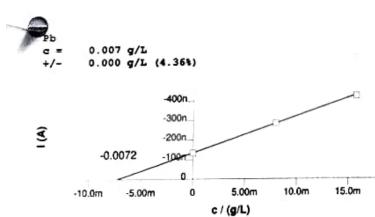

6 Diskussion

7 Fehlerbetrachtung

Fehler sind bei der Pipettierung der Lösungen aufgetreten. Zum ersten wurde abwechselnd von zwei Personen pipettiert und zum zweiten besitzen die verwendeten Vollpipetten Toleranzen. Die Toleranzen belaufen sich auf $\pm 0,03\,\mathrm{mL}$ für die $10\,\mathrm{mL}$ -Pipette und auf $\pm 0,045\,\mathrm{mL}$ für die $25\,\mathrm{mL}$ -Pipette. Die Lösungen waren nicht ständig agitiert, wodurch es zu absetzungsunterschieden und konzentrationsunterschieden innerhalb der Lösung gekommen sein könnte. Die Reinheit des Verwendeten Quecksilbers wikt sich ebenfalls auf das Messergebnis aus. Eine Spülzeit von $30\,\mathrm{s}$ wurde als ausreichend angenommen. Längere Spülzeiten könnten noch mehr Sauerstoff austreiben und den Störenden einfluss weiter verringern.

Die Konzentrationen der bereitgestellten Lösungen könnten vom erwarteten Wert abweichen. Das Alter der Lösungen ist unbekannt. Trotz vorherigem spülens

Auch das Messgerät Metrohm 757 VA Computrace unterliegt gewissen Toleranzen.

Ablesefehler aus dem Polarogramm sind in die erstellung der manuellen Kalibriergerade eingeflossen.

Anhang

Literatur

[1] Brehm, Ingrid: *Polarographie*. Version: 2004. https://roempp.thieme.de/lexicon/RD-16-02953, Abruf: 28.05.2020