
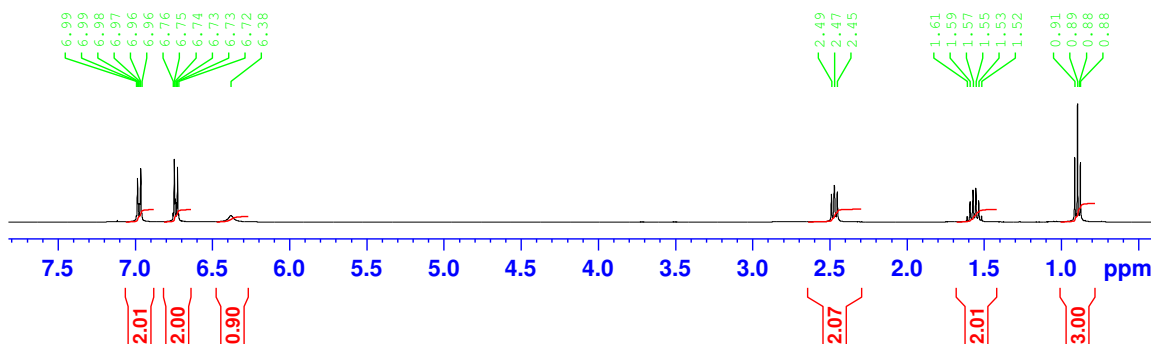
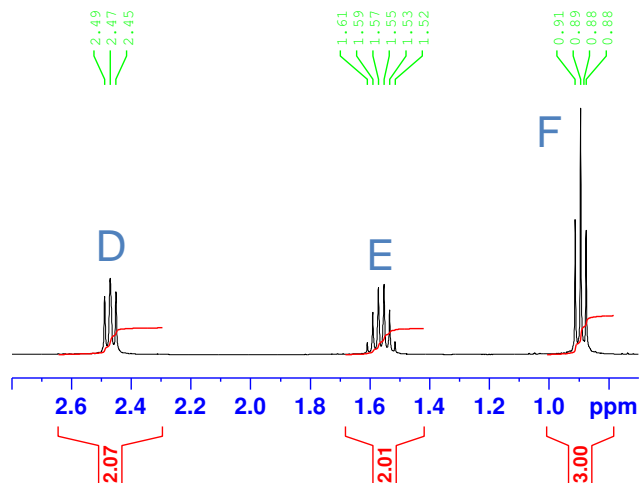


<sup>1</sup>H

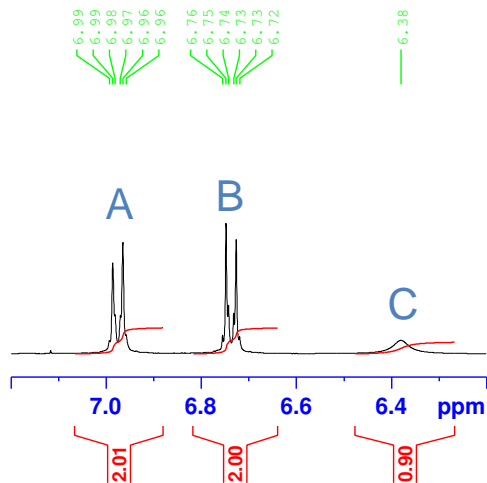

Current Data Parameters  
NAME Prak21  
EXPNO 2  
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters  
Date\_ 20210624  
Time 8.33 h  
INSTRUM spect  
PROBHD Z108618\_0282 (   
PULPROG zg30  
TD 65536  
SOLVENT CDCl3  
NS 1  
DS 0  
SWH 8223.685 Hz  
FIDRES 0.250967 Hz  
AQ 3.9845889 sec  
RG 14.2  
DW 60.800 usec  
DE 6.50 usec  
TE 303.2 K  
D1 0 sec  
TD0 1  
SF01 400.2324716 MHz  
NUC1 <sup>1</sup>H  
P1 15.00 usec  
PLW1 19.99900055 W

F2 - Processing parameters  
SI 65536  
SF 400.2300661 MHz  
WDW EM  
SSB 0  
LB 0.30 Hz  
GB 0  
PC 1.00