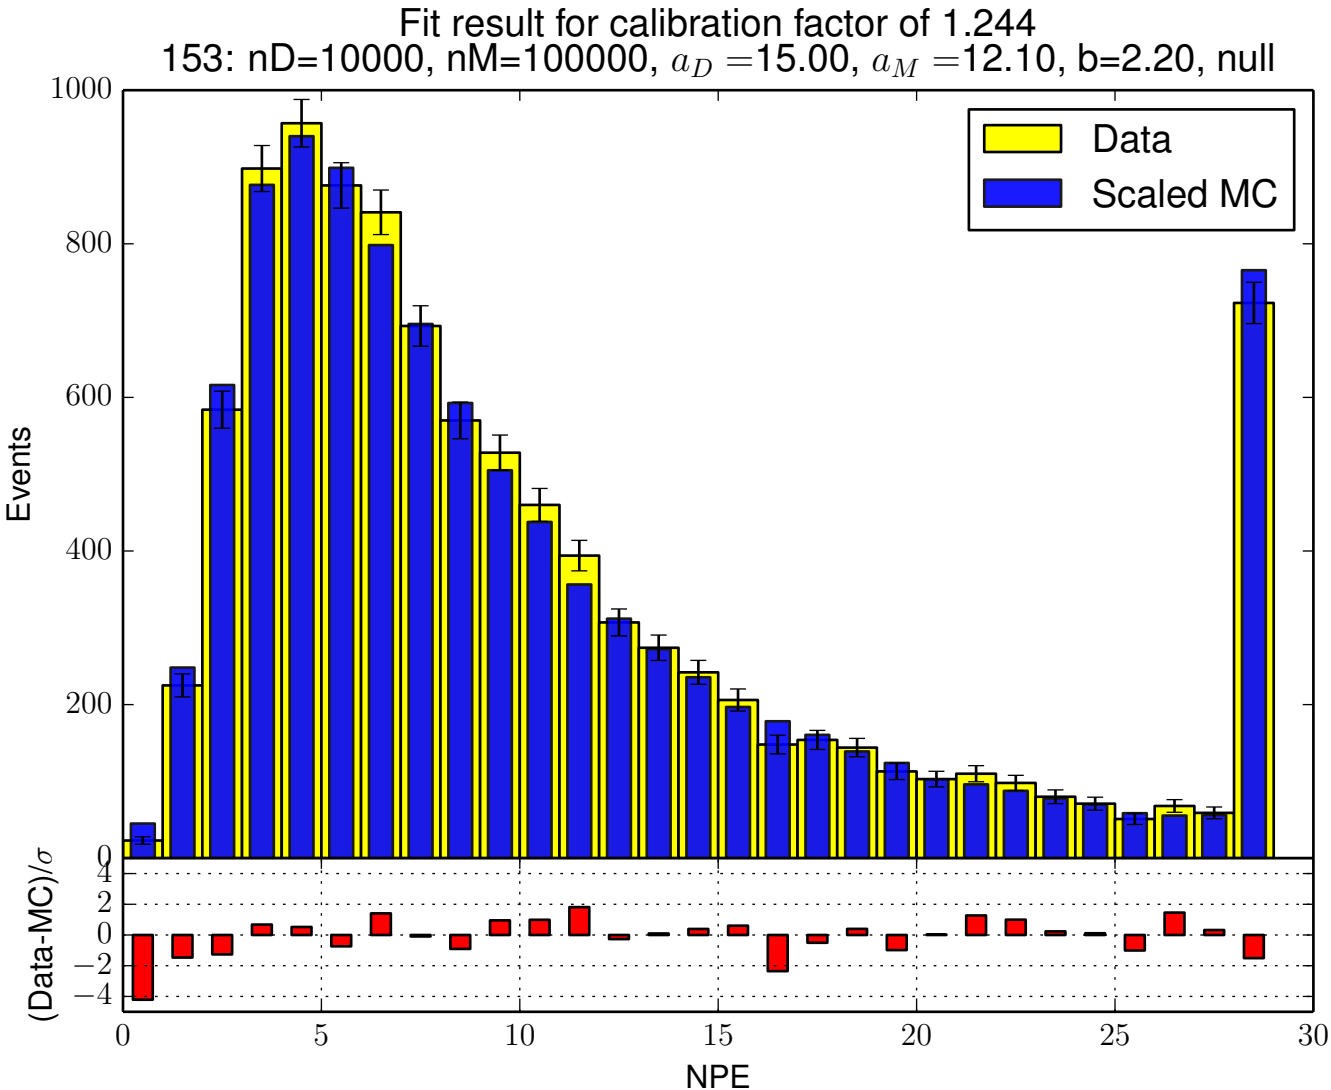
Fit result for calibration factor of 1.244
153: nD=10000, nM=100000, a_D =15.00, a_M =12.10, b=2.20, null
Data
Scaled MC
Events
(Data-MC)/σ
NPE
1000
800
600
400
200
0
4
2
0
−2
−4
0
5
10
15
20
25
30