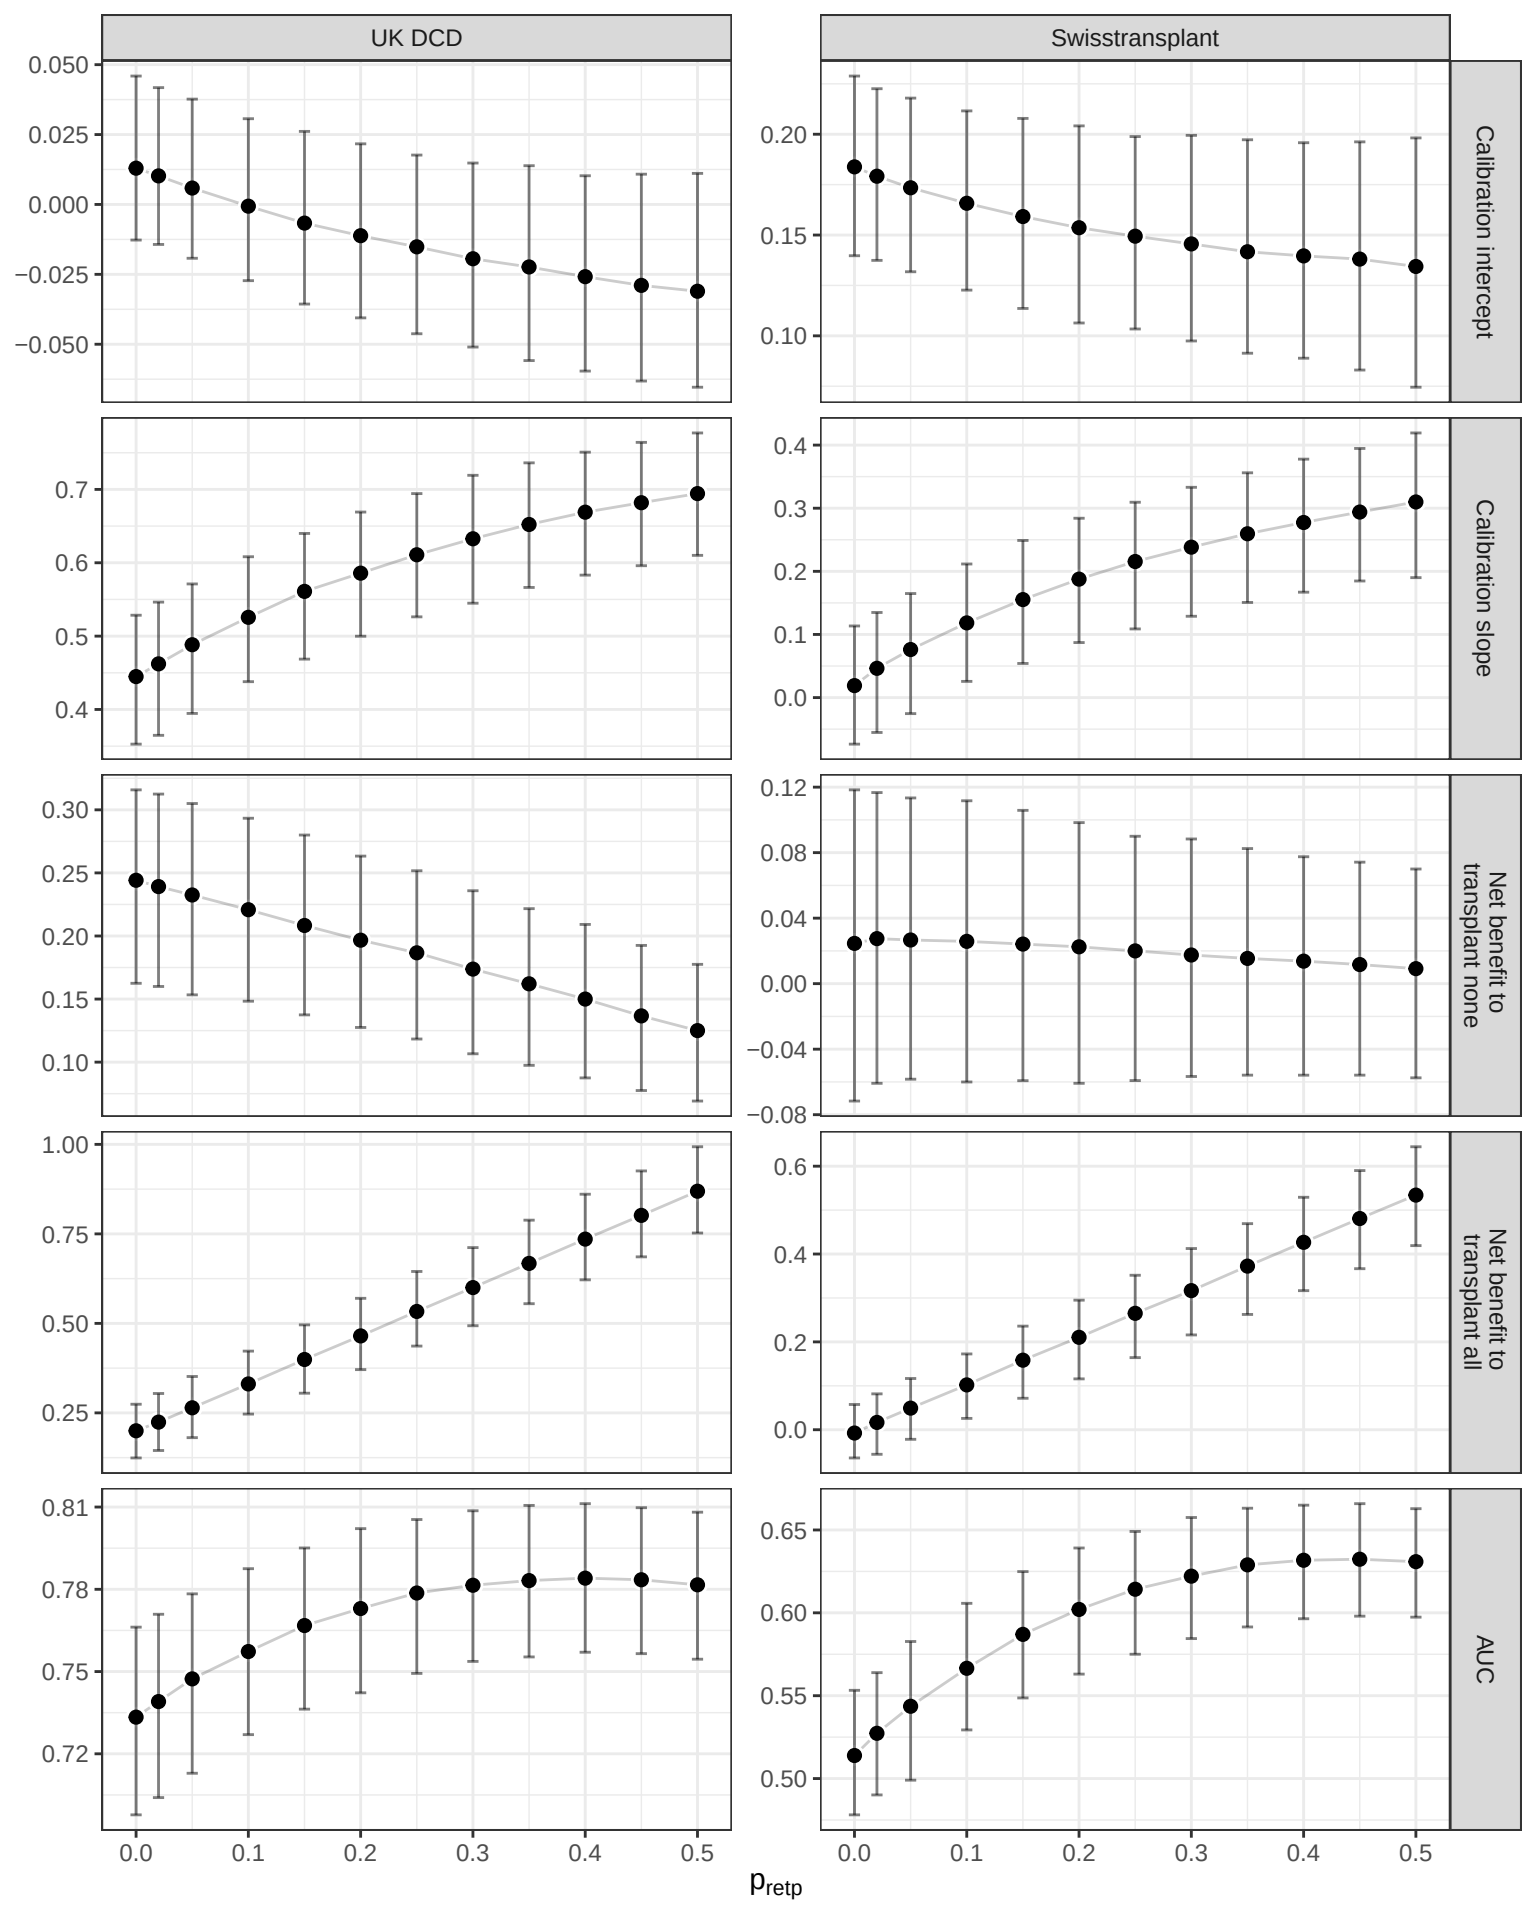
UK DCD
Swisstransplant
Calibration intercept
Calibration slope
Net benefit to transplant none
Net benefit to transplant all
AUC
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
0.20
0.15
0.10
0.7
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.12
0.08
0.04
0.00
−0.04
−0.08
1.00
0.75
0.50
0.25
0.6
0.4
0.2
0.0
0.81
0.78
0.75
0.72
0.65
0.60
0.55
0.50
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
p_{retp}