


Raphex

2023

Dalila Mendonça

1. Para radiação eletromagnética, o comprimento de onda, λ , pode ser encontrado usando a relação $\lambda = c / \nu$, onde $c = 3 \times 10^8$ m/s é a velocidade da luz e ν é a frequência eletromagnética.
2. Na mecânica clássica, a energia cinética (KE) é dada por $1/2 m \cdot v^2$. Se a massa é 10 kg e a velocidade é 5 m/s, $KE = 1/2 (10 \text{ kg}) (5 \text{ m/s})^2 = 125 \text{ kg m}^2/\text{s}^2 = 125 \text{ J}$.
3. Dose equivalente é a quantidade que representa a medida do dano biológico ao tecido vivo como resultado da exposição à radiação, e a unidade SI de dose equivalente é o sievert (Sv). Tanto o sievert quanto o gray são equivalentes a J/kg, mas diferem um do outro por um fator adimensional (fator de qualidade Q) que explica o efeito biológico do tipo de radiação. Rad e rem são as unidades do sistema CGS para dose absorvida e dose equivalente, respectivamente. O roentgen (R) é uma unidade de exposição à radiação antiga.
4. O principal isótopo de um átomo de hidrogênio consiste em um elétron e um núcleo que contém apenas um próton. Se o átomo é ionizado e perde seu elétron, a única coisa que resta é um próton.
5. Como a energia equivalente de 1 amu é 931 MeV, e a massa total das partículas finais é maior que a das partículas iniciais (0.001281 amu), a reação é endoenergética (endotérmica), ou seja, deve-se aplicar pelo menos 1,19 MeV de energia para a reação ocorra.
6. No decaimento beta menos, um nêutron é convertido em próton, elétron e anti-neutrino.
7. O decaimento do pósitron e a captura de elétrons podem ocorrer quando o núcleo tem um excesso de prótons, portanto esses processos de decaimento competem entre si.
8. O decaimento beta é mediado pela força fraca no Modelo Padrão da física de partículas.
9. A qualidade do feixe é uma especificação da energia de um feixe de radiação. A qualidade do feixe de raios X diagnósticos é definida pela camada semi-redutora (HVL) usando uma geometria de feixe estreito. Irradiadores de raios gama como ^{60}Co ou ^{137}Cs são definidos a partir da energia média da radiação gama emitida, e a qualidade do feixe do acelerador linear terapêutico é definida pela porcentagem de dose de profundidade PDP.
10. A probabilidade de produção de raios X bremsstrahlung aumenta com o aumento da energia do elétron incidente. Com o aumento da energia do elétron, a distribuição dos raios-x bremsstrahlung também se torna mais apontada para frente, em outras palavras, mais focada na mesma direção que a direção de incidência do elétron sobre o alvo. É por isso que um alvo de transmissão é usado em aceleradores lineares médicos.
11. O feixe que sai de um tubo de raios X superficial será polienérgico. A adição de filtração removerá os fótons do feixe, diminuindo a fluência do feixe. Quanto aos fótons que interagem com o filtro, os fótons de baixa energia são preferencialmente absorvidos, resultando em uma energia de feixe média mais alta.


12. A energia máxima de raios X corresponde à tensão de pico do tubo (kVp). Os picos no espectro, indicados como B e C na figura, correspondem às energias de raios X características para o material alvo. A área sob a curva representa o número total de fótons medidos. A energia mínima de raios X é uma função da filtração inerente e adicional do tubo de raios X. Sem filtração, as energias de raios X muito próximas de zero estariam no espectro.

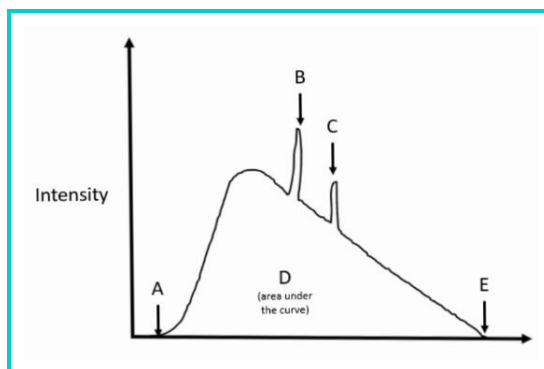

13. O copo de focalização “focusing cup” é carregado negativamente para direcionar os elétrons carregados negativamente para longe do cátodo onde o “copo” está localizado e do qual os elétrons são emitidos em direção ao ânodo.
14. As Klystrons amplificam as micro-ondas que são alimentadas no guia de ondas de aceleração, onde fornecem a energia usada para acelerar os elétrons gerados pelo canhão de elétrons.
15. Como o posicionamento correto das partes mecânicas de um linac é extremamente importante para a entrega precisa da radiação, os parâmetros mais críticos do linac são medidos por dois dispositivos calibrados independentes um do outro “secondary positioning readout devices”. Os dispositivos de leitura secundários são comumente utilizados para confirmar a posição do gantry, colimador, jaws e MLCs do acelerador. Se as leituras das posições primária e secundária discordarem, o linac gerará um intertravamento e interromperá a administração do tratamento.
16. A maioria das lâminas dos MLCs são projetadas com uma extremidade curvada da lâminas para produzir uma penumbra semelhante, independentemente da posição da lâminas. Um projeto alternativo é ter uma extremidade da lâminas plana, porém o MLC precisará se mover em arco acompanhando a divergência do feixe.
17. Um linac clínico é um acelerador de elétrons. Assim, tanto para entrega de elétrons quanto para fótons, um canhão de elétrons é usado para injetar elétrons na guia de onda aceleradora. Os elétrons são acelerados para energias de MeV. Se o modo de entrega for o feixe de elétrons, uma folha espalhadora é colocada no caminho do feixe para espalhar o feixe de elétrons de forma que eles possam cobrir o alvo. Se o modo de entrega for feixes de fótons, um alvo é colocado no caminho do feixe estreito de elétrons para que os elétrons interajam e criem fótons via bremsstrahlung. Esses fótons então viajam através de um filtro aplanador (ou não caso seja FFF) para cobrir o alvo com um feixe homogêneo (plano). Na entrega de fótons ou elétrons, uma câmara monitora é usada para medir o output da radiação do linac.
18. Uma guia de ondas preenchida com micro-ondas é usado para acelerar elétrons na faixa de megavoltagem. As guias de onda podem ser usados com ondas estacionárias ou progressivas. Devido à potencial formação de arcos elétricos, a aplicação direta de milhões de elétron-volts entre o cátodo e o ânodo de um tubo de raios X não é normalmente empregada. O campo magnético do ímã de flexão (bending magnet) muda a direção dos elétrons em vez de sua energia. A cavidade buncher é um componente de uma klystron que ajuda a gerar a energia de micro-ondas. (Arcos elétricos são fenômenos que ocorrem quando uma corrente elétrica flui através do ar ou de outro meio isolante. Eles são caracterizados por uma descarga elétrica visível que forma um arco luminoso entre dois pontos de alta tensão. Quando a tensão

elétrica em um sistema excede a capacidade de isolamento do ar ou de outro meio dielétrico presente, ocorre uma ruptura na barreira isolante e um arco elétrico é formado. Essa ruptura pode acontecer devido a um curto-circuito, falha na isolação ou por outros motivos.)

19. A distância da fonte de radiação à superfície do paciente (SSD) é medida pelo indicador óptico de distância (ODI). A SAD é a distância da fonte ao isocentro da máquina e é fixo para uma determinada máquina. Uma ponteira frontal pode ser usada para identificar a localização física do isocentro. O tamanho do campo luminoso pode ser medido usando papel quadriculado, e os campos luminosos e radiativos devem ser coincidentes. Essa coincidência pode ser verificada por meio de um filme de raio-x.
20. Uma mesa com seis graus de liberdade pode se mover nas direções de translação lateral, vertical e longitudinal, bem como nas rotações de inclinação pitch, rotação roll e rotação yaw. Uma roll é uma rotação ao longo do plano axial do paciente, uma pitch é uma rotação ao longo do plano sagital do paciente e uma rotação guinada yaw - também conhecida como ângulo de mesa - é uma rotação ao longo do plano coronal do paciente, conforme ilustrado no diagrama.

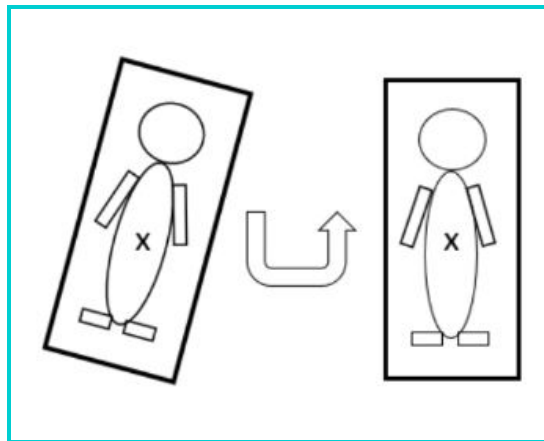

21. Como o coeficiente de atenuação do feixe é inversamente proporcional à energia do feixe, a camada semi-redutora [$HVL = (\ln 2)/\mu$] aumenta pois a energia média do feixe transmitido aumenta, ou seja, o feixe torna-se cada vez mais duro à medida que a espessura do absorvedor aumenta e portanto a segunda HVL é maior porque o μ se torna menor.
22. O nome da interação entre um fóton e um elétron atômico onde o fóton transfere toda a sua energia para o elétron e esse elétron é ejetado do átomo é “efeito fotoelétrico”. No caso de uma ionização da camada interna, além da ejeção do fotoelétrico, também haverá emissão subsequente de raios-x característicos ou elétrons Auger à medida que os elétrons orbitais com maior energia caem para preencher a camada interna. O espalhamento Compton é uma interação entre um fóton e um elétron aproximadamente livre, ou seja, um elétron com energia de ligação desprezível. Após uma interação Compton, o fóton espalhado e o elétron compartilham a energia que foi inicialmente transportada pelo fóton incidente.
23. Em uma interação de espalhamento Compton entre um fóton e um elétron, o fóton espalhado sempre reterá pelo menos 256 keV de energia. Nesta situação, o fóton é retroespalhado e o elétron é projetado na direção de propagação do fóton incidente.
24. Em uma interação de produção de pares, um fóton interage com o campo de um núcleo. Como resultado da interação, o fóton desaparece e um par elétron/pósitron é criado. A energia total da massa de repouso de um elétron e um pósitron é 1,022 MeV. Para respeitar a conservação de energia e momento, essa interação não pode ocorrer a menos que o fóton incidente tenha uma energia de pelo menos 1,022 MeV.
25. Partículas diretamente ionizantes são partículas carregadas que, ao viajarem através de um meio, podem ionizar os átomos dentro do meio por meio de interações mediadas através da força eletromagnética

existente em partículas carregadas. Partículas indiretamente ionizantes não possuem carga. Eles precisam ter uma interação com o meio que cria uma partícula carregada, que posteriormente deposita energia por meio de interações de força eletromagnética.

26. A geometria de feixe estreito mede apenas a atenuação do feixe primário. Quaisquer fótons secundários ou dispersos não podem ser incluídos na medição. Diz-se que uma medição de atenuação que inclui fótons primários, secundários e dispersos é realizada sob condições de feixe largo.
27. A unidade Hounsfield é calculada por: $HU = [(\mu_{meio} - \mu_{agua})/\mu_{agua}] \times 1000$; portanto um meio com $HU = 1000$ tem $\mu_{meio} = 2\mu_{agua}$.
28. A lei do inverso do quadrado afirma que conforme você aumenta a distância, r , de uma fonte pontual de radiação, a intensidade da radiação diminui em $1/r^2$.
29. Exposição, KERMA e TERMA são todos definidos para partículas não carregadas, mas não para partículas carregadas. A dose é definida para partículas carregadas e não carregadas. CEMA (Converted Energy per unit MAss -); TERMA (Total Energy Release per unit MAss); KERMA (Kinetic Energy Release per unit MAss)
30. KERMA é definido como a quantidade de energia transferida de partículas não carregadas incidentes para partículas carregadas em um meio. TERMA é a energia total transferida das partículas não carregadas incidentes para todas as partículas (fótons e elétrons) no meio. Dose é a energia absorvida em uma unidade de massa, exposição é a quantidade de carga liberada no ar e fluência é o número de partículas por unidade de área. CEMA Descreve a transferência de energia de partículas carregadas primárias para partículas carregadas secundárias (raios δ);
31. O valor esperado do número de partículas que atingem uma esfera finita em torno de um ponto é a definição de fluência. A fluência de energia é semelhante, exceto que corresponde ao valor esperado da energia total transportada por todas as partículas que atingem uma esfera finita em torno de um ponto. O fluxo e o fluxo de energia são a taxa de variação no tempo da fluência e da fluência de energia, respectivamente. A energia radiante é definida apenas como a soma da energia das partículas que foram emitidas, transferidas ou recebidas.
32. Os diodos são normalmente usados sem tensão de polarização. Um diodo mede um sinal muito forte em relação ao ar (utilizado na cavidade de uma câmara de ionização para medir a dose) porque a densidade do silício é aproximadamente 1.900 vezes a do ar, e a energia necessária para criar um par elétron/buraco no silício é de 3,5 eV, aproximadamente 10 vezes menos que a energia necessária no ar ($\sim 33,97$ eV) . Os diodos são dosímetros relativos e têm uma dependência direcional maior do que as câmaras de ionização, no entanto, esses fatores não contribuem para as razões pelas quais os diodos mediriam sinais maiores do que as câmaras de ionização para a mesma dose de radiação e mesmo tamanho do detector.
33. Em relação a uma câmara Farmer de 0,6 cc, uma câmara de 0,03 cc terá melhor resolução espacial e mais ruído. Uma câmara de 0,03 cc é muito menor que uma câmara Farmer e, portanto, terá resolução espacial melhorada, o que resultará em um desempenho superior para medições em campos pequenos. No entanto, esta câmara também experimentará mais ruído nas medidas, e é por isso que, para uma medição de saída em um campo de 10 cm x 10 cm, a câmara Farmer seria uma opção melhor. Porque a câmara de 0.03 cc possui mais ruído nas medidas?
34. Na faixa de energia de megavoltagem, o espalhamento Compton é a interação predominante para os fótons. Portanto, para imitar o tecido, o material do phantom deve corresponder à seção de choque do Compton para o tecido, o que ocorre se a densidade de elétrons for compatível.
35. Fótons com comprimentos de onda na faixa da luz visível são liberados quando um TLD é aquecido após ser exposto à radiação ionizante. A intensidade da luz emitida é tipicamente medida por um tubo fotomultiplicador.

36. O adendo do AAPM Task Group 51 observa que a recombinação iônica contabilizada no fator de recombinação P_{ion} é aumentada para feixes com maior dose por pulso, como ocorre nos feixes FFF.
37. Ao considerar detectores para medida da dose na superfície do paciente: Os detectores MOSFET de baixa voltagem podem ser usados na clínica para medir a dose de radiação *in vivo* para qualquer modalidade (fótons, elétrons, hadrons. . .) e eles possuem espessura insignificante. As câmaras de ionização usam alta voltagem, o que seria inseguro para o paciente. Medidores de levantamento (Geiger) detectam radiação, mas são grandes e não podem fornecer informações de dosimetria *in vivo*. O filme radiocrômico precisa ser cuidadosamente manuseado e calibrado, tornando-o muito difícil de usar para dosimetria *in vivo*.
38. Uma câmara de ionização de ar livre mede a quantidade de exposição, que é uma medida da carga elétrica produzida quando um feixe de fótons interage com uma massa conhecida de ar. Por definição, a câmara deve conter ar e, portanto, não seria mantida no vácuo. Não há exigência de que o feixe de fótons incidente seja monoenergético, embora por razões práticas relacionadas à atenuação e espalhamento e a consequente faixa de elétrons secundários, uma câmara de ionização ao ar livre não possa medir energias de fótons maiores que aproximadamente 3 MeV. Uma câmara de ionização de ar livre usa um campo elétrico uniforme em sua região de coleta para coletar e medir toda a carga liberada. Um tubo de raios X é frequentemente submerso em um banho de óleo para dissipação de calor, mas uma câmara de ionização ao ar livre não esquentaria como um tubo de raios X e não é colocada em um banho de óleo.
39. O eletrodo de proteção “guard electrode” de uma câmara de ionização é usado para isolar a câmara de ionização para que as cargas criadas no volume ativo não escapem. Como resultado, a colocação do eletrodo de guarda define o limite do volume ativo.
40. Câmaras de ionização, diodos, contadores proporcionais, contadores Geiger-Muller são lidos instantaneamente no momento da irradiação usando um eletrômetro ou dispositivo de leitura. Os OSLDs são coletados após serem irradiados e colocados em um dispositivo específico que lê a quantidade de luz visível liberada quando o cristal é estimulado com uma luz de laser. Essa quantidade de luz visível emitida pode estar relacionada à dose absorvida pelo OSLD.
41. Em um tratamento de neuroeixo, para combinar a divergência dos campos cranianos com a divergência dos campos da coluna, os dois ângulos θ_{coll} e θ_{couch} são determinados a partir das seguintes relações:

$$\theta_{coll} = \arctan\left(\frac{1/2L_1}{100}\right)$$

$$\theta_{couch} = \arctan\left(\frac{1/2L_2}{100}\right)$$

onde L_1 é o comprimento do campo da coluna e L_2 é o comprimento do campo cranial. **Revisar essa relação para determinar se é o campo na SAD ou SSD ou SPD**

42. Se dois campos posteriores da coluna forem usados para cobrir o comprimento da coluna vertebral, como em um tratamento de neuroeixo, esses campos devem se cruzar em um ponto localizado anteriormente à medula espinhal para evitar regiões de alta dose dentro da medula. Isso é verdade mesmo quando é utilizada uma técnica de feathering (diluição, difusão.. faça a menor ideia do nome disso em pt-Br).
43. A largura da penumbra geométrica em qualquer profundidade da superfície de um paciente é dada por

$$P_d = s(SSD + d)SD/SSD$$

onde s é a dimensão da fonte, SSD é a distância da fonte à superfície e SD é a distância fonte-diafragma (colimador)

44. A relação tecido-máximo, TMR, é independente da distância fonte-superfície, SSD e, portanto, independente da queda da fluência com inverso do quadrado da distância até a fonte.

45. Para feixes de fótons isocêntricos, a fórmula de cálculo de MU é: $MU = (\text{dose por fração} / \text{número de campos}) / [\text{saída de referência} \times Sc(CS) \times Sp(FS) \times TMR(d, FS)]$, onde CS é o colimador configuração e FS é o tamanho do campo irradiado na profundidade d. Como não há bloqueio, o FS no isocentro é equivalente ao CS. O CS e FS a usar para este campo assimétrico podem ser encontrados usando a regra de área/parâmetro: $4 \times (\text{área}) / (\text{perímetro}) = 4 \times (6)(12) / [2 \times (6 + 12)] = 8$, então você procuraria Sc, Sp e TMR para um campo de 8 cm x 8 cm. $MU = (400 / 2) / (1,0 \times 0,987 \times 0,990 \times 0,871) = 235$.
46. Se os MLCs fossem utilizados para adicionar bloqueio nos campos de tratamento, mas nenhum outro parâmetro fosse alterado o Sc permaneceria o mesmo e Sp diminuiria. Sc depende da posição dos jaws do colimador e, portanto, não mudaria. Sp depende do tamanho efetivo do campo bloqueado e diminui conforme o tamanho do campo diminui.
47. Em relação à dose de superfície de raios-x MV:
- ★ os sistemas de planejamento de tratamento geralmente não calculam com precisão a dose de superfície;
 - ★ os elétrons produzidos no cabeçote do linac são um grande componente da dose de superfície;
 - ★ a dose de superfície de um feixe de 15 MV é menor do que a de um feixe de 6 MV;
 - ★ a dose de superfície aumenta com o tamanho do campo;
 - ★ Um feixe sem filtro aplanador (FFF) terá uma dose superficial mais alta do que um feixe com filtro aplanador com o mesmo potencial de ionização para a maioria dos tamanhos de campo. O que é o potencial de ionização e porque eles sendo o mesmo para o feixe FFF e o feixe FF a dose na superfície será a mesma?
48. A PDP a 10 cm de um feixe FFF de 6 MV é aproximadamente 3% menor em comparação com um feixe FF de 6 MV. O filtro aplanador remove fótons de baixa energia do feixe causando seu endurecimento, ou seja, aumenta a energia média do feixe plano em relação a um feixe que não utiliza um filtro aplanador (FFF). O resultado do feixe plano mais endurecido é a diminuição da atenuação com a profundidade e um aumento na PDP quando comparada ao feixe FFF com mesma energia nominal.
49. À medida que o SSD aumenta, o PDD aumenta devido à diferença no componente quadrado inverso do PDD. O fator de correção, conhecido como fator Mayneord, que converte curvas PDD de um SSD para outro, é:
- $$F = \left(\frac{SSD_2 + d_m}{SSD_1 + d_m} \right)^2 \cdot \left(\frac{SSD_1 + d}{SSD_2 + d} \right)^2$$
50. A densidade eletrônica do pulmão é apenas aproximadamente 30% da densidade da água, resultando em uma menor absorção e um efeito de build-down (desacumulo? hehe) para feixes de MV. Todos os outros locais do corpo são compostos de tecidos com densidades de elétrons muito mais próximas da água de modo que as correções de heterogeneidade causem menos efeito no número de MU quando comparado ao pulmão.
51. A TMR para fótons de 15 MV muda em aproximadamente 2,5% por cm. Como a profundidade é maior, a dose entregue será menor do que a calculada. A mudança na dose do isocentro é, portanto, $(2,5\%/cm \times 3 \text{ cm}) / 4$, ou aproximadamente 2%.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.

57.

58.

59.

60.