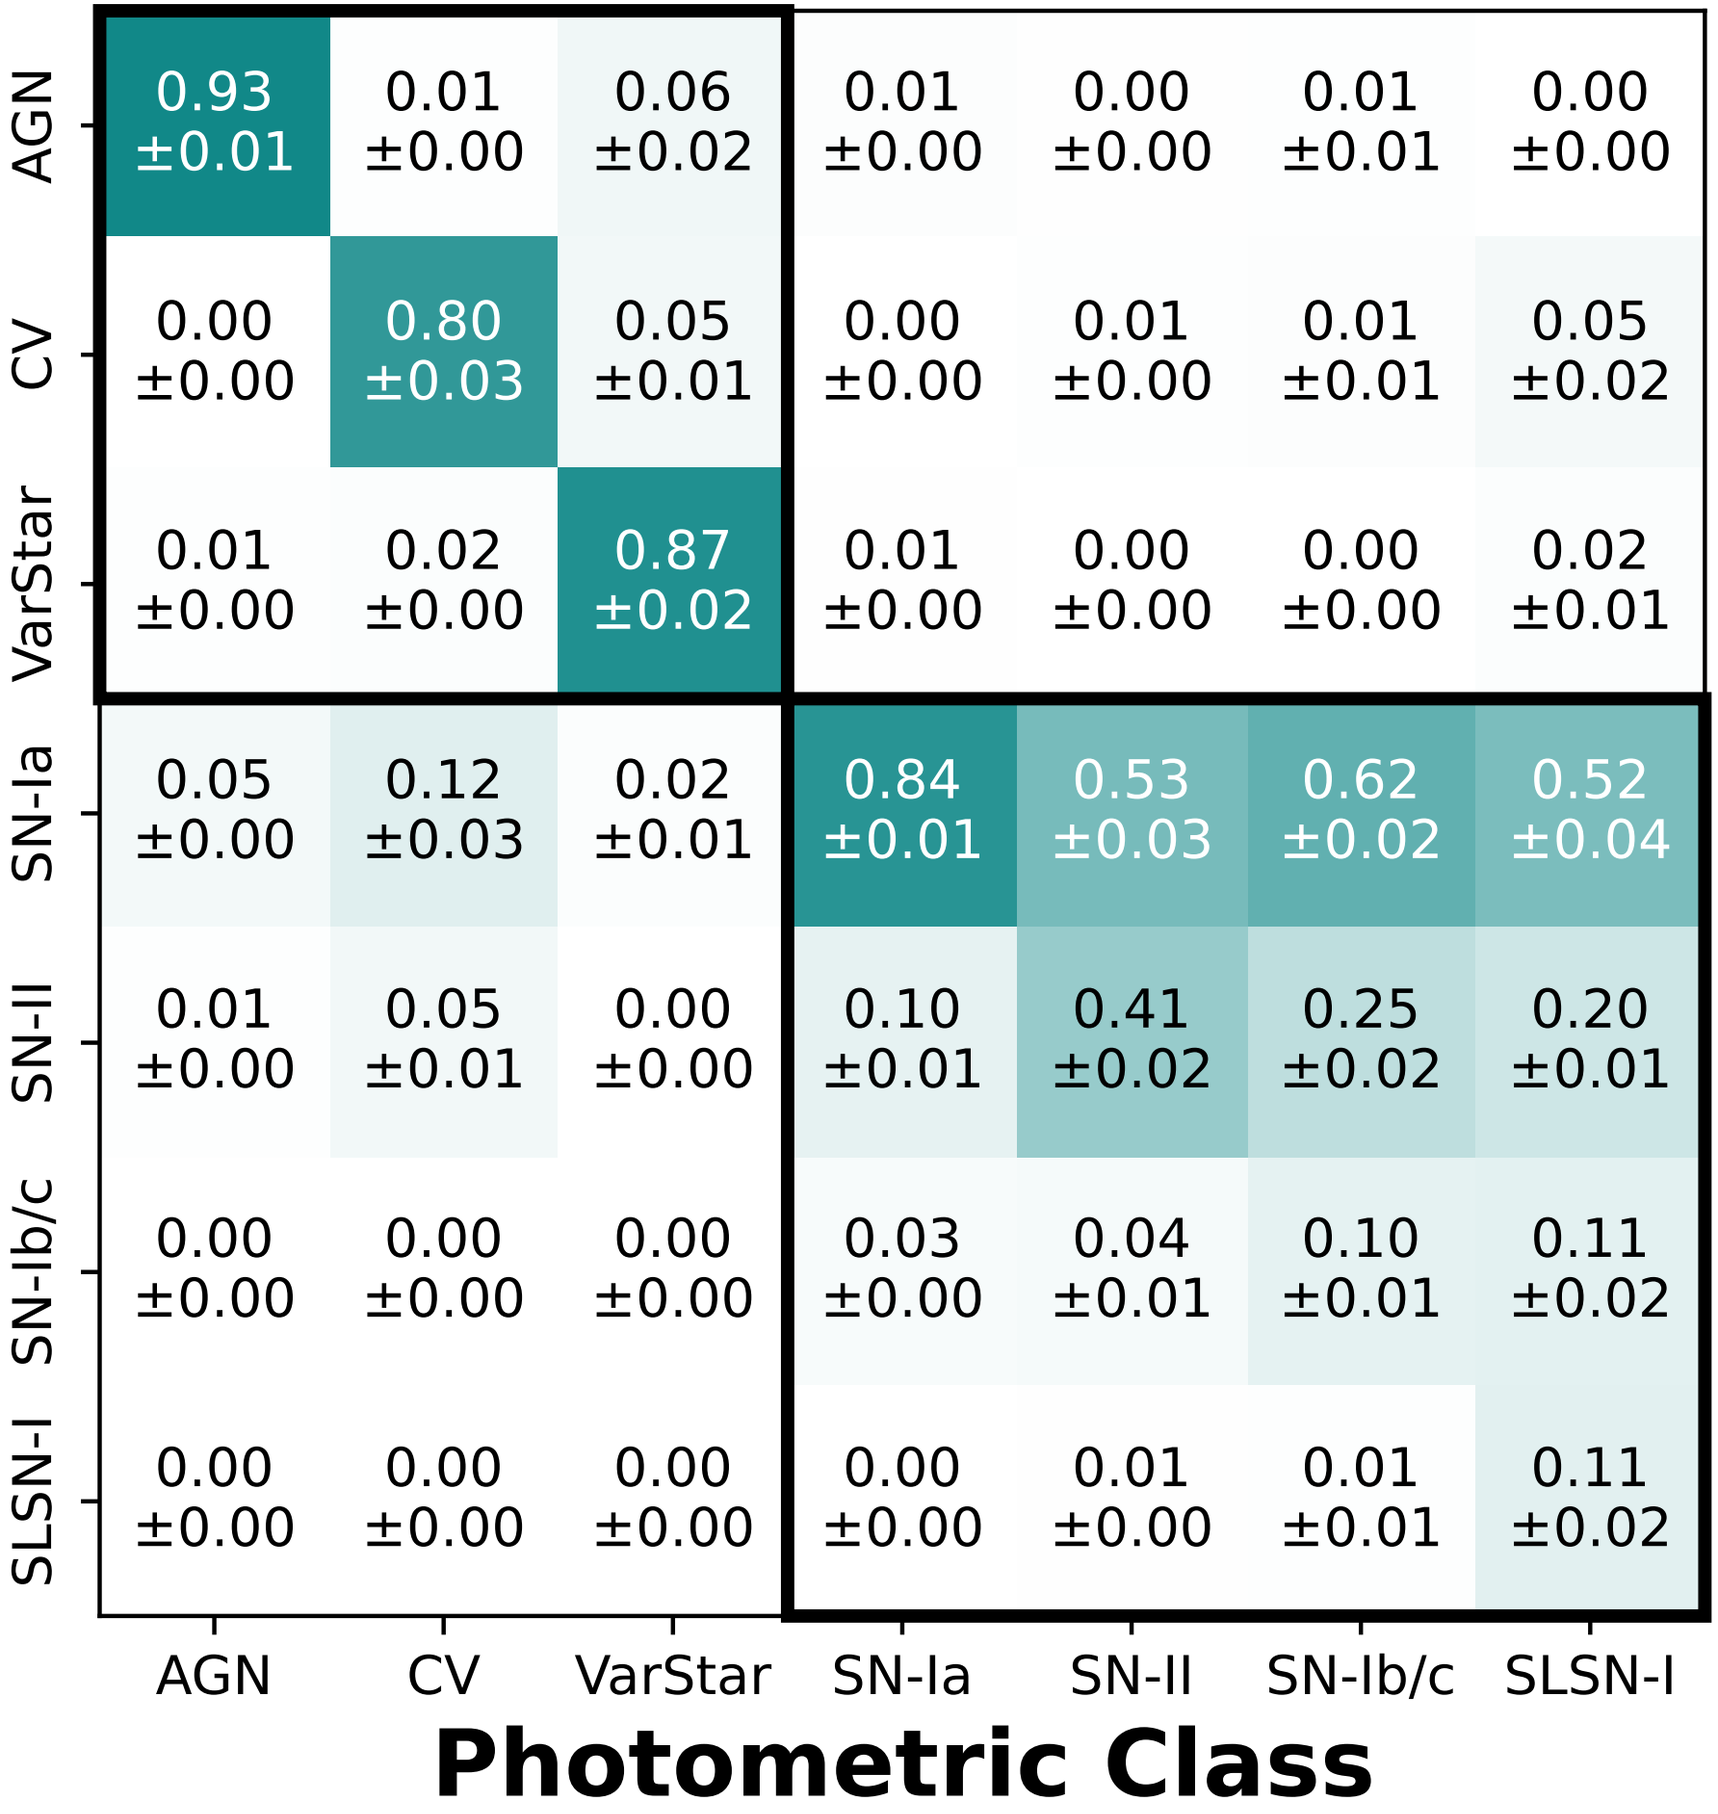
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
0.93 ±0.01
0.01 ±0.00
0.06 ±0.02
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.01
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.80 ±0.03
0.05 ±0.01
0.00 ±0.00
0.01 ±0.00
0.01 ±0.01
0.05 ±0.02
0.01 ±0.00
0.02 ±0.00
0.87 ±0.02
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.02 ±0.01
0.05 ±0.00
0.12 ±0.03
0.02 ±0.01
0.84 ±0.01
0.53 ±0.03
0.62 ±0.02
0.52 ±0.04
0.01 ±0.00
0.05 ±0.01
0.00 ±0.00
0.10 ±0.01
0.41 ±0.02
0.25 ±0.02
0.20 ±0.01
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.03 ±0.00
0.04 ±0.01
0.10 ±0.01
0.11 ±0.02
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.00
0.01 ±0.01
0.11 ±0.02
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
Photometric Class