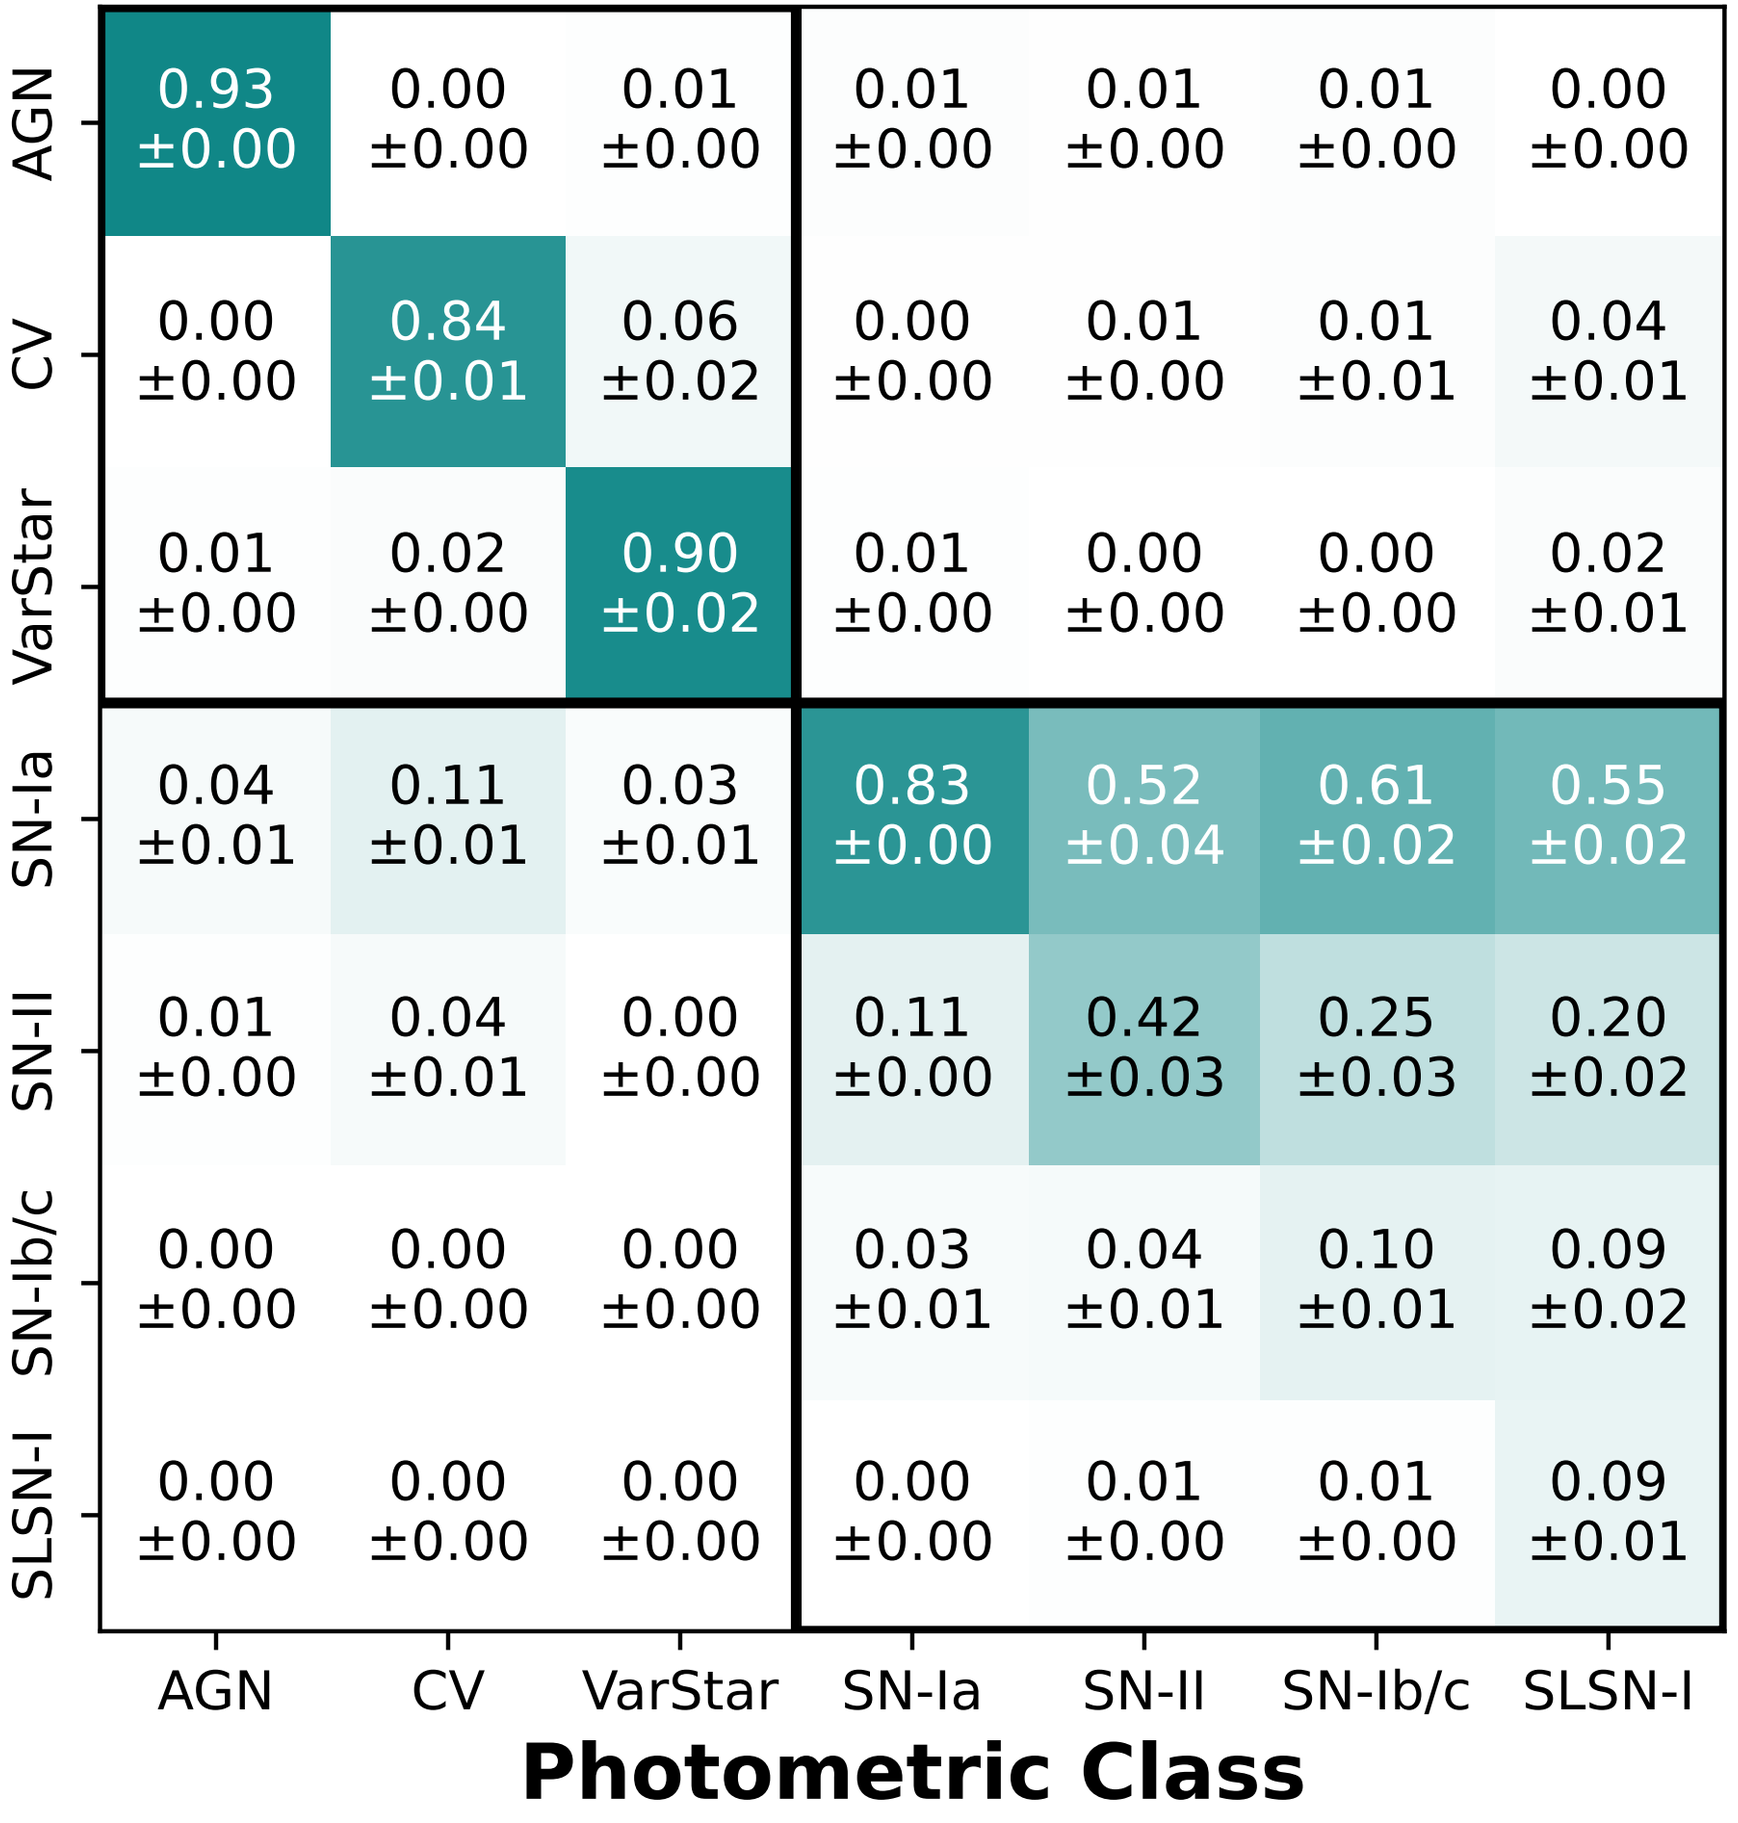
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
0.93 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.00
0.01 ±0.00
0.01 ±0.00
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.84 ±0.01
0.06 ±0.02
0.00 ±0.00
0.01 ±0.00
0.01 ±0.01
0.04 ±0.01
0.01 ±0.00
0.02 ±0.00
0.90 ±0.02
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.02 ±0.01
0.04 ±0.01
0.11 ±0.01
0.03 ±0.01
0.83 ±0.00
0.52 ±0.04
0.61 ±0.02
0.55 ±0.02
0.01 ±0.00
0.04 ±0.01
0.00 ±0.00
0.11 ±0.00
0.42 ±0.03
0.25 ±0.03
0.20 ±0.02
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.03 ±0.01
0.04 ±0.01
0.10 ±0.01
0.09 ±0.02
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.00
0.01 ±0.00
0.09 ±0.01
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
Photometric Class