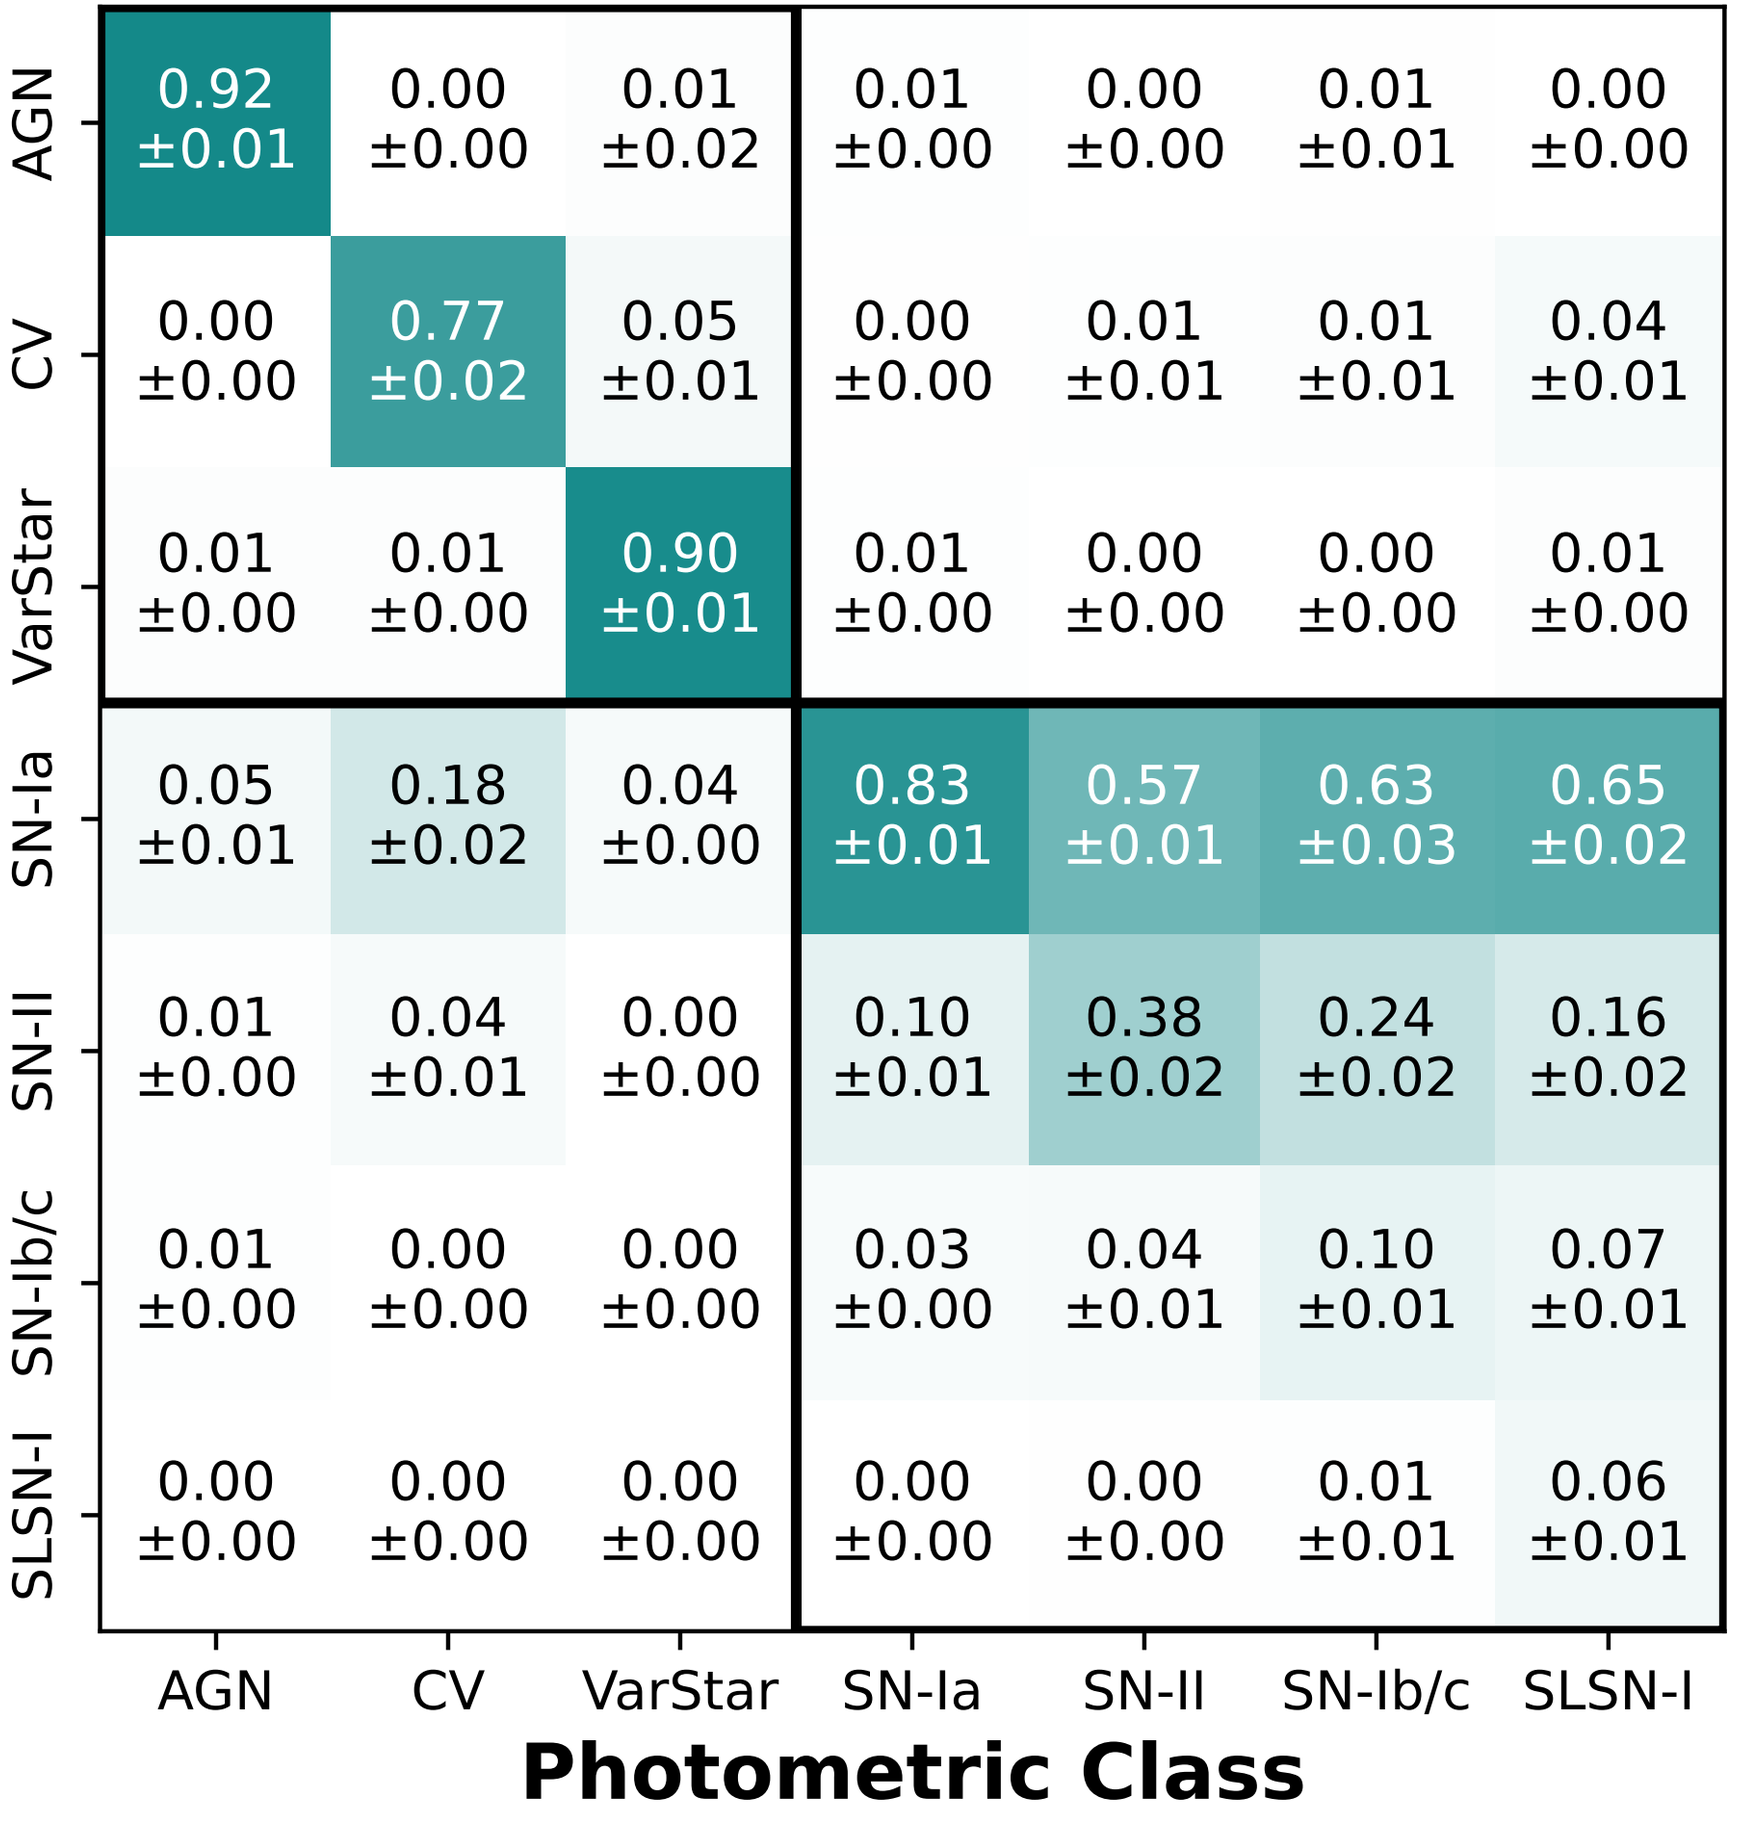
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
0.92 ±0.01
0.00 ±0.00
0.01 ±0.02
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.01
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.77 ±0.02
0.05 ±0.01
0.00 ±0.00
0.01 ±0.01
0.01 ±0.01
0.04 ±0.01
0.01 ±0.00
0.01 ±0.00
0.90 ±0.01
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.00
0.05 ±0.01
0.18 ±0.02
0.04 ±0.00
0.83 ±0.01
0.57 ±0.01
0.63 ±0.03
0.65 ±0.02
0.01 ±0.00
0.04 ±0.01
0.00 ±0.00
0.10 ±0.01
0.38 ±0.02
0.24 ±0.02
0.16 ±0.02
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.03 ±0.00
0.04 ±0.01
0.10 ±0.01
0.07 ±0.01
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.01
0.06 ±0.01
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
Photometric Class