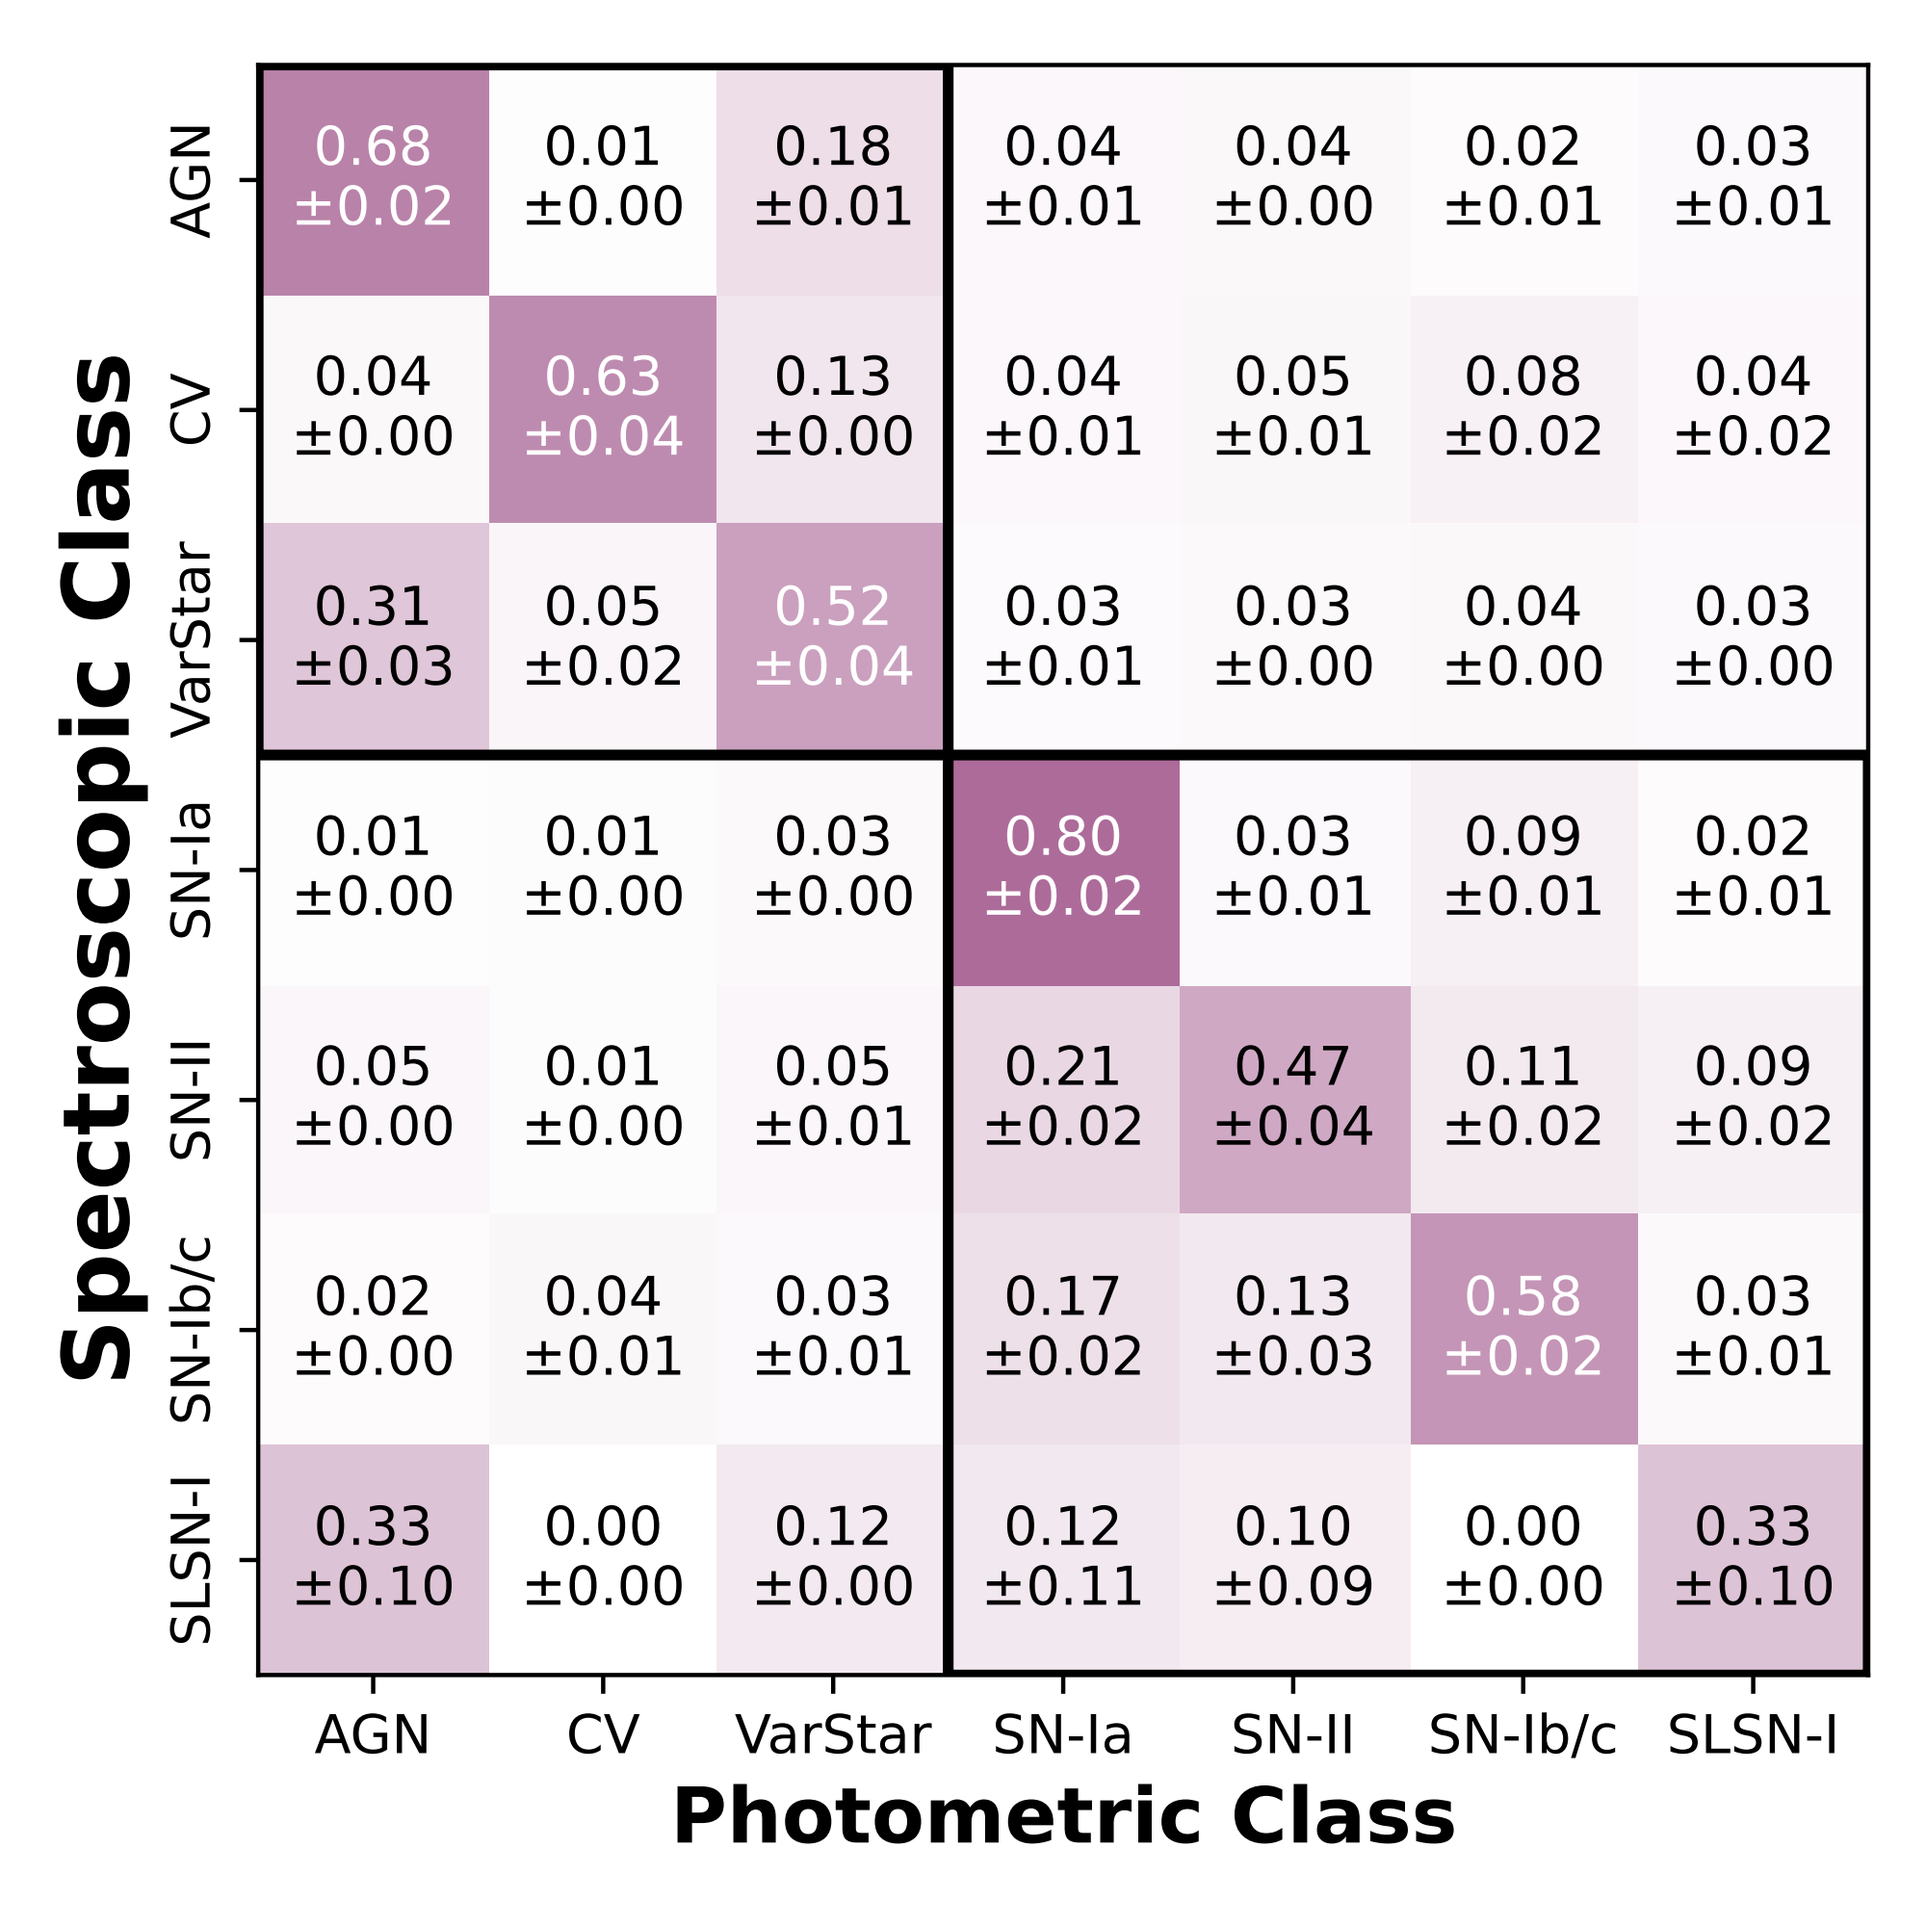
Spectroscopic Class
Photometric Class
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
0.68 ±0.02
0.01 ±0.00
0.18 ±0.01
0.04 ±0.01
0.04 ±0.00
0.02 ±0.01
0.03 ±0.01
0.04 ±0.00
0.63 ±0.04
0.13 ±0.00
0.04 ±0.01
0.05 ±0.01
0.08 ±0.02
0.04 ±0.02
0.31 ±0.03
0.05 ±0.02
0.52 ±0.04
0.03 ±0.01
0.03 ±0.00
0.04 ±0.00
0.03 ±0.00
0.01 ±0.00
0.01 ±0.00
0.03 ±0.00
0.80 ±0.02
0.03 ±0.01
0.09 ±0.01
0.02 ±0.01
0.05 ±0.00
0.01 ±0.00
0.05 ±0.01
0.21 ±0.02
0.47 ±0.04
0.11 ±0.02
0.09 ±0.02
0.02 ±0.00
0.04 ±0.01
0.03 ±0.01
0.17 ±0.02
0.13 ±0.03
0.58 ±0.02
0.03 ±0.01
0.33 ±0.10
0.00 ±0.00
0.12 ±0.00
0.12 ±0.11
0.10 ±0.09
0.00 ±0.00
0.33 ±0.10