## Описание FIT readout unit

# Финогеев Дмитрий, ИЯИ РАН $26~\rm{u} \, \rm{m} \, \rm{n} \, \rm{n} \, \rm{n} \, \rm{2020} \, \, \rm{r}.$

Актуальная версия документа доступна для скачивания по ссылке https://github.com/dfinogee/FIT-readout-manual/archive/master.zip

### Содержание

Т	FTT readout unit	2
2	Описание алгоритма коррекции ВС и отбора событий	5
3	Описание функциональных модулей         3.1       модуль Event Selector          3.2       модуль RX Data Decoder          3.3       модуль CTP emulator          3.4       модуль Data converter          3.5       модуль TX data gen          3.6       модуль GBT          3.7       модуль RX data clock sync          3.8       модуль CRU packet builder          3.9       модуль PM/TCM emulator	2 6 6 6
4	Список ошибок и процедура их обработки	7
5	Описание клоков	7
6	Описание формата данных детектора FIT	8
7	Используемые компоненты блоков памяти	10
8	Регистры управления и статуса           8.1 Описание регистров управления	
9	Ссылки на рабочие документы и программное обеспечение по проекту FIT	13

#### 1 FIT readout unit

FIT readout unit (FRU) является модулем программного обеспечения ПЛИС плат PM/TCM. Основные функции FRU:

- Получение и обработка данных с СТР (через CRU): Триггеры, ВС, Orbit
- Формирование пакета данных полученных с PM/TCM для каждого события (event packet, EP)
- Отбор данных по триггеру в зависимости от режима набора данных
- Формирование RDH пакета содержащего набор EP в соответствии требованиями ALICE DAQ
- Отправка RDH пакета в CRU по протоколу GBT

Функциональная схема FRU представлена на рис 1

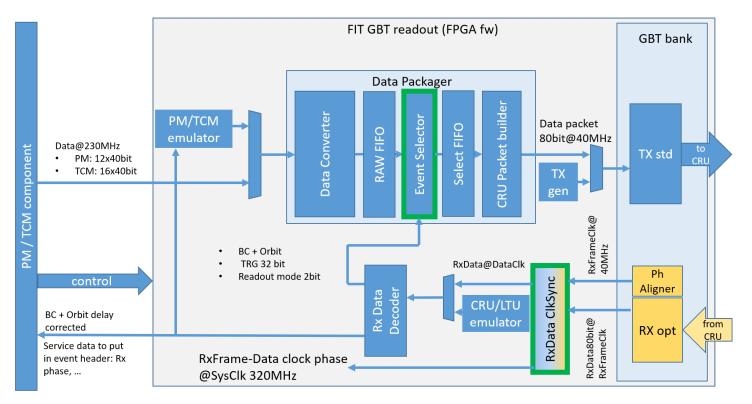


Рис. 1: Функциональная схема FIT readout unit

FRU обменивается данными с PM/TCM с одной стороны и с CRU с другой. Данные в/из CRU передаются по оптической линии по протоколу GBT. Ширина шины составляют 80 бит и тактируются по клоку 40 МГц синхронным с CRU. Данные содержат информацию orbit и bc 32 и 12 бит соответственно и триггерную информацию - 32 бита каждый из которых отвечает за соответствующие триггера включая триггера запуска и остановки рана, триггер физического события. Данные полученные по GBT передаются в модуль 'RxDataClkSync' для синхронизацией с внутренним клоком 40МГц, фаза между клоками измеряется по клоку 320МГц. После синхронизации данные передаются в модуль 'RX Data Decoder' где принимаются команды запуска и остановки рана и данные о BC и orbit. Данные BC и Огbit корректируются в соответствии с задержкой и отправляются в программный модуль PM/TCM. Для тестов без CRU предусмотрен модуль 'CRU/LTU emulator' в котором генерируются данные содержащие информацию orbit и bc и триггерную информацию включая триггера запуска и остановки рана, триггер физического события.

Данные из PM/TCM передаются по клоку 320МГц и обрабатываются модулем 'Data Packager', для тестов на отладочной плате предусмотрен модуль 'PM/TCM emulator' позволяющий генерировать данные с PM/TCM. Модуль 'Data Packager' содержит подмодули 'Data Converter', 'Event selector' и 'CRU Packet builder'. Модуль 'Data Converter' формирует пакеты данных полученных с PM/TCM для каждого события (event packet, EP) и отправляет их в буфер памяти 'RAW FIFO' по клоку 320 МГц. Модуль 'Event Selector' принимает EP из памяти 'RAW FIFO' по клоку 320МГц, отбирает события в соответствии с триггером в триггерном режиме передачи и группирует данные в RDH пакеты в соответствии с требованиями ALICE DAQ. Отобранные и сгруппированные события с сопутствующей информацией необходимой для заголовка поступают в буфер памяти 'Select FIFO'. Третий модуль 'CRU Packet Builder' принимает данные из блока памяти 'Select FIFO', дополняет сформированные данные RDH заголовком и отправляет результат в модуль GBT для дальнейшей передачи в CRU. Для проверки работы GBT передатчика предусмотрен 'TX generator' передающий постоянный паттерн на вход GBT.

#### 2 Описание алгоритма коррекции ВС и отбора событий

На рис 2 представлена схема временной коррекции и алгоритма отбора событий.

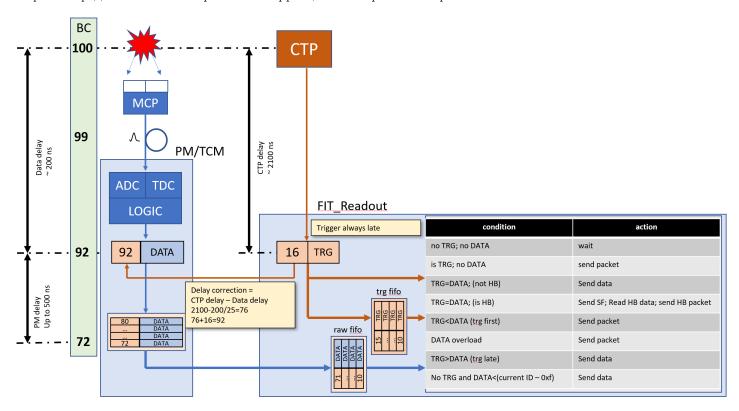


Рис. 2: Схема временной коррекции ВС и отбора событий по триггеру

Каждое столкновение (событие, event) в ALICE@LHC пронумеровано двумя целыми числами: ВС - порядковым номером банча в орбите (кольце ускорителя) 0 - 3563 (12 бит) и Orbit - порядковым номером орбита (32 бита).

Каждому событию в эксперименте ALICE соответствует триггерное решение, которое говорит о характере данного события. Так же существуют технические триггеры. Примеры триггеров: команды запуска и остановки набора данных в непрерывном и триггерном режимах (SOC, SOT, EOC, EOT), триггер отброса данных (HBr), триггер начала орбита (Orbit) и другие. Каждому триггеру соответствует один бит в 32 битном слове, каждому событию может соответствовать несколько триггеров. Номер и триггерное решение для каждого события посылается модулем Central Trigger Processor (CTP) с частотой 40МГц. Данная информация поступает в FIT Readout unit по протоколу GBT через модуль Common readout Unit (CRU) с задержкой порядка нескольких микросекунд.

На схеме рис 2 эти данные обозначены оранжевой стрелочкой от модуля CRU, для примера, на схеме текущий поступивший в FRU номер обозначен 16 и триггерное решение TRG для данного события. На схеме, для примера, происходит событие под номером 100. Регистрация и оцифровки события детектором происходит с задержкой, для примера на схеме задержка равна 8. Как задержка регистрации сигнала, так и задержка триггерного сигнала постоянны и известны. Задержка регистрации сигнала меньше чем задержка триггерного сигнала и для определения номера регистрируемого события, к номеру полученному от СТР прибавляется разница между задержками регистрации сигнала и распространение триггерного сигнала. На схеме эта разница равна (2100нс - 200нс) /25 = 76 и прибавив 76 к полученному номеру от СТР 16 получаем номер регистрируемого события 92. Данная операция выполняется в модуле 'RxDataDecoder', задержка определяется регистром 'BCID delay'.

Триггерная информация, поступившая от CTP относится к поступившем вместе с ней номером события (на схеме 16-TRG). Она необходима для отбора и сортировки событий по триггеру и сохраняется в буфер памяти 'trg fifo'. Поскольку задержка регистрации событий меньше, чем задержка триггерного сигнала данные о событиях сохраняются в буфер памяти 'raw fifo' для дальнейшей сортировки. Сортировка на схеме обозначена блоком 'Event selection' и на входе принимает данные о текущем принятом номере события от СТР, и данные из буферов памяти 'raw fifo' и 'trg fifo' для сравнения.

Модуль 'Event Selection' выполняет сравнение номеров события для триггерного сообщения и данных детектора из 'raw data fifo' и 'trg fifo'.

• Если номер для триггерного сообщения меньше (соответствует более раннему событию) или данные в 'raw fifo' отсутствуют то это означает что данные для этого триггерного сообщения отсутствуют. В этом случае триггерное сообщение вычитывается из 'raw fifo' и при необходимости формируется RDH пакет (на пример при получении 'HB trigger').

- Если номер события в данных меньше чем номер в триггерном сообщении то это означает что для данных отсутствует триггерное решение. В случае непрерывной передачи 'continuous readout' данные вычитываются из 'raw fifo' и передаются в 'select fifo' для формирования RDH. В случае триггерной передачи 'triggered readout' данные вычитываются из 'raw fifo' и отбрасываются в соответствии с алгоритмом отбора по триггеру.
- Если номер события в данных равен номеру в триггерном сообщении то это означает что триггерное сообщение соответствует данным детектора. В случае непрерывной передачи 'continuous readout' данные вычитываются из 'raw fifo' и передаются в 'select fifo' для формирования RDH. В случае триггерной передачи 'triggered readout' данные вычитываются из 'raw fifo' и передаются в 'select fifo' для формирования RDH только при наличии необходимого триггера для отбора событий. Маска для отбора триггеров содержится в регистре 'Data select trigger mask'. Триггерное сообщение так же вычитывается из 'trg fifo'.
- Если присутствуют данные детектора и отсутствует триггерное сообщение то это означает что триггерное сообщение может прийти позже. В этом случае выполняется сравнение номера события данных и текущего принятого номера события из СТР. Если разница между этими событиями больше фиксированной величины, то это означает что триггерное сообщение отсутствует для данных, данные вычитываются из буфера 'raw fifo' и отбираются в соответствии с режимом вычитывания данных. Если разница меньше или равна фиксированной величине, то данные сохраняются в 'raw fifo'. Величина для сравнения задается регистром 'Trigger compare delay'.

Для формирования RDH пакета данные отобранные из 'raw fifo' помещаются в 'selected fifo'. Для отправления RDH пакета при накоплении максимального объема данных или при иной необходимости (на данный момент согласно требованиям DAQ ALICE необходимо отправлять пакет при получении 'HB trigger' и для отправки 'HB stop frame') формируется управляющее слово. Управляющее слово содержит количество слов в RDH пакете и сопутствующую информацию для RDH заголовка в том числе номер орбита, триггерное решение (актуально для RDH v4). Модуль 'CRU Packet builder' принимает управляющее слово, вычитывает соответствующее количество слов из 'Selected fifo', формирует RDH пакет включая данные из регистров 'FEE ID', 'PAR', 'Detector field' (актуально для RDH v4) и отправляет его в модуль GBT.

#### 3 Описание функциональных модулей

#### 3.1 модуль Event Selector

Назначение модуля описано в разделе "Описание алгоритма коррекции BC и отбора событий". Модуль 'Event selector' принимает данные и триггерные сообщения для сравнения и отбора событий. Отобранные события помещаются в 'selected fifo' и сопровождаются командными словами для формирования RDH пакетов.

Каждое событие (40 МГц) модуль РМ может сформировать до 6 слов плюс одно слово заголовки события, модуль ТСМ формирует одно слово плюс слово заголовка (в отладочном режиме 9+1 слов, допускается пропуск событий). Пакеты модуля передаются по клоку 320 МГц и максимальная длинна пакета для одного события (40 МГц) составляет 8 слов. Модуль 'Event selector' также читает и обрабатывает данные по клоку 320 МГц. 'selected fifo' читается модулем 'CRU packet builder' по клоку 40 МГц, GBT модуль так же передает данные по клоку 40 МГц. В связи с тем что 'selected fifo' читается по клоку 320 МГц а записывается по клоку 40 МГц, возможно его переполнение. В случае когда в 'selected fifo' не остается места для данных, данные отбрасываются. В этом случае запоминаются первый и последний номер орбита и количество пропущенных событий, эта информация доступна в регистрах 'first hit dropped orbit', 'last hit dropped orbit', 'selector hits dropped'. В регистре 'readout rate' отображается количество слов данных (80бит 40МГц) за последний орбит. В регистре 'selector fifo count' доступна занятость 'selector fifo'. Бит 'reset drop counter' в регистре 'Reset control' (при записи в него значения 0х1) позволяет сбросить счетчик пропущенных событий.

Регистр 'is HB response' (при значении 0х1) позволяет отключить отправку RDH пакета по получению триггера HB для снижения потока данных при использовании FTM. Регистр 'Max RDH payload' задает максимальное количество слов в RDH пакете. Максимальный объем RDH пакета составляет 8 Кб, поскольку каждое переданное GBT слово дополняется в CRU до 128 бит, максимум в RDH пакете может содержаться 8192\*8/128=512 слов GBT. Значение регистра означает количество GBT слов и должно быть равно 0х200. Для отладки максимальный размер пакета может быть уменьшен. Регистр 'CRU trigger delay' определяет как долго данные модуля 'ожидают' триггерное сообщение (см. раздел "Описание алгоритма коррекции BC и отбора событий"). Регистр 'data select trigger mask' определяет маску (набор) триггеров для отбора в режиме триггерного вычитывания ('triggered mode'). При значении регистра 'readout mode' равном 'idle' модуль 'event selector' прекращает работу.

#### 3.2 модуль RX Data Decoder

Модуль предназначен для обработки данных полученных от CRU (CTP) по GBT. Как описано в разделе "Описание алгоритма коррекции BC и отбора событий" каждому событию соответствует номер и триггерное решение. Допускается что триггерное сообщение, содержащее текущий номер события, может приходить не каждый клок 40 МГц, в случае если триггер отсутствует сообщение может быть пропущено (относится к первым требованиям ALICE DAQ). В связи

с чем модуль 'RX data decoder' содержит внутренний счетчик событий, который может находится в трех состояниях 'Start', 'Sync', 'Lost', состояние счетчика доступно в регистре 'BCID sync mode'. При включении или по команде 'reset orbit sync' (бит 'reset orbit sync' в регистре 'reset control') счетчик переходит в состояние 'start' до получения первого триггера. После получения триггера счетчик переходит в состояние 'sync' и начинает отчет событий с полученного номера от СТР. Для определения номера события используется текущее значение счетчика в связи с чем получение каждого номера события от СТР не обязательно. Текущее значение номера события доступно из регистров 'CRU orbit', 'CRU bc'. При получении триггерного сообщения номер события полученый от СТР сравнивается со значением счетчика. Если эти значения не равны, то это означает рассинхронизацию внутреннего счетчика с нумерацией СТР, счетчик переходит в состояние 'lost' до момента получения сигнала 'reset orbit sync'.

Как было описано в разделе "Описание алгоритма коррекции ВС и отбора событий"номер полученный от СТР, (фактически - номер внутреннего счетчика синхронизированный с СТР) корректируется на величину разности задержек в распространении триггерного сообщения и обработки сигнала детектором. Величина корректировки задается регистром 'bcid delay'.

Модуль 'RX data decoder' обрабатывает триггера запуска и остановки вычитывания (SOT - start of trigger, EOT - end of trigger, SOC - start of continuous, EOC - end of continuous) управляя текущем режимом вычитывания. Состояние режима может принимать значения 'idle', 'continuous', triggered', значение доступно по регистру статуса 'readout mode'. Выставив в регистре управления 'readout mode' бит 'force readout idle mode' возможно принудительно перевести режим вычитывания в 'idle' что необходимо при включении или возникновении ошибки. При значении регистра 'readout mode' равном 'idle' модуль 'event selector' прекращает работу.

#### 3.3 модуль CTP emulator

Для работы без CTP/LTU предусмотрен модуль 'CTP emulator' который производит все необходимые данные для отладки работы 'FIT readout unit'. Включение модуля (отключение приема сигналов CTP) происходит переключением регистра 'Trigger generator' в состояние 'Continuous generator'. 'CTP emulator' выполняет следующие функции:

- Генерация триггера 'HB' и номера события event id для эмуляции CRU.
- Генерфция триггеров запуска и остановки процедуры вычитывания.
- Генерация одиночного триггера по команде
- Генерация непрерывного триггера с возможностью синхронизацией с тестовым генератором данных

Генерация триггера 'НВ' и номера события event id происходит автоматически и не управляется.

Генерация триггеров запуска и остановки процедуры вычитывания происходит по команде. При переводе регистра 'readout command' из состояния 'OFF' в состоянии команды 'SOC', 'SOT', 'EOT', 'EOC' отправляется соответствующий триггер управления режимом вычитывания. Триггер команды отправляется в момент начала орбита вместе с триггером 'HB' в соответствии с требованиями ALICE DAQ.

Для отправки единичного триггера необходимо в регистр 'trigger single value' записать ноль, а потом значение триггера, которое необходимо отправить. Отправка триггера происходит при изменении регистра из значения 0х0 в ненулевое.

Генерация непрерывных триггеров по функциональности схожа с тестовым генератором данных модуля 'PM/TCM emulator'. Значение генерируемого триггера задается регистром 'continuous trigger value'. Регистрами 'trigger continuous pattern' формируется последовательность из 64 значений задающая очередность генерации триггера 'pattern'. Частота запуска 'pattern' определяется регистром 'trigger bunch frequency' задающим число отсчетов 'event id' между 'pattern'. Первая генерация 'pattern' происходит с отступом от начала орбита ('HB' trigger) на величину регистра 'trigger start offset' задающим число отсчетов 'event id'. Если частота 'pattern' равна величине орбита (регистр 'trigger bunch frequency' равен 0хDEC) то сдвиг паттерна относительно 'HB trigger' будет постоянен.

На рисунке 2 представлена схема генерации последовательности триггеров модулем 'CTP emulator'.

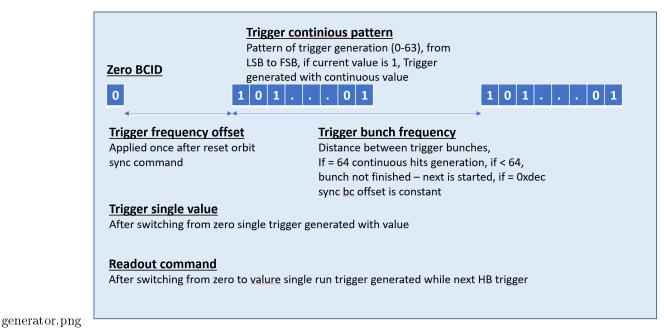


Рис. 3: Схема генерации последовательности триггеров модулем 'CTP emulator'

Так, на пример, если регистр 'trigger bunch frequency' равен 0xDED, регистр 'trigger start offset' равен 0x5 то в момент старта генератора или при переходе бита 'reset start offset' в регистре 'reset control' из состояния 0x1 в 0x0 будет ожидаться следующий триггер 'HB'. При получении триггера 'HB' будет произведен отсчет в 0x5 событий 'event id'. После этого будет запущена генерация триггеров в соответствии с 'pattern'. Если регистр 'Trigger continuous pattern 31 to 0' равен 0x3 и 'Trigger continuous pattern 63 to 32' равен 0x1 то будет сгенерированы триггера на пятом, шестом и 38 событии в орбите. После этого будет произведен отсчет в 0xDED событий 'event id' и новый запуск генерации триггеров в соответствии с 'pattern'. Поскольку значение 0xDED на одно больше, чем длительность орбита, в следующем орбите триггера будут в событиях с номерами 6, 7 и 39.

Модуль 'PM/TCM emulator' имеет схожий алгоритм генерации что позволяет обеспечить генерацию данных синхронно с генерацией триггера для отладки работы механизма отбора событий.

#### 3.4 модуль Data converter

Модуль 'data converter' принимает данные от PM/TCM по клоку 320 МГц и дополняет их заголовком 'event header'. Данные, дополненные заголовком оправляются в 'raw fifo' по клоку 320 МГц. Для контроля занятости 'raw fifo' по регистру 'raw fifo count' доступно количество слов данных в fifo.

#### 3.5 модуль TX data gen

Для отладки GBT передачи возможно подать фиксированный пакет данных в передачи GBT переключив регистр 'Data generator' в режим 'TX generator'. Так же возможно выключить всю логику 'FIT readout unit' выставив в регистре 'Readout mode' бит 'is readout bypass mode'. В этом случае данные, полученные с модуля PM/TCM будут записываться во внутренне fifo по клоку 320 МГц и сразу же, без обработки, передаваться в GBT модуль по клоку 40 МГц.

#### 3.6 модуль GBT

Описание работы модуля GBT доступно по ссылке https://espace.cern.ch/GBT-Project/GBT-FPGA. Статус модуля доступен в регистре 'gbt status'. При возникновении ошибки 'GBT RX error detected' бит 'GBT RX error latch' принимает состояние 0x1 до подачи сигнала 'reset GBT errors' (регистр 'Reset control'). Перезагрузка GBT модуля выполняется командой 'GBT reset' (регистр 'Reset control').

#### 3.7 модуль RX data clock sync

На схеме 4 представлена схема регистров (логических защелок) для перехода между асинхронными клоками: внутренним клоком 'Data clk' 40 МГц и клоком от CRU 'RX frame clk' 40 МГц полученным через модуль GBT. Фаза между этими клоками измеряется по клоку 'system clk' 320 МГц и может принимать значения от 0 до 7. При нормальном режиме работы фаза не должна меняется больше чем на +-1 отсчета от значения при начале синхронизации, если это происходит значение бита 'RX phase error' регистра 'GBT status' принимает значение 0x1 до сброса командой 'reset RX phase error' регистра 'Reset control'

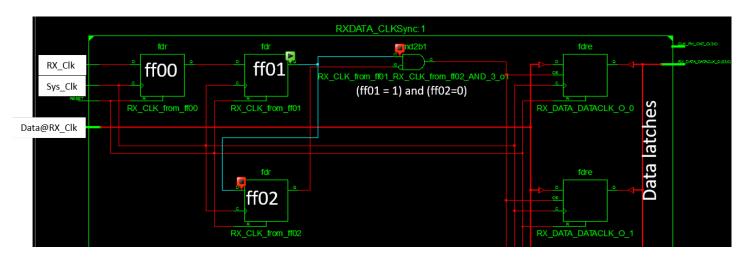


Рис. 4: Схема перехода между асинхронными клоками от RXframeClk 40Mгц от CRU и внутренним клоком Data clk 40 МГц

#### 3.8 модуль CRU packet builder

Модуль 'CRU packet builder' принимает данные, сформированные модулем 'event selector' (см разделы "Описание алгоритма коррекции ВС и отбора событий"и "модуль Event Selector") и формирует RDH пакет используя регистры 'FEE ID', 'PAR', 'DET field'.

#### 3.9 модуль PM/TCM emulator

Данный модуль предназначен для отладки 'FIT readout unit' и генерирует данные от модуля PM/TCM, где в качестве значения данных, используется непрерывный счетчик. Для включения модуля в регистр 'Data generator' следует записать значение 'main generator'. Регистрами 'Data bunch pattern', 'data bunch frequency', 'data start offset' можно задавать последовательность, частоту, и смещение относительно орбита. Алгоритм генерации данных модуля схожа с генерацией непрерывного триггера в модуле модуле 'CTP emulator'. Отличие состоит в том, что при генерации тригерра 'pattern' состоит из 64 однобитных значений определяющих наличие триггера на данном шаге. В модуле 'PM/TCM emulator' 'pattern' задается восемью значениями по 4 бита (0-15). Каждое значение определяет количество слов в пакете для текущего события. В случае если значение превышает 0х6, то следующие события не генерируются пока не закончится передача текущего слова. Так на пример если значение регистра 'Data bunch pattern' равно 0х111D21 то последовательность пакетов будет следующая: пакет с одним словом, с двумя, с 13 (на шагах 4 и 5 пакеты генерироваться не будут), с одним словом.

Регистр 'trigger response mask' позволяет определить набор триггеров, при получении которых будет вырабатываться данные генератора с количество слов для первой позиции паттерна (если выполняется непрерывная генерация данных, то количество слов будет соответсвовать нулевой позиции 'pattern' а не текущему шагу). Следует отметить что номер события 'event id' пакета будет больше чем у триггера из-за задержки алгоритма.

Бит 'reset start offset' в регистре 'Reset control' перезапускает генерацию данных в модулях 'PM/TCM emulator' и 'CTP emulator' для их синхронизации.

## 4 Список ошибок и процедура их обработки

При рассинхронизации номера события (регистр BCID sync mode перешел в состояние 'lost' или 'start') отправка событий в модуле 'event selector' останавливается. Требуется процедура перезапуска вычитывания (еще не реализована)

#### 5 Описание клоков

FIT readout unit использует две группы клоков с произвольным фазовым сдвигом: группа платы содержит два синхронных клока 'Data clk' 40 М $\Gamma$ ц и 'system clk' 320М $\Gamma$ ц, эти клоки формируются на плате PM/TCM. Клок 40 М $\Gamma$ ц используется для работы с данными GBT, клок 320 М $\Gamma$ ц используется для обработки данных.

Вторая группа клоков содержит клок 'RxFrameClk' 40МГц полученный из модуля GBT, синхронный CRU и используемый для передачи данных принятых данных с CRU. Данные принятые из CRU по клоку 'RxFrameClk' синхронизируются с группой клоков платы в модуле 'RxData ClkSync', в последующем клок 'RxFrameClk' не используется. Физически клоки обеих асинхронных групп имеют один источник что обеспечивает одинаковую частоту.

#### 6 Описание формата данных детектора FIT

Структура пакета передаваемых детектором по GBT приведена на рисунке 5. Заголовком пакета является RDH (Raw Data Header) Актуальную версию формата заголовка можно узнать из комментариев к коду O2.

https://github.com/Alice02Group/Alice02/blob/dev/DataFormats/Headers/include/Headers/RAWDataHeader.h

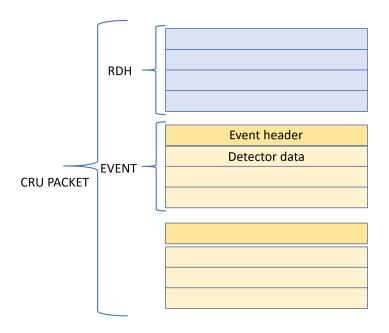


Рис. 5: Схема RDH пакета

В теле RDH пакета содержится набор пакетов данных каждый из которых относится к отдельному событию и состоит из заголовка 'event header' и блока данных. Пакеты событий всегда относятся к одному орбиту и отсортированы по порядку поступления. Формат заголовка одинаков для модулей PM/TCM, его формат представлен в таблице 6. Формат блока данных различен для PM/TCM, TCM имеет два режима передачи: стандартный и расширенный. В PM каждое GBT слово 80 бит содержит одно или два слова 40 бит для канала: с 0 бита по 39 и с 40 по 79, в случае одного слова, старшие биты с 40 по 79 заполняются нулями. Формат слова для канала представлен в таблице 7. Поскольку PM имеет 12 каналов, размер пакета данных события составляет от двух до 7 слов GBT. Формат данных для TCM представлен в таблице 8 и имеет размер в 1 GBT слово плюс заголовок. В расширенном режиме пакет данных TCM имеет 9 слов плюс заголовок в этом режиме передача данных для двух соседних событий невозможна. Актуальная версия формата данных доступна по ссылке.

https://drive.google.com/file/d/1LxKEuedLqxtyCRw072ZqJ2vj7upP0ZgV

GBT wo	d						80 bit															
CPU wor	ls			1	1 0																	
byt	s 1015	5	9	9	8		7	6		5		4	3		2		1		0			
bi	s 127 8	80 79	78 77 76	75 74 73 72	71 70 69 68 67 66 65	64 63 62 61 60	0 59 58 57 56	55 54 53 52 51	50 49 48	47 46 45 44 43 42	41 40	39 38 37 36 35 34 33 32	31 30 29 28 27 26 25 2	24 23 2	2 21 20 19 18 17 16	15 14	13 12 11 10 9	8 7 6 5	4 3 2 1 (	0		
header ب			0xF	words: 16		0x0000	100 (24bit)			err phase			orbit ID (32bit)				BC	ID (12bit, 0:	OOxDEB)	1		
data word	)					chann	nel data								channel data							
data word		d	hannel ID	0 0 0	flags (8bit)	ch	narge (13bit) ±			time (12bit) ±		channel ID 0 0 0	flags (8bit)		charge (13bit) :			time (12b	oit) ±	1		
data word	1				cha	nnel data or er	mpty (channel	ID = 0)							channel data						only last word can be half-en	npty
PM trigger			0xE orbit ID (32bit)				BC ID	(12bit, 00xDEB)	amplitude	e (14bit) ± bg			time (13bit) ±		code (4bit)	code	112 - number of channels,	bg: out-of-				
header			0xF	words: 1 9		0x0000	0x000000 (24bit) err phase orbit ID (32bit) BC ID (12bit, 0x00xDEB)		:00xDEB)		13 - no time information,	gate event										
word 0		(	) Ti	meC (9bit) ±	0 Time	4 (9bit) ±		Ampl	C (17bit) ±			AmplA (1	(7bit) ±	0	NchanC (7bit)	0	NchanA (7bit)	0 0 0	V C SC orC orA		0 - no trigger	(background)
word 1			Р	M_A2 trigger	data (16 LSB)		PM_A1 trigger data (32bit) PM_A0 trigger data (32bit)															
₩ word 2					PM_A4 tri	gger data (32bi	2bit) PM_A3 trigger data (32bit) PM_A2 trigger data (16 MSB)						MSB)									
word 3			P	M_A7 trigger	data (16 LSB)		PM_A6 trigger data (32bit) PM_A5 trigger data (32bit)															
∑ word 4					PM_A9 tri	gger data (32bi	tbit) PM_A8 trigger data (32bit) PM_A7 trigger data (16 MSB)						MSB)									
P word 5			P	M_C2 trigger	data (16 LSB)		PM_C1 trigger data (32bit) PM_C0 trigger data (32bit)															
₩ word €	word 6		PM_C4 trigger data (32bit)							PM_C3 trigge	er data (32bit)				PM_C2 trigg	ger data (16	MSB)					
word 7			P	M_C7 trigger	data (16 LSB)			PM	_C6 trigge	er data (32bit) PM_C5 trigger data (32bit)												
word 8					PM C9 tri	PM C9 trigger data (32bit)					PM C8 trigger data (32bit) PM C7 trigger data (16 MSB)											

Рис. 6: Формат данных детектора

bit	name	bits	min	max	description
0					
	Time value	12	-2048	2047	Time with sign bit. (Relative to IP center time value). ≈13ps per unit
11					
12					
	Charge value	13	-100	4095	Charge with sign bit (base line/range corrected), a.u.
24					
25	ADC number	1	0	1	ADC number (0 1)
26	double event	1	0	1	Double event (two CFD pulses during one BC period)
27	time not valid	1	0	1	Time information is not valid
28	ADC in gate	1	0	1	CFD pulse time is inside ADC gate
29	Time information too late	1	0	1	Time information too late (TDC outputs data too late to include in trigger)
30	Amplitude too high	1	0	1	Amplitude too high (CFD saturated, time may be incorrect)
31	Event included in TVDC trigger	1	0	1	Event included in TVDC trigger
32	Time information lost	1	0	1	Time information lost (TDC data did not arrive for any reason)
33					
34		3			
35					
36					
37	Channel ID (1-12)	4	1	12	0x0 means no data
38	Channel ID (1-12)	4	1	12	OXU Medils no udid
39					

Рис. 7: Формат данных модуля РМ

bit	name	bits	signed	min	max	description
0	ORA	1		0	1	OrA trigger
1	ORC	1		0	1	OrC trigger
2	SC	1		0	1	SemiCentral trigger
3	С	1		0	1	Central trigger
4	V	1		0	1	Vertex trigger
5 6 7		3				reserved
8  14	NchanA	7		0	127	Number of A-side active channels
15		1				reserved
16  22	NchanC	7		0	127	Number of C-side active channels
23		1				reserved
24  41	AmplA	18		0	262143	Total charge for A-side, a.u. (1 unit = 8 PM charge units)
42  59	AmplC	18		0	262143	Total charge for C-side, a.u. (1 unit = 8 PM charge units)
60  68	TimeA	9	±	-256	255	Average time for A-side. ≈13ps per unit
69		1				reserved
70  78	TimeC	9	±	-256	255	Average time for C-side. ≈13ps per unit
79		1				reserved

Рис. 8: Формат данных модуля ТСМ

## 7 Используемые компоненты блоков памяти

Название	ширина	ширина	размер	клок за-	клок чте-	использует	сфегистр	назначение
	запи-	чте-		писи	кин	в модуле	занято-	
	си,	ния,					сти	
	бит	бит						
Raw fifo	80	80	4096	system 320	system 320	Data	Raw	Принимает сформирован-
						packager	FIFO	ные данные РМ/ТСМ для
							$\operatorname{count}$	дальнейшего отбора моду-
								лем'event selector'
Selector fifo	80	80	4096	system 320	data40	Data	Selector	Принимает отобранные
						packager	FIFO	данные для формирова-
							$\operatorname{count}$	ния RDH
Trg fifo	76	76	512	data40	system 320	event	нет	Принимает триггеры для
						$\operatorname{selector}$		отбора событий
Cntpck fifo	160	160	128	system320	data40	event	нет	содержит управляющие
						$\operatorname{selector}$		слова для формирования
								RDH
data320to40	80	80	4096	system 320	data40	TX data	нет	принимает данные модуля
						$_{ m generator}$		из raw data fifo для отправ-
								ки по GBT в режиме 'is
								readout bypass mode'

Таблица 1: Список используемых блоков памяти

## 8 Регистры управления и статуса

## 8.1 Описание регистров управления

Название регистра	используется в модуле	является побитовым
Readout mode	Event selector, TX generator, RX data decoder	да
Readout command	CTP/LTU emulator	нет
Reset control	GBT, RX data decoder, Event selector, RX data clock sync	да
Trigger generator	CTP/LTU emulator	нет
Data generator	PM/TCM emulator	нет
Trigger response mask	CTP/LTU emulator	нет
Data bunch pattern	PM/TCM emulator	нет
Trigger single value	CTP/LTU emulator	нет
Trigger continuous pattern	CTP/LTU emulator	нет
Trigger continuous value	CTP/LTU emulator	нет
Trigger bunch frequency	CTP/LTU emulator	нет
Data bunch frequency	PM/TCM emulator	нет
Trigger start offset	CTP/LTU emulator	нет
Data start offset	PM/TCM emulator	нет
FEE ID	CRU packet builder	нет
PAR	CRU packet builder	нет
Max RDH payload	Event selector	нет
Detector field	CRU packet builder	нет
Trigger compare delay	Event selector	нет
BCID delay	RX data decoder	нет
Data select trigger mask	Event selector	нет

Таблица 2: Список регистров управления

addr	31 28	2724	23 20	19 16	15 12	11 8	7 4	30			
D8			Readout mode	Readout command	Reset c	ontrol	Trigger generator	Data generator			
D9	Trigger respond mask										
DA	Data bunch pattern										
DB	Trigger single value										
DC	Trigger continuous pattern 63 to 32										
DD	Trigger continuous pattern 31 to 0										
DE				Trigger conti	nuous valu	.e					
DF		Tri	gger bunch frequ	ency		D	ata bunch frequency	7			
E0			Trigger start	offset			Data start off	set			
E1			FEE ID (RDH)				PAR (RDH)				
E2	Max RDH payload Detector field (RDH)										
E3	Trigger compare delay BCID delay										
E4	Data select trigger mask										

Таблица 3: Таблица адресов регистров управления.

No	bit	значение
0	8	Orbit sync
1	9	Drop hit counter
2	10	Generator start offset
3	11	GBT errors
4	12	Reset GBT
5	13	RX phase error

Таблица 4: Описание битов регистра 'Reset control'

Значение регистра	режим работы
0	No generator
1	Main generator
2	TX generator

Таблица 5: Описание состояний регистра 'Data generator'

Значение регистра	режим работы
0	No generator
1	Continuous generator

Таблица 6: Описание состояний регистра 'Trigger generator'

Значение регистра	режим работы
0	None
1	SOC
2	SOT
3	EOC
4	EOT

Таблица 7: Описание состояний регистра 'Readout command'

No	bit	значение
0	20	Is HB response
1	21	Is readout bypass mode
2	22	Force readout idle mode

Таблица 8: Описание битов регистра 'Readout mode'

#### 8.2 Описание регистров статуса

Название регисра	используется в модуле	является побитовым
RX phase	RX data clock sync	нет
BCID sync mode	RX data decoder	нет
Readout mode	RX data decoder	нет
GBT status	GBT, RX data clock sync	да
CRU orbit	RX data decoder	нет
CRU bc	RX data decoder	нет
Selector FIFO count	Event selector	нет
Raw FIFO count	Data converter	нет
Selector first hit dropped orbit	Event selector	нет
Selector last hit dropped orbit	Event selector	нет
Selector total hits dropped	Event selector	нет
Readout rate	Event selector	нет

Таблица 9: Список регистров статуса

addr	31 28	27 24	23 20	19 16	15 12	11 8   7 4   3 0
E8		RX phase	BCID sync mode	Readout mode		GBT status
E9	CRU Orbit					
EA						CRU BC
EB	Selector FIFO count		Raw FIFO count			
EC	Selector first hit dropped orbit					
ED	Selector last hit dropped orbit					
EE	Selector total hits dropped					
EF						Readout rate

Таблица 10: Таблица адресов регистров статуса.

Бит	значение
0	Phase aligner CPLL lock
1	RX word clock ready
2	RX frame clock ready
3	MGT link ready
4	TX reset done
5	TX FSM reset done
6	GBT RX ready
7	GBT RX error detected
8	GBT RX error latch
9	RX phase error

Таблица 11: Описание битов регистра 'GBT status'

Значение регистра	режим работы
0	Idle
1	Continuous
2	Triggered

Таблица 12: Описание состояний регистра 'Readout mode'

Значение регистра	режим работы
0	Start
1	Sync
2	Lost

Таблица 13: Описание состояний регистра 'BCID sync mode'

## 9 Ссылки на рабочие документы и программное обеспечение по проекту FIT

- ALICE FIT twiki https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AliceFIT/WebHome
- Документация по FIT readout unit (этот документ) https://github.com/dfinogee/FIT-readout-manual/archive/master.zip
- Код O2 с описанием формата RDH в коментариях https://github.com/AliceO2Group/AliceO2/blob/dev/DataFormats/Headers/include/Headers/RAWDataHeader.h
- Список регистров управления электроникой PM, TCM, FTM и описание формата данных https://drive.google.com/file/d/1LxKEuedLqxtyCRw072ZqJ2vj7upP0ZgV
- Φορματ данных DCS DIM server https://docs.google.com/spreadsheets/d/1thWhrCXjiy1TCPqNQMcDQhZT5\_r9W99qBS61 edit?usp=sharing
- FIT DCS errors and states table https://ldrv.ms/x/s!AkcFS39-p1V3i90otp9Ft-WtBZxrGQ?e=1Zie23
- FIT calibration precedures table https://docs.google.com/spreadsheets/d/10H8Vx8-9-AFI8klffS3ApoG-W4m2abMectXFsedit#gid=2045533669
- ALICE LS2 Recommissioning: Contacts https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r5kaKWPb4KZuImwc7iYxIz67Vcic1Lyedit?usp=sharing
- Програмный пакет для управления электроникой (H. Вознюк) https://drive.google.com/open?id=1QItOYTsRTcdh7yGoowtt8J9e
- FIT FPGA projects on git https://github.com/AliceO2Group/alice-fit-fpga