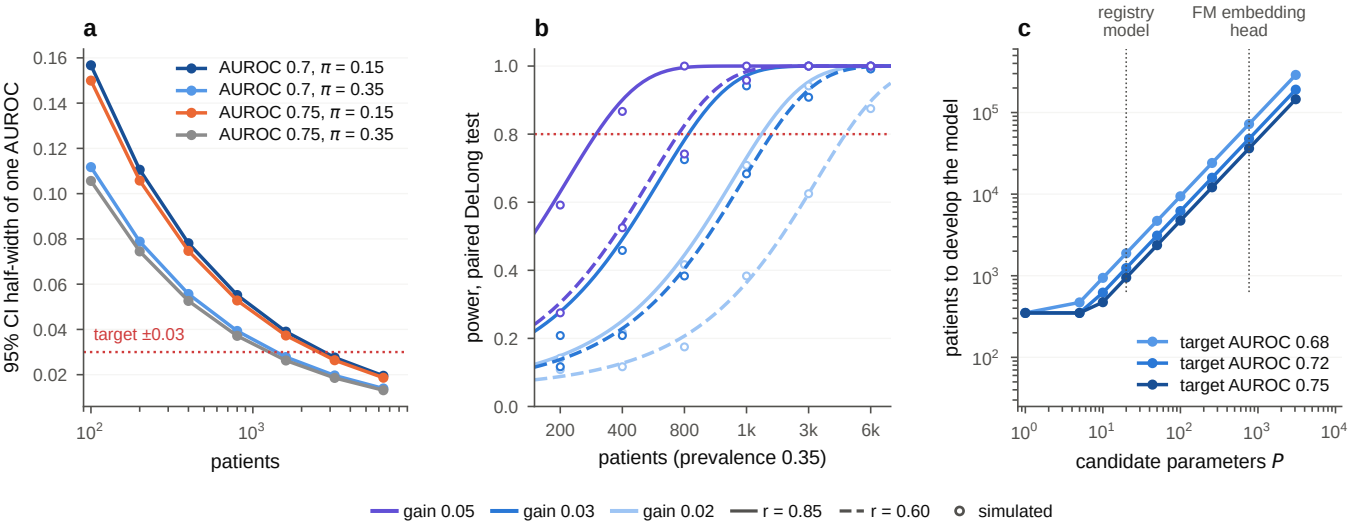
a
95% CI half-width of one AUROC
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
AUROC 0.7, π = 0.15
AUROC 0.7, π = 0.35
AUROC 0.75, π = 0.15
AUROC 0.75, π = 0.35
target ±0.03
10^2
10^3
patients
b
power, paired DeLong test
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
200
400
800
1k
3k
6k
patients (prevalence 0.35)
c
registry model
FM embedding head
patients to develop the model
10^5
10^4
10^3
10^2
target AUROC 0.68
target AUROC 0.72
target AUROC 0.75
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
candidate parameters P
gain 0.05
gain 0.03
gain 0.02
r = 0.85
r = 0.60
simulated