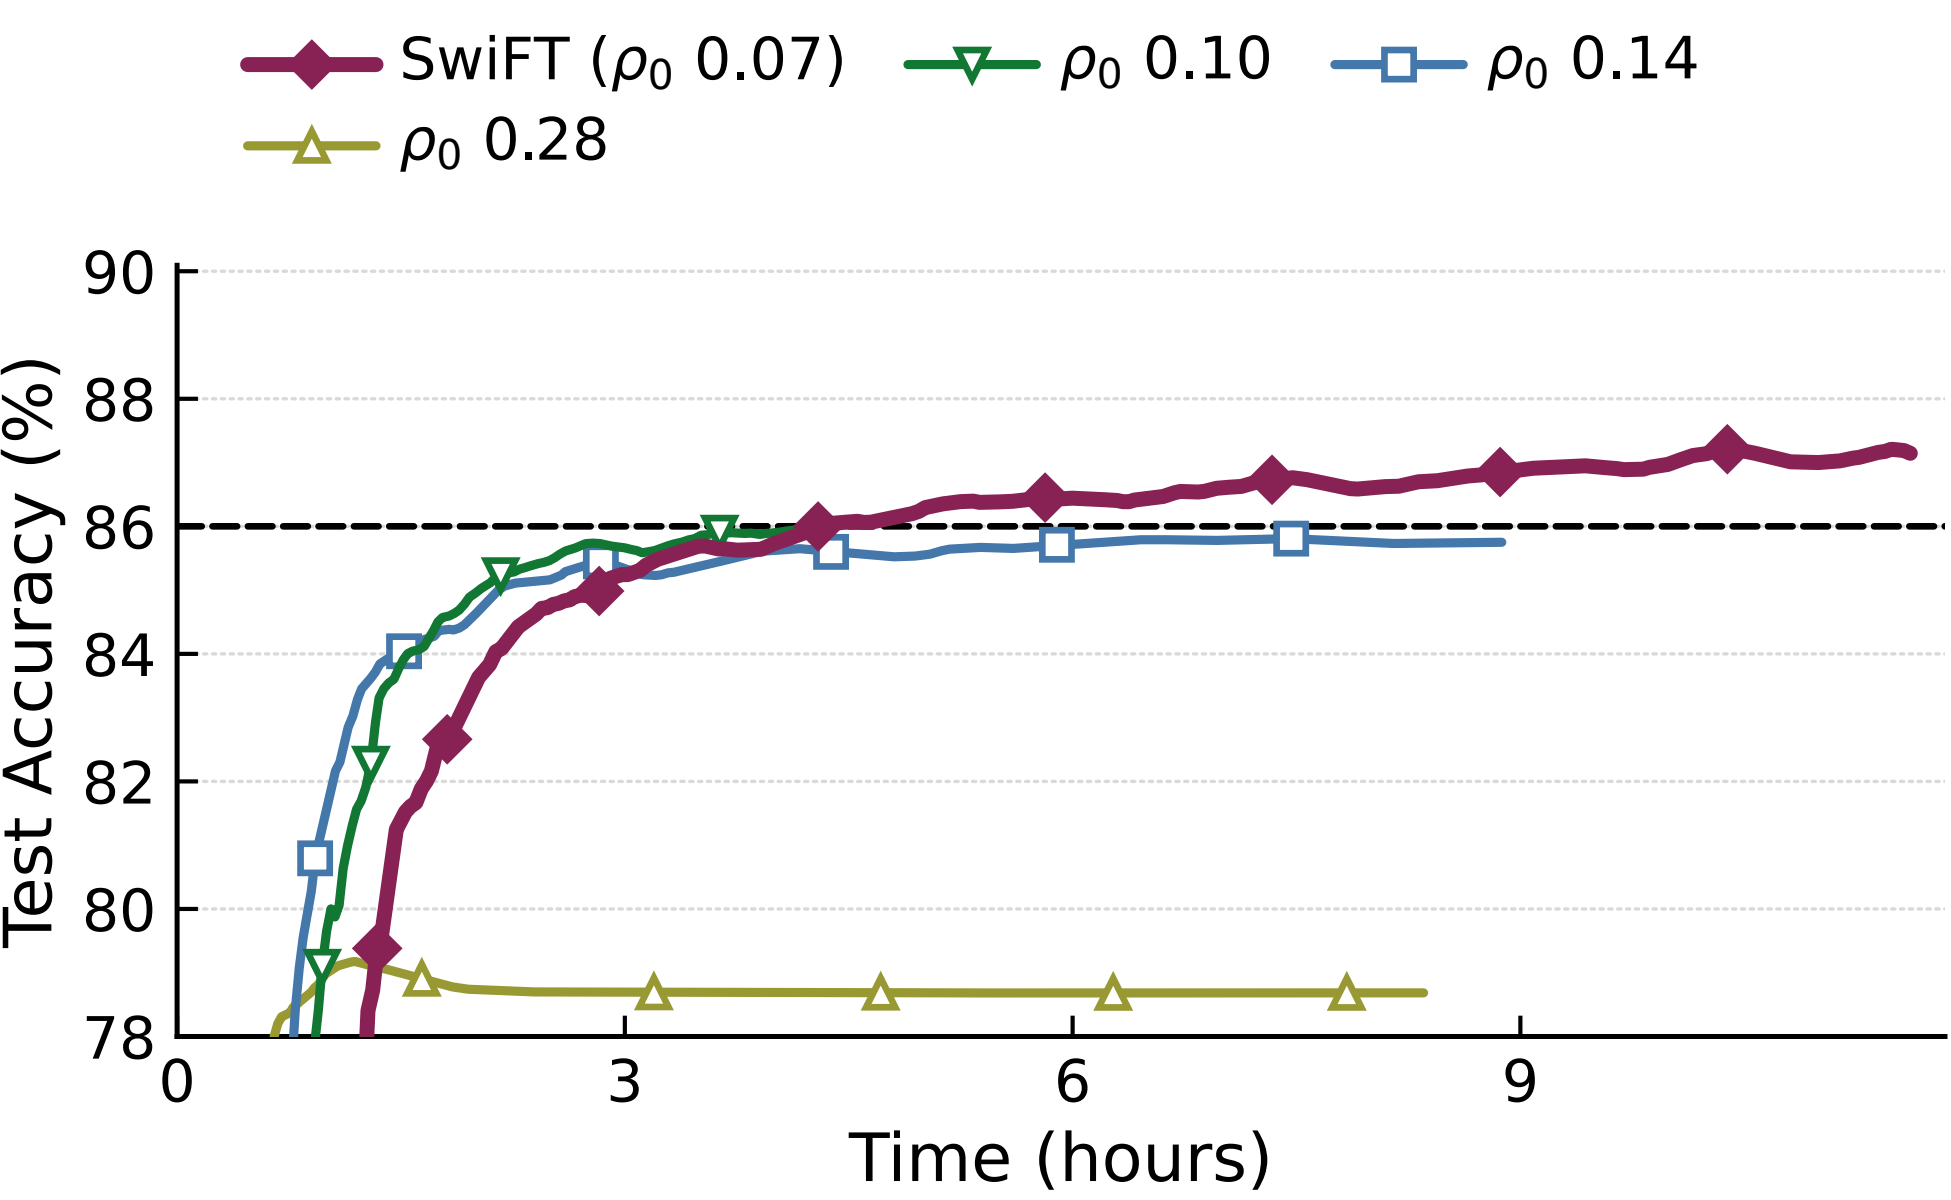
SwiFT (ρ_0 0.07)
ρ_0 0.10
ρ_0 0.14
ρ_0 0.28
Test Accuracy (%)
90
88
86
84
82
80
78
0
3
6
9
Time (hours)