

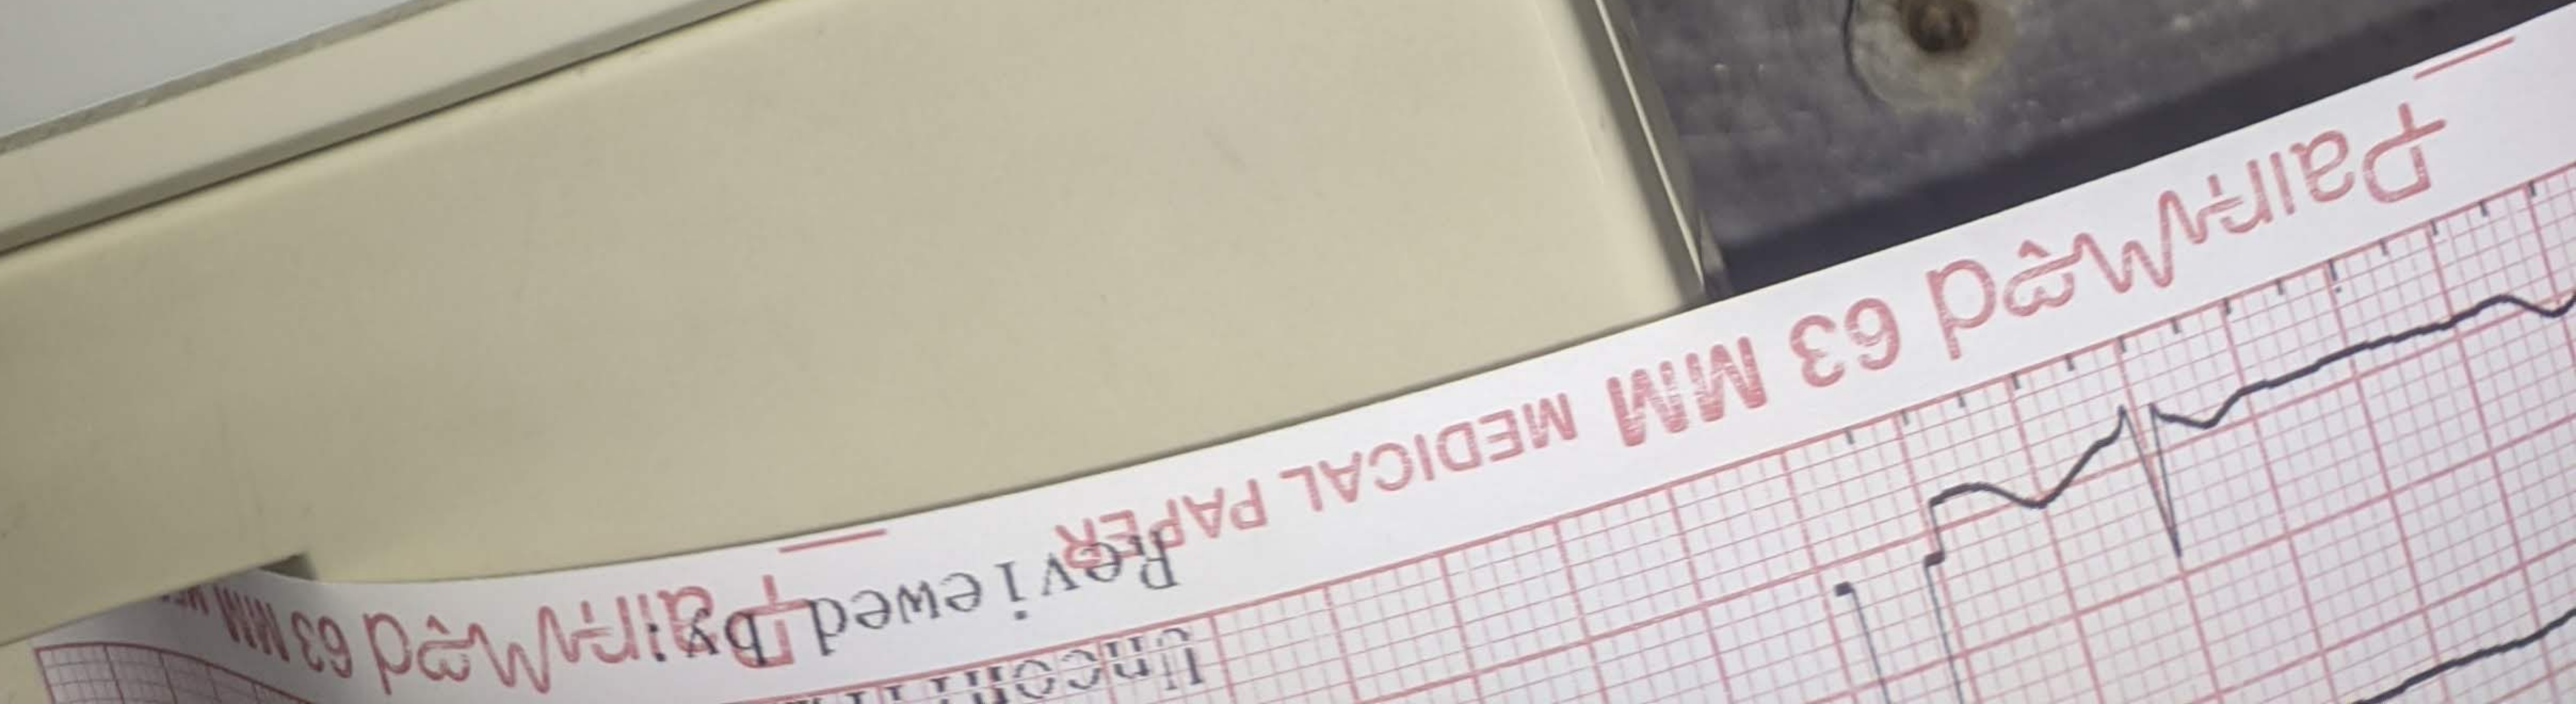


FECHA
REVISIÓN
Código de calidad
21032000-3123

CA 1236411
www.celsiustecnologia.com
PAX 57 (4) 444 25 48
CELSIUS

cardiofax

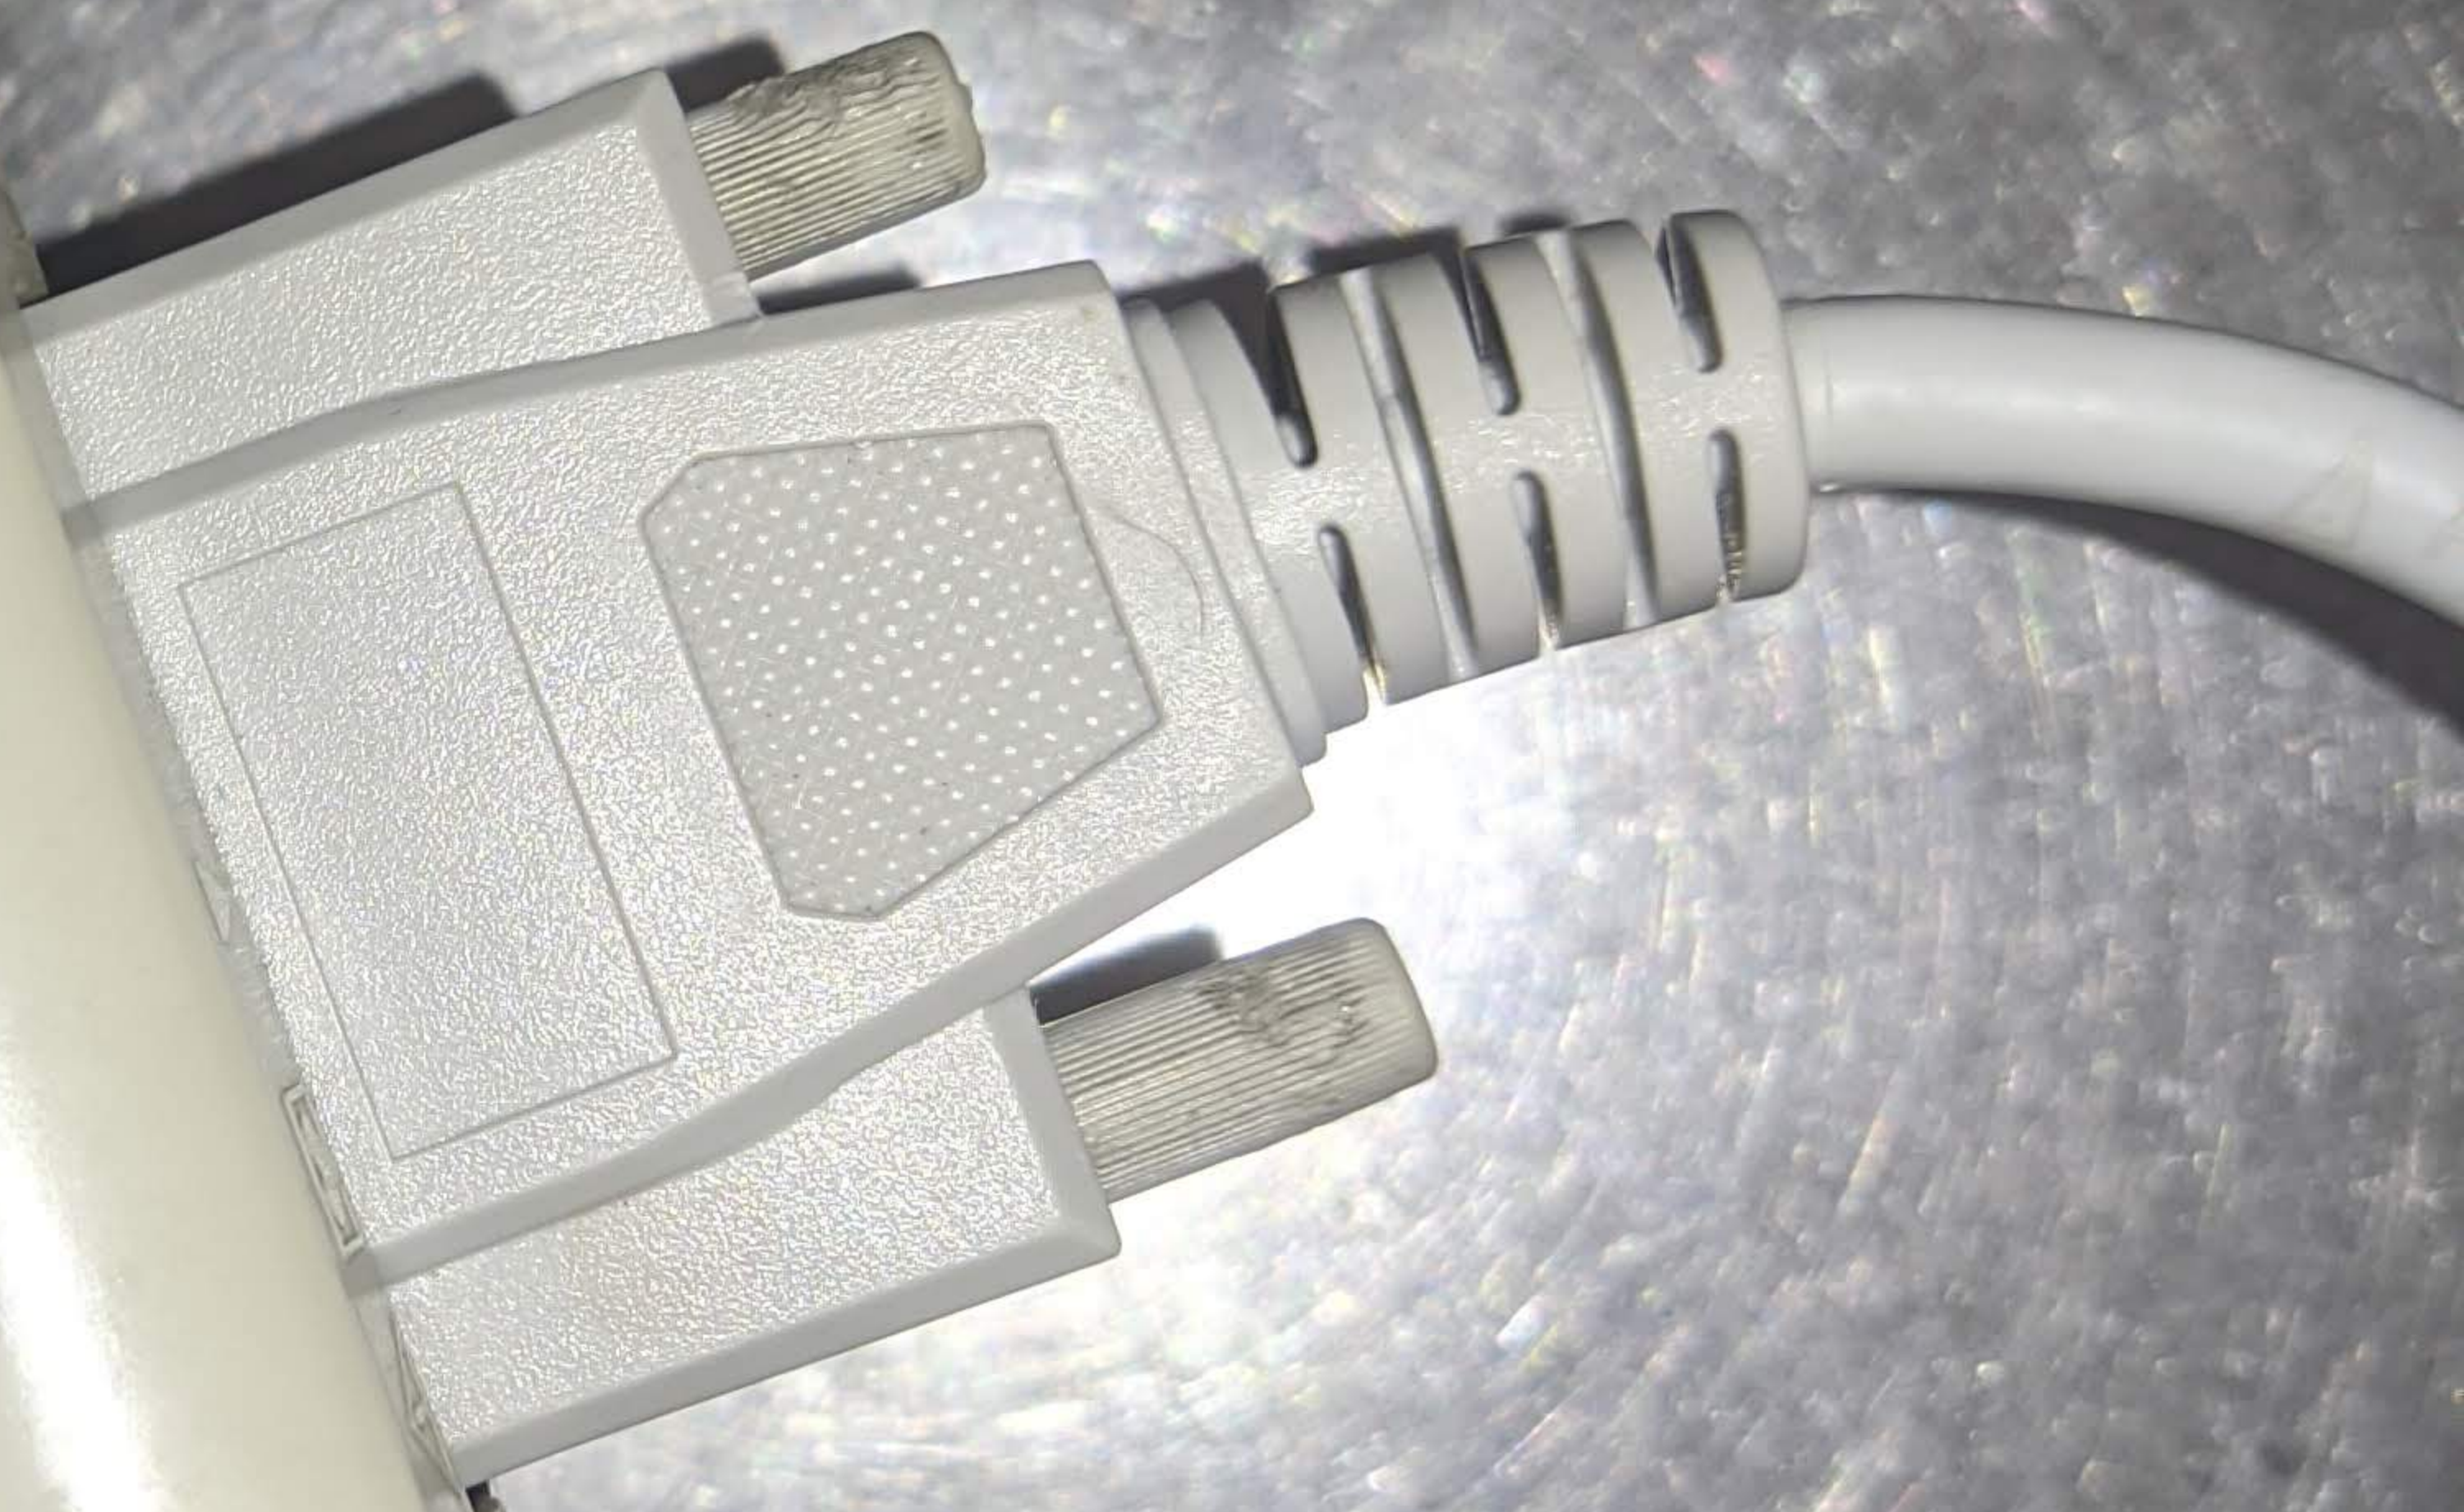

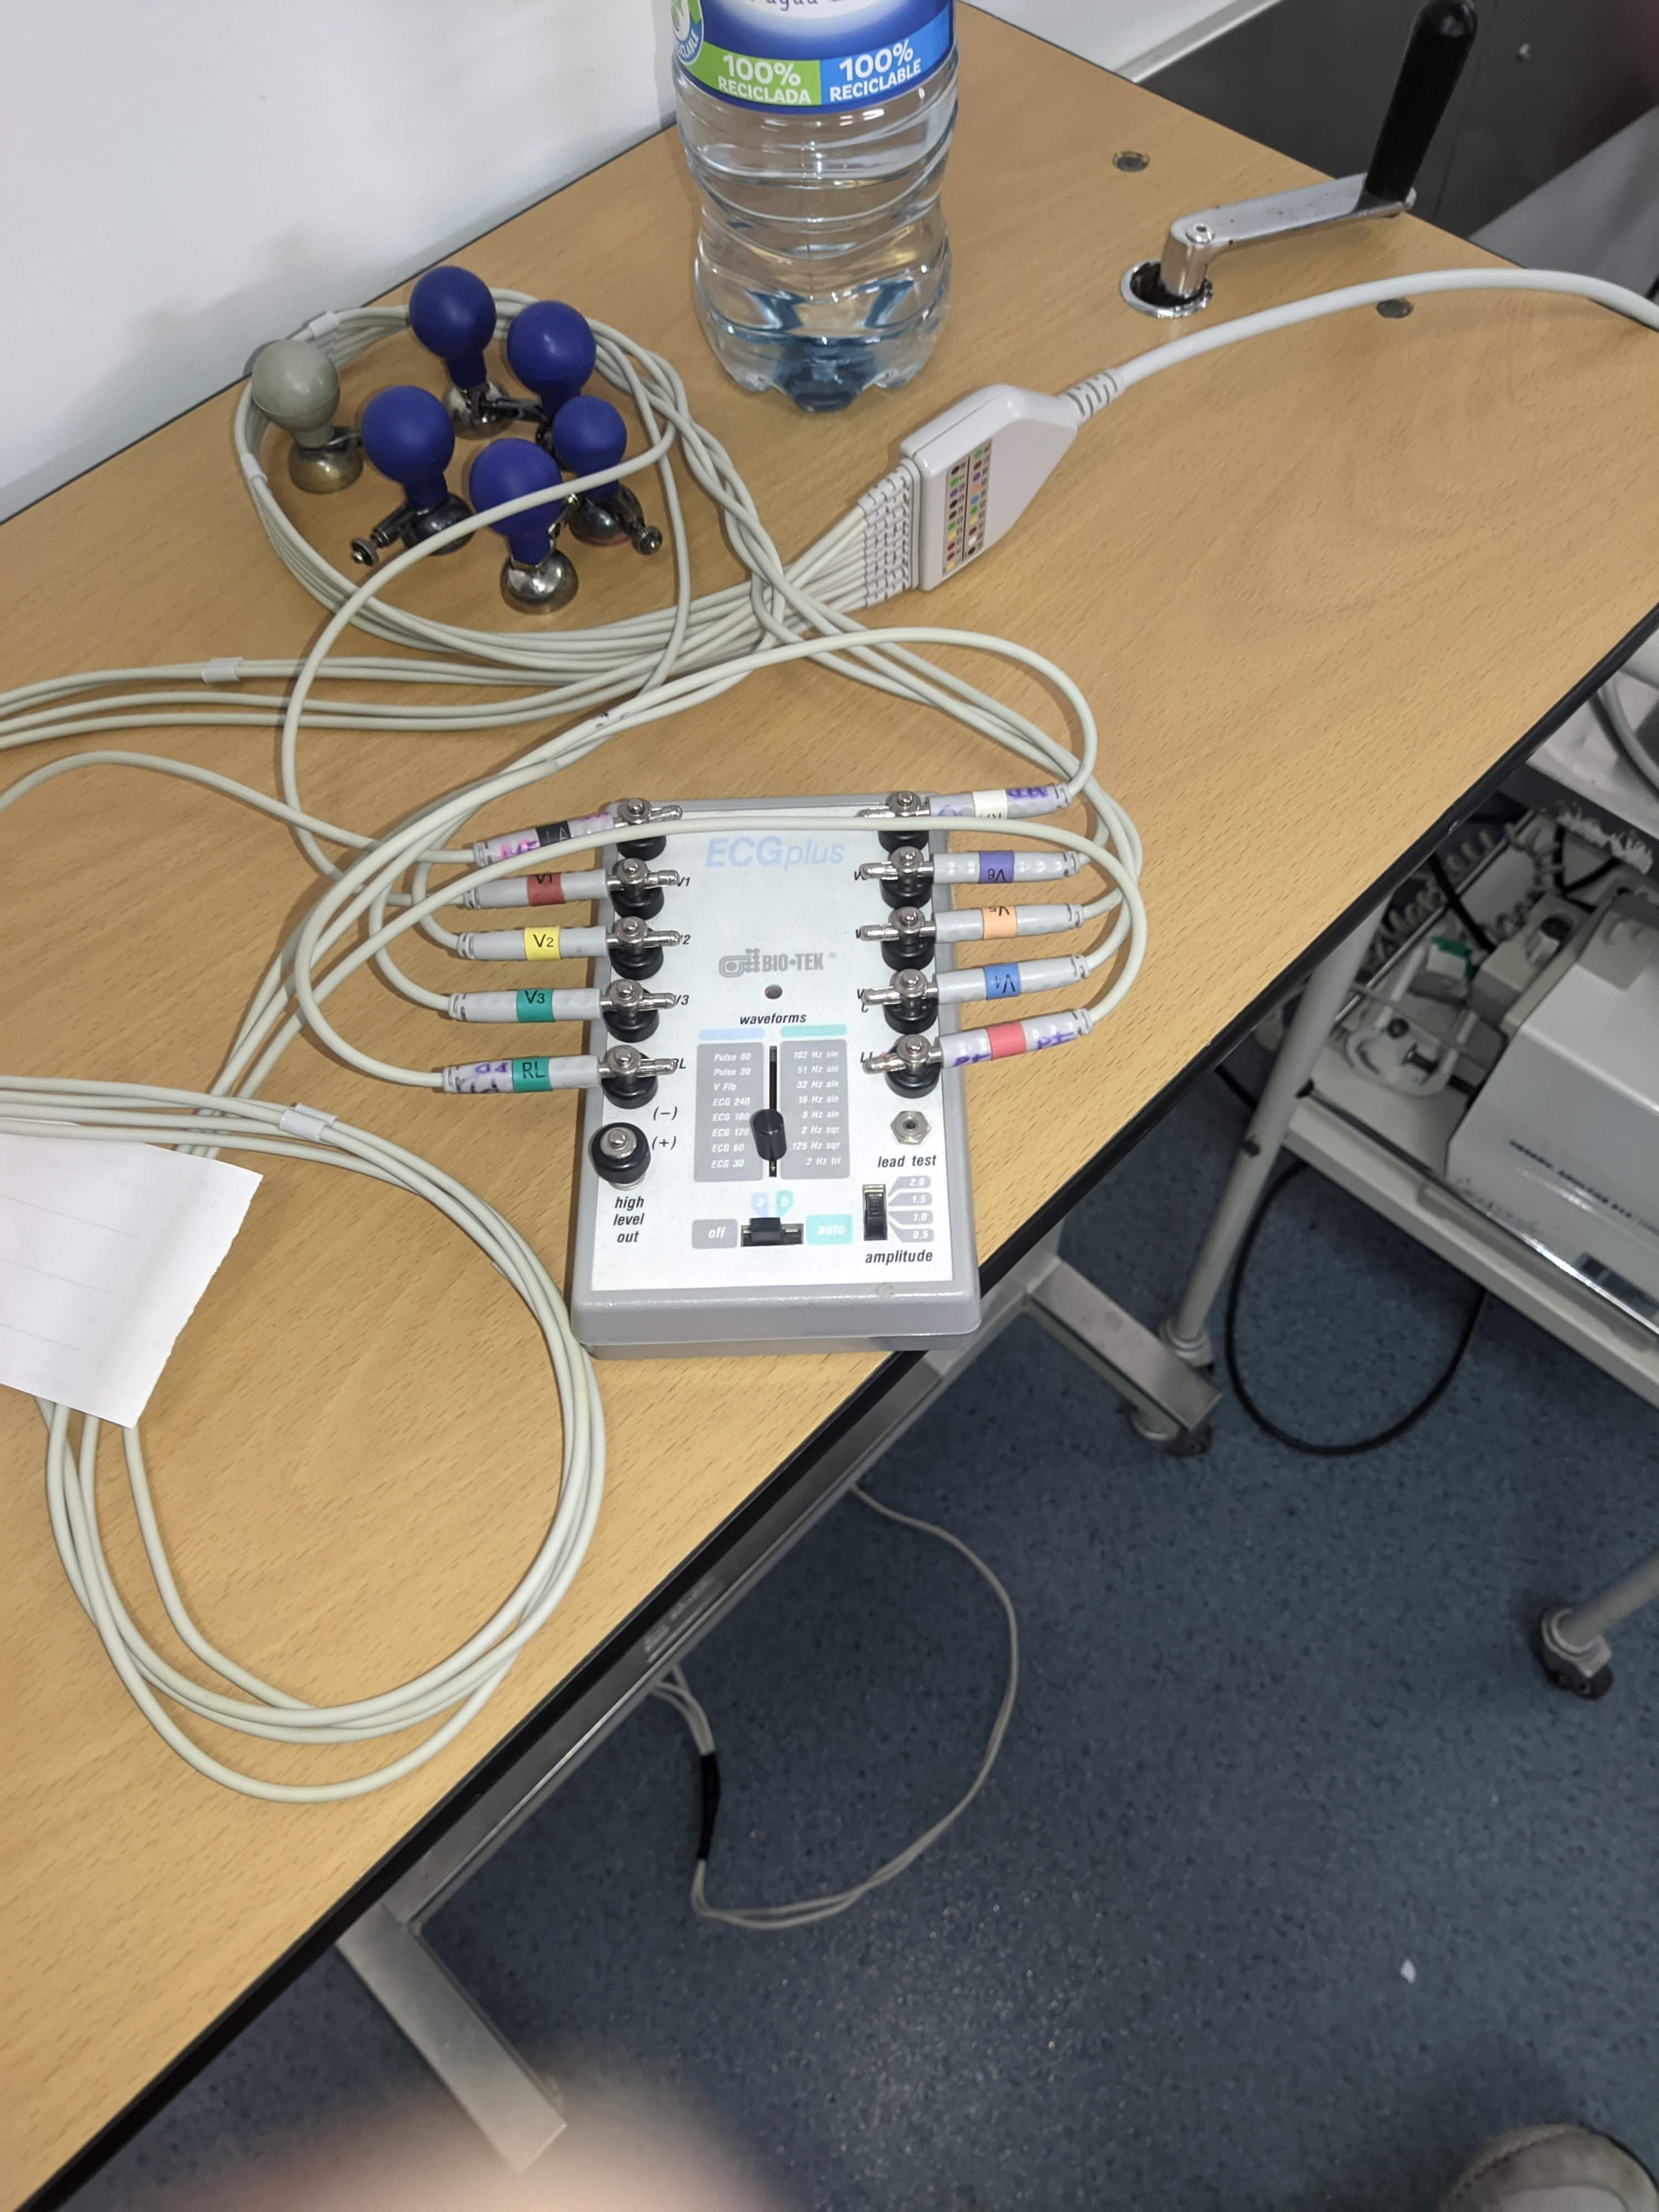

ECGplus

BIO-TEK

waveforms

Pulse 60	102 Hz sin
Pulse 30	51 Hz sin
V Fib	32 Hz sin
ECG 240	16 Hz sin
ECG 180	8 Hz sin
ECG 120	2 Hz sqw
ECG 60	125 Hz sqw
ECG 30	2 Hz tri


lead test

2.0
1.5
1.0
0.5
amplitude

high level out

off

auto

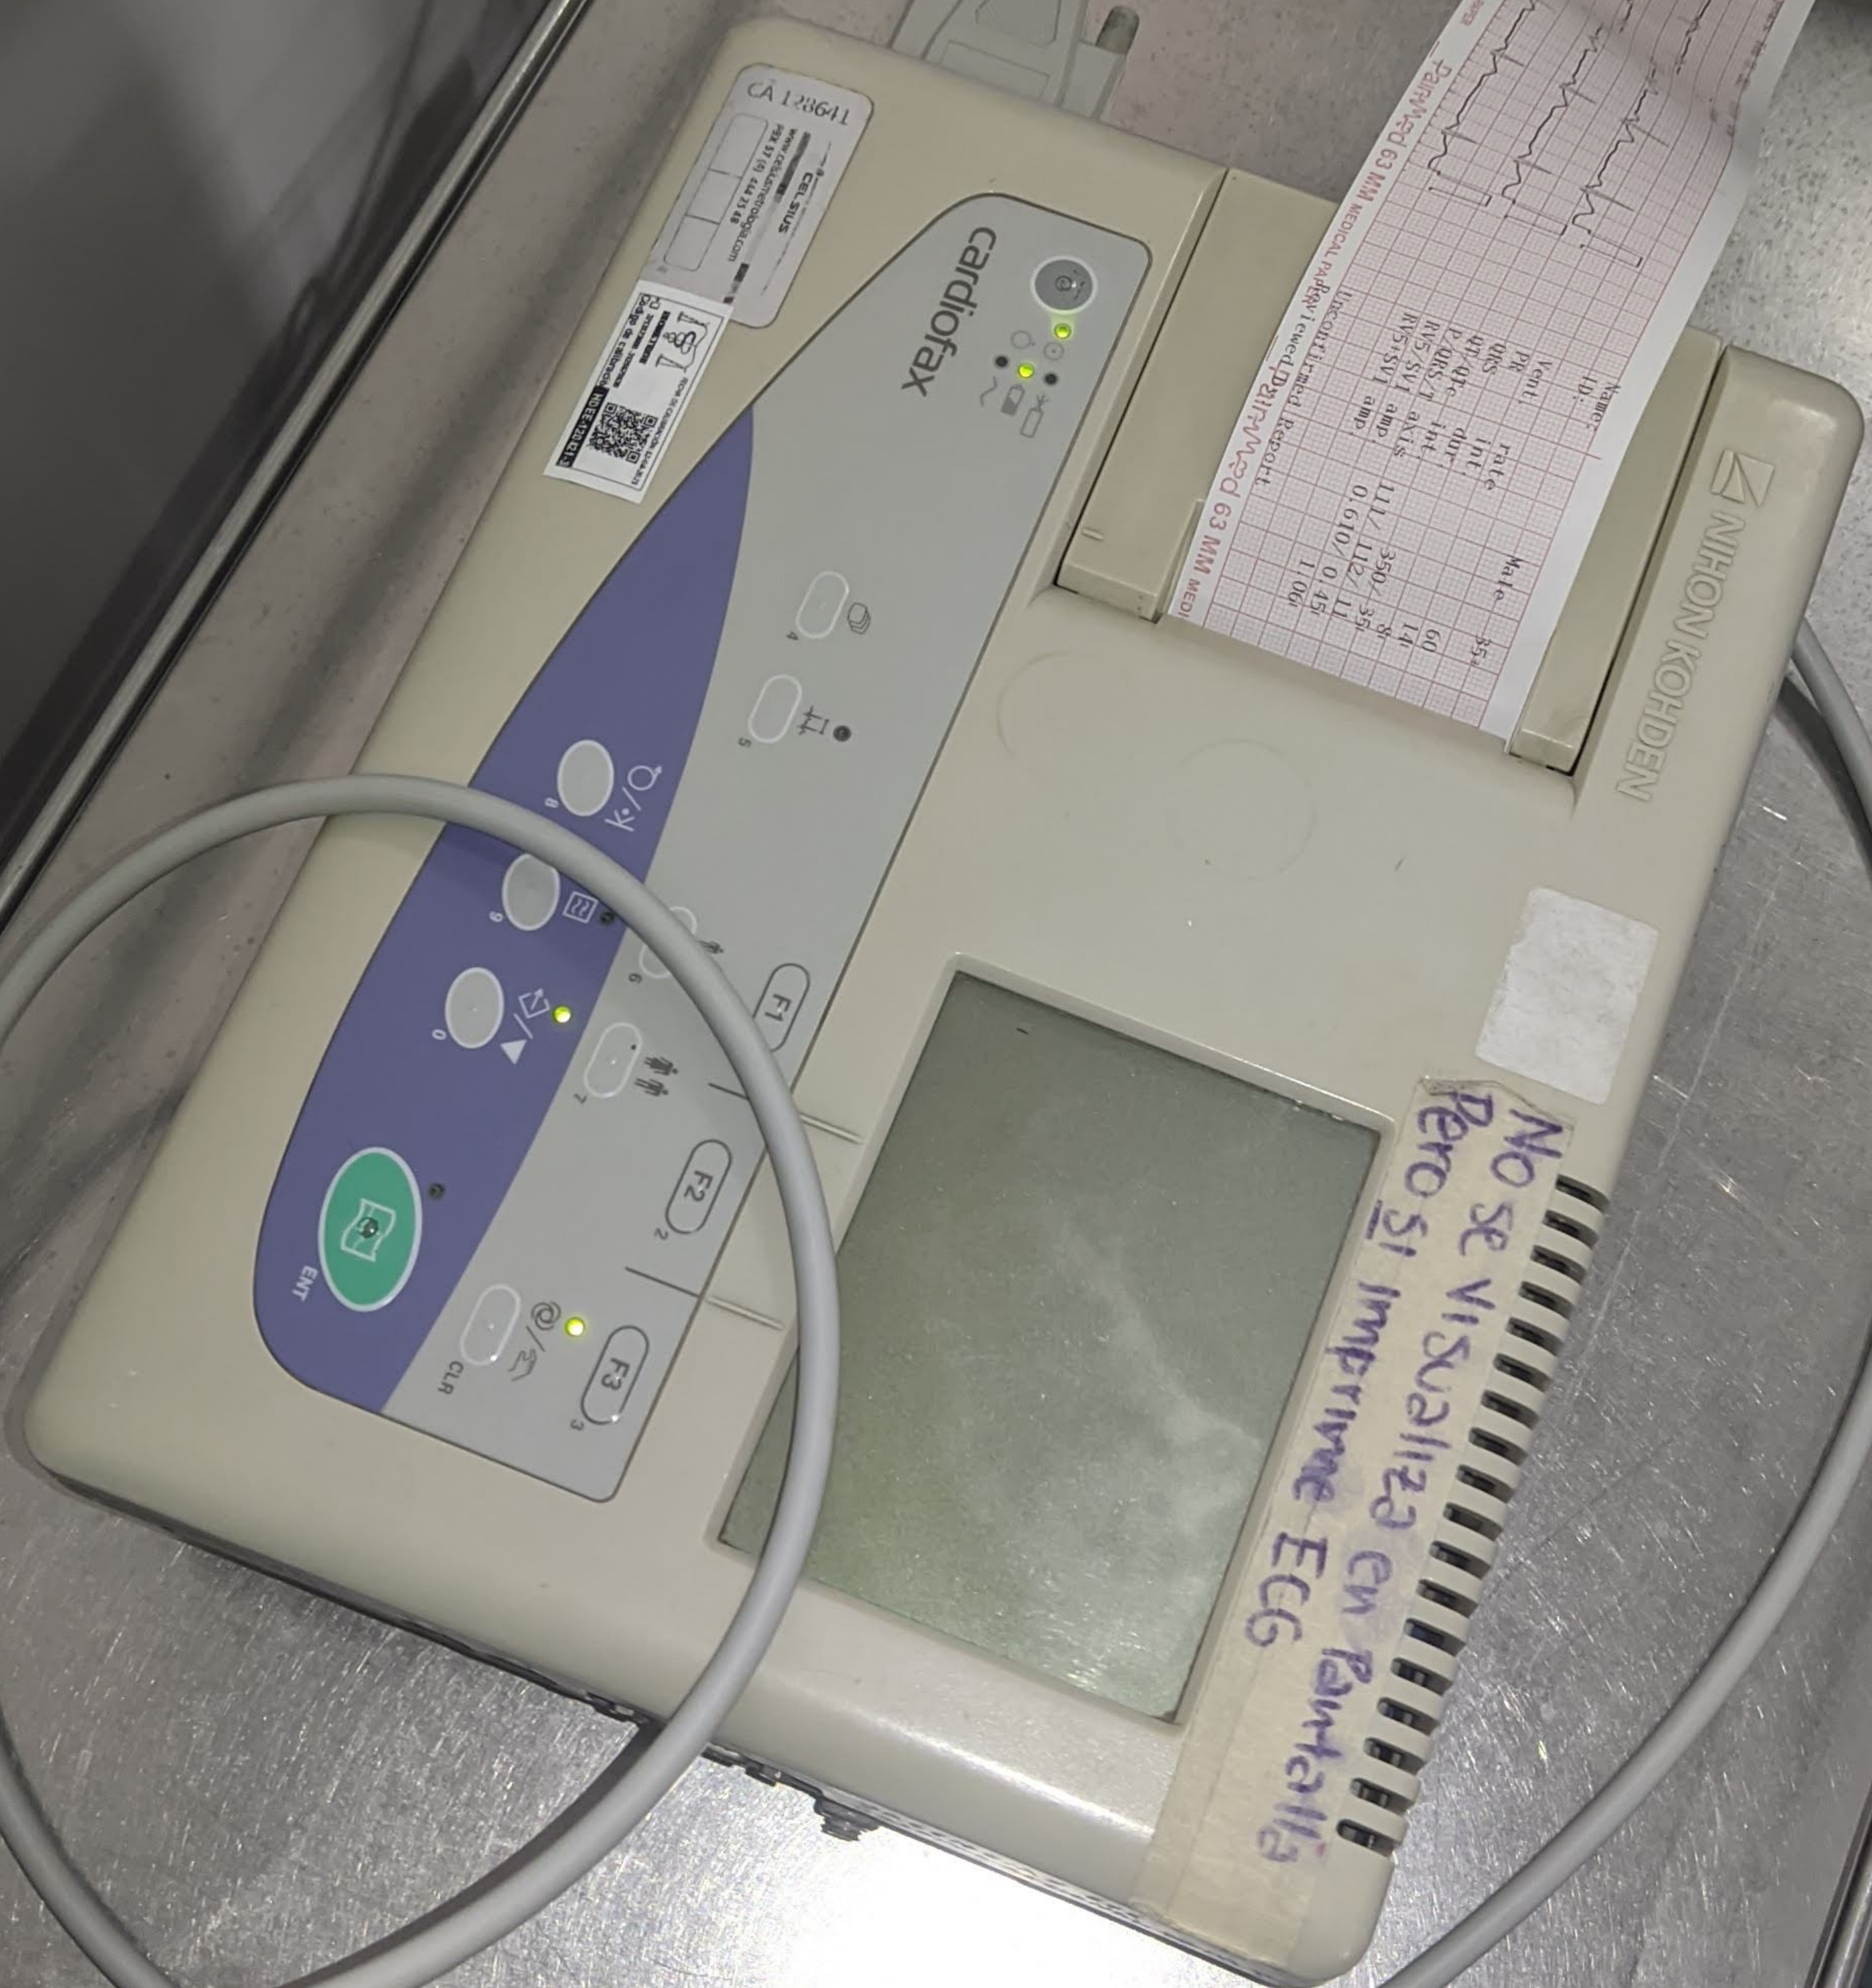

NO SE VISUALIZA EN PANTALLA
PERO SI IMPRIME ECG

