



ID:

I

Nombre:

aVR

V1

V4

II

aVL

V2

V5

III

aVF

V3

V6

II

25 mm/s 20 mm/mV [0.5-35] Hz 60Hz 16/11/2021 04:37:37PM Versión 01.30.04

Welch Allyn-cp-50 Ringped

Welch Allyn-cp-50 Ringped

Welch Allyn-cp-50 Ringped

ID:

Nombre:

Edad:

P/PR:

QRS:

QT/QTc:

P/QRS/T eje:

Frecuencia cardíaca:

atención: edad desco

atención: sexo desco

taquicardia sinusal

probable infarto sept


patrón RSR' en V1 y

QRS de bajo voltaje

hallazgos de probabl

Informe no confirma



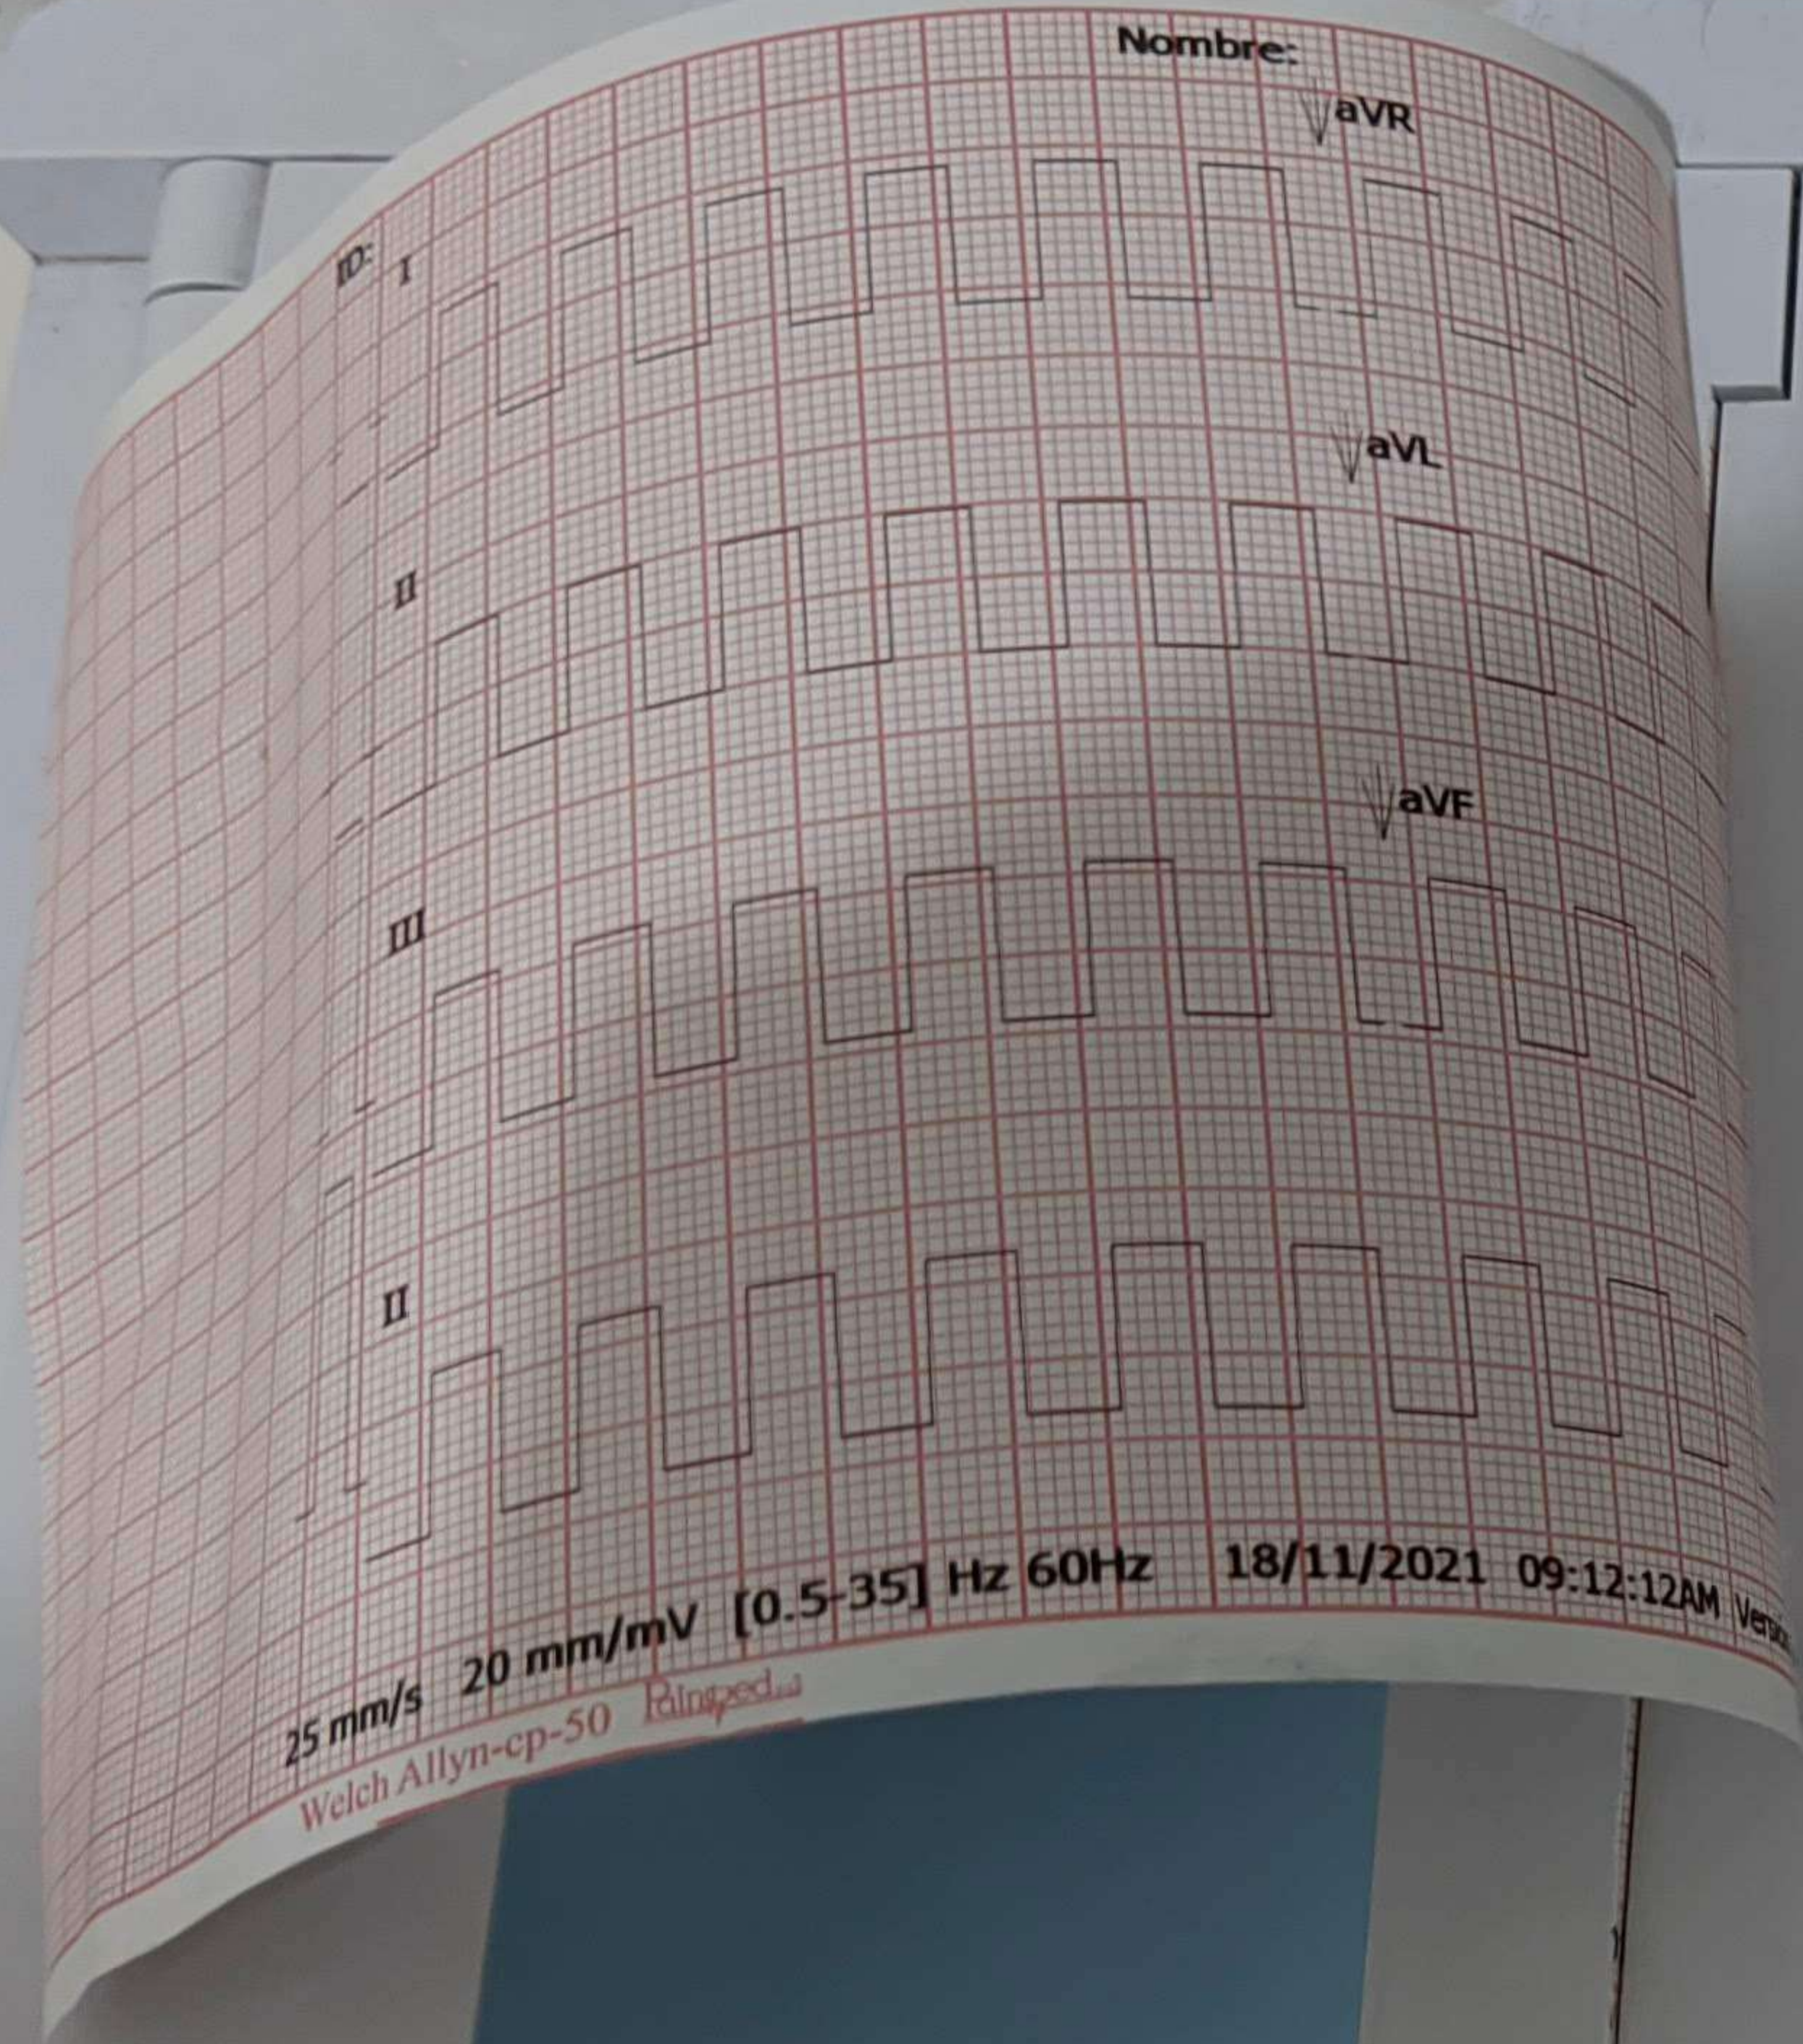

ECG urgente

Mantener pulsado 1 segundo:

ECG automático

1. Pulse:

2. Introduzca los datos del paciente.

3. Toque:

ECG de ritmo cardíaco

1. Pulse:

2. (Opcional) Cambiar configuración.

3. Para detener, pulse:

Menú

Ayuda

WelchAllyn



